

<b>Nom</b> SECK	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 29/01/1986	<b>Profession</b> FLAGMAN
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 314	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,6 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 58 %

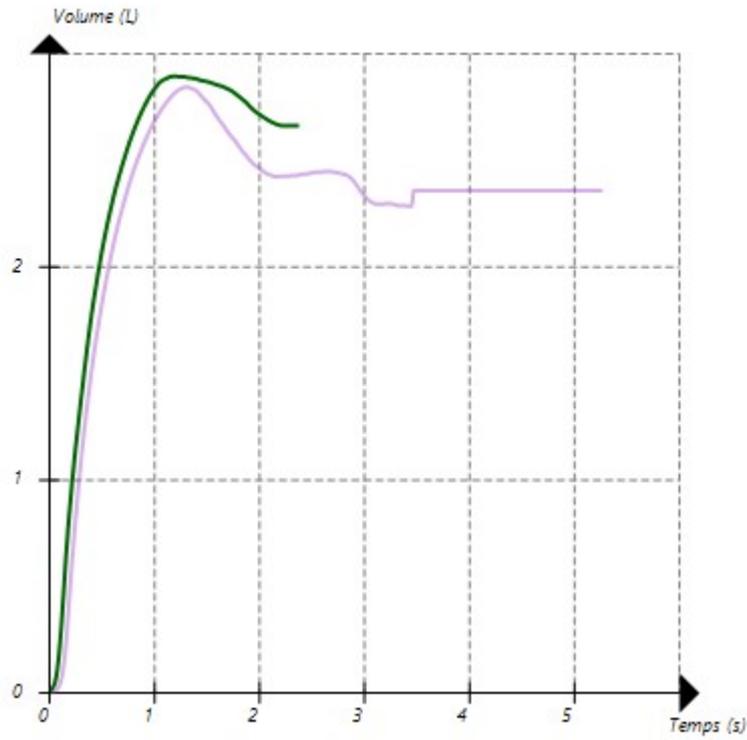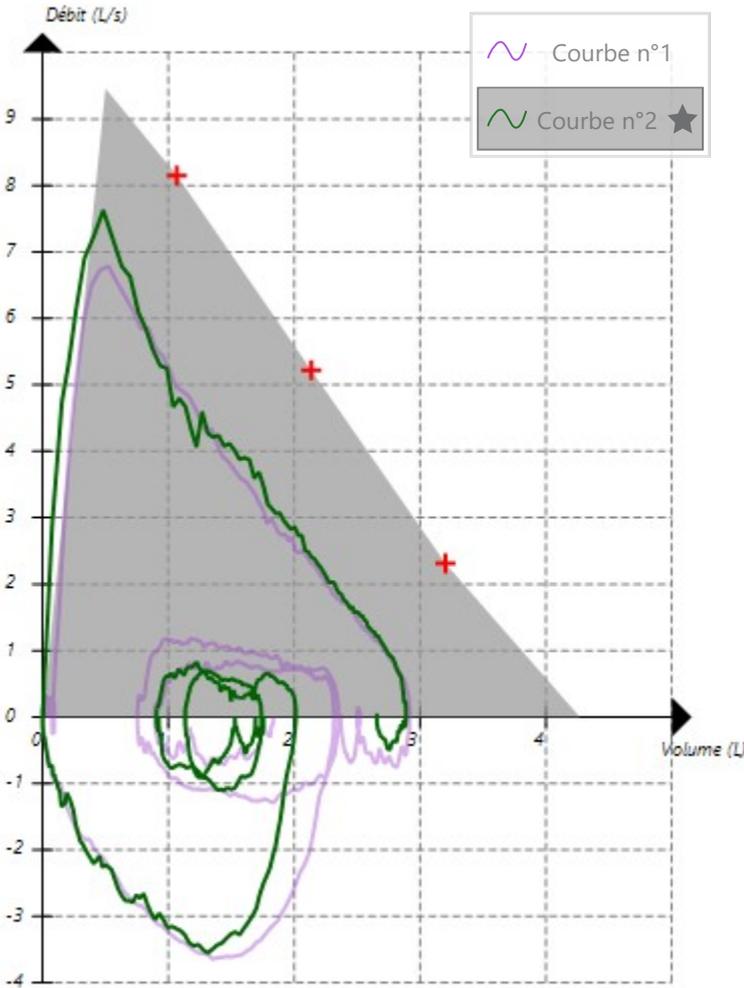

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,84 L	2,89 L	4,27 L	67,68 %
VEMS	2,78 L	2,87 L	3,53 L	81,30 %
DEP	6,95 L/s	7,81 L/s	9,46 L/s	82,56 %
VEMS/ CVF	97,89 %	99,31 %	80,41 %	123,50 %
Durée d'expiration	1,30 s	2,26 s	-	
DEMM	3,65 L/s	3,92 L/s	4,53 L/s	86,53 %
DEMM/ CVF	1,29 s-1	1,36 s-1	0,92 s-1	147,83 %
DE75	5,68 L/s	6,63 L/s	8,15 L/s	81,35 %
DE50	3,85 L/s	4,12 L/s	5,22 L/s	78,93 %
DE25	2,11 L/s	2,26 L/s	2,31 L/s	97,84 %