

<b>Nom</b> KOIVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> PASCAL	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/03/1980	<b>Profession</b> MENUISIER
<b>Age</b> 44 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 353	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 157 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 50 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,2 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 61 %

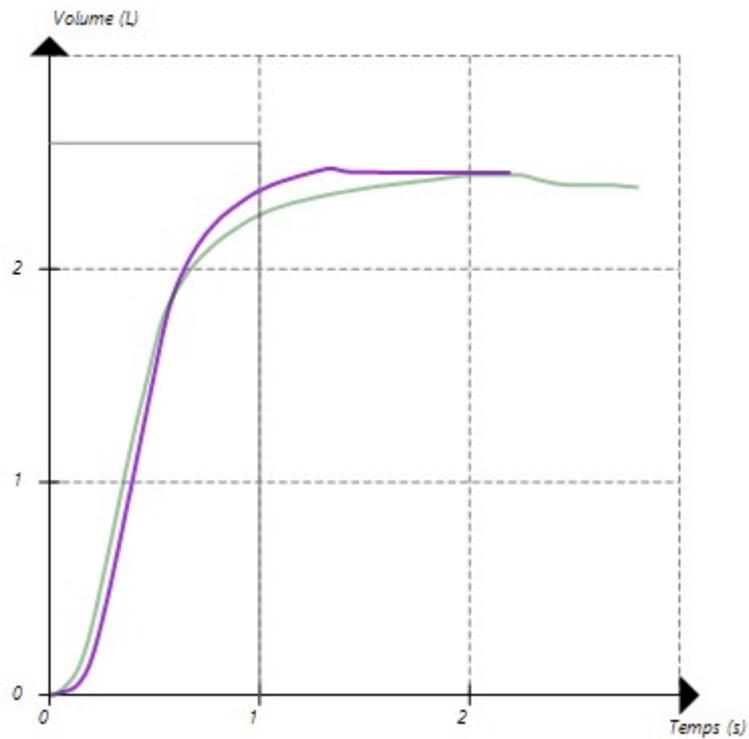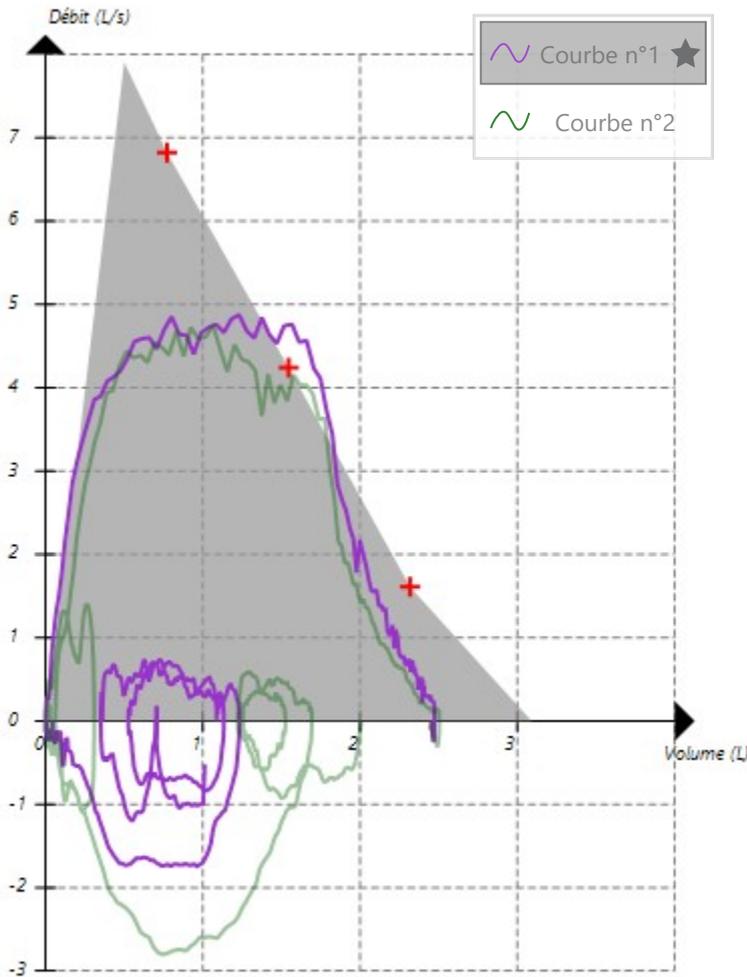

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,47 L	2,44 L	3,09 L	79,94 %
VEMS	2,43 L	2,30 L	2,59 L	93,82 %
DEP	5,17 L/s	5,54 L/s	7,91 L/s	65,36 %
VEMS/ CVF	98,38 %	94,26 %	79,33 %	124,01 %
Durée d'expiration	1,41 s	2,24 s	-	
DEMM	4,60 L/s	4,07 L/s	3,86 L/s	119,17 %
DEMM/ CVF	1,86 s-1	1,67 s-1	1,09 s-1	170,64 %
DE75	4,66 L/s	4,54 L/s	6,82 L/s	68,33 %
DE50	4,94 L/s	4,18 L/s	4,24 L/s	116,51 %
DE25	2,74 L/s	1,99 L/s	1,61 L/s	170,19 %