



<b>Nom</b> GONTO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> NANKOLON	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 06/06/1986	<b>Profession</b> ARCHITEUR
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 388	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b>	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 52 %

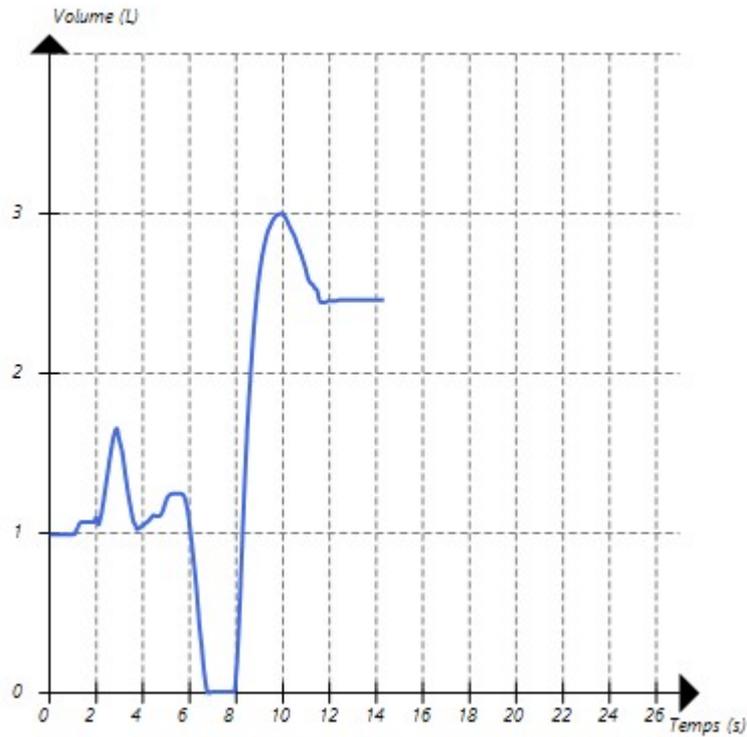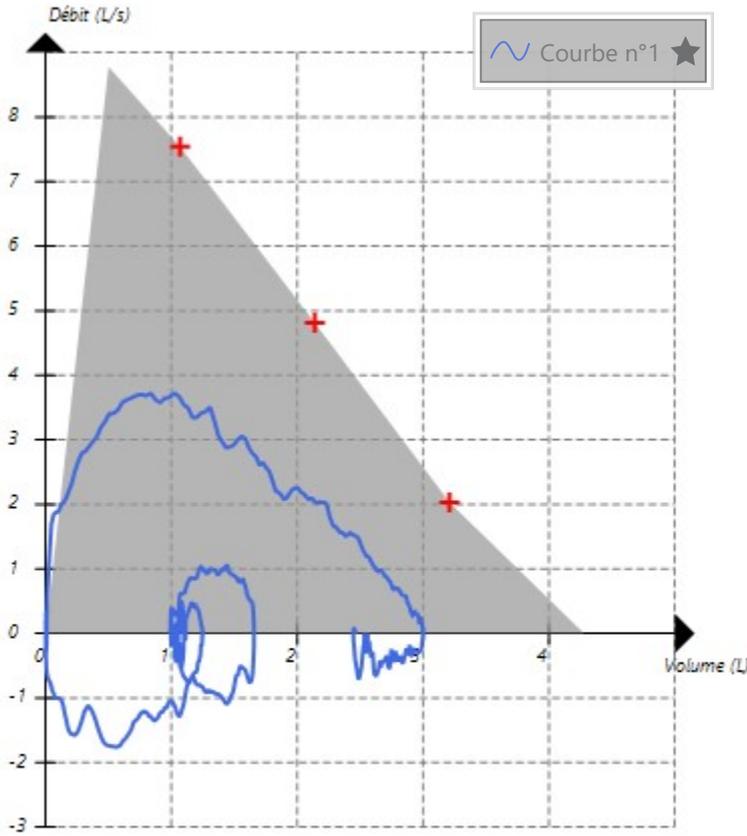

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,00 L	4,28 L	70,09 %
VEMS	2,63 L	3,59 L	73,26 %
DEP	3,75 L/s	8,78 L/s	42,71 %
VEMS/ CVF	87,67 %	80,41 %	109,03 %
Durée d'expiration	3,05 s	-	
DEMM	2,83 L/s	4,31 L/s	65,66 %
DEMM/ CVF	0,94 s-1	1,01 s-1	93,07 %
DE75	3,74 L/s	7,54 L/s	49,60 %
DE50	2,94 L/s	4,81 L/s	61,12 %
DE25	1,82 L/s	2,03 L/s	89,66 %