

<b>Nom</b> SQUARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KALIL	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 10/04/1981	<b>Profession</b> MECANICIEN
<b>Age</b> 43 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 347	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 69 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecacs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 52 %

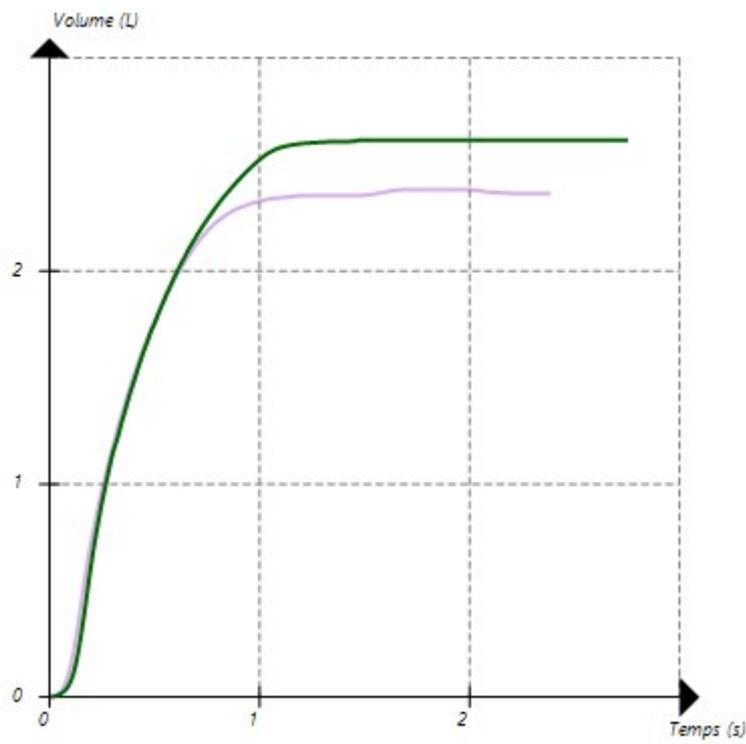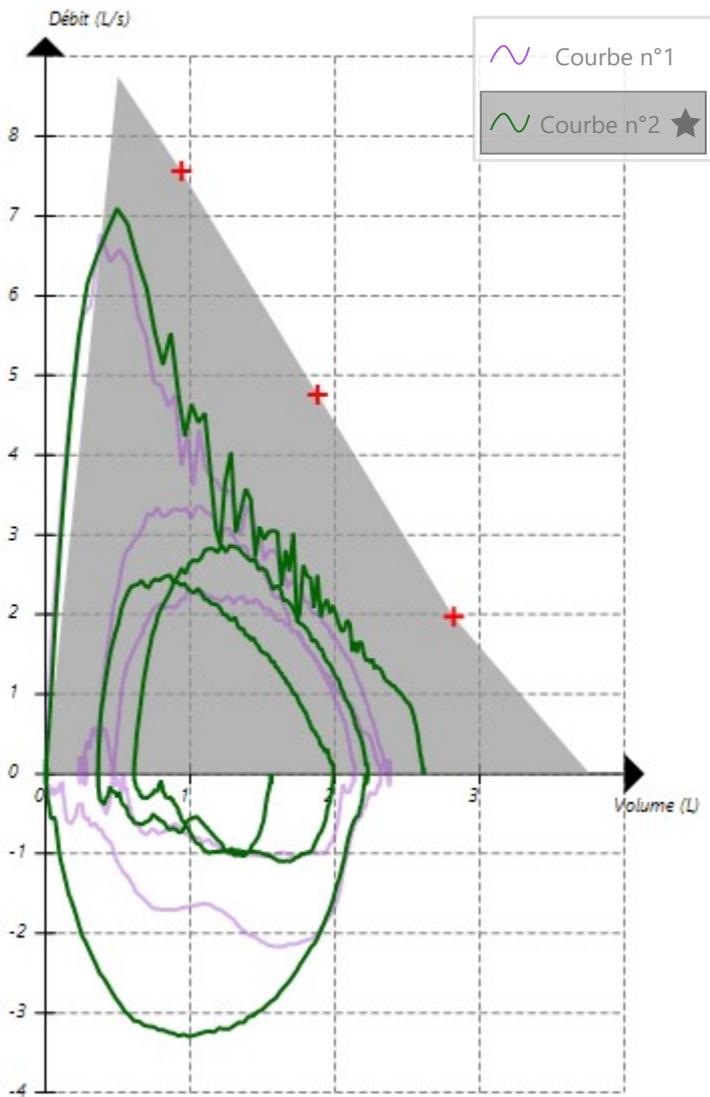

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,38 L	2,61 L	3,76 L	69,41 %
VEMS	2,34 L	2,58 L	3,11 L	82,96 %
DEP	7,22 L/s	7,51 L/s	8,75 L/s	85,83 %
VEMS/ CVF	98,32 %	98,85 %	79,51 %	124,32 %
Durée d'expiration	1,71 s	1,58 s	-	
DEMM	3,57 L/s	3,40 L/s	4,15 L/s	81,93 %
DEMM/ CVF	1,50 s-1	1,30 s-1	0,96 s-1	135,42 %
DE75	6,33 L/s	6,18 L/s	7,56 L/s	81,75 %
DE50	3,87 L/s	2,79 L/s	4,76 L/s	58,61 %
DE25	2,23 L/s	2,16 L/s	1,97 L/s	109,64 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: