

**Nom** MADRONA  
**Prénom** MARCO JASON  
**Né le** 18/11/1982  
**Age** 41 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 392  
**Taille** 165 cm  
**Poids** 77 kg  
**Valeurs prédites** ITS (Crapo)  
**Opérateur** LY MAMOUDOU

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** QUALITY MANAGER  
**Entreprise** GPC  
**Service**  
**Fumeur** Fumeur  
**Groupe ethnique** Autre  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédicts sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 61 %

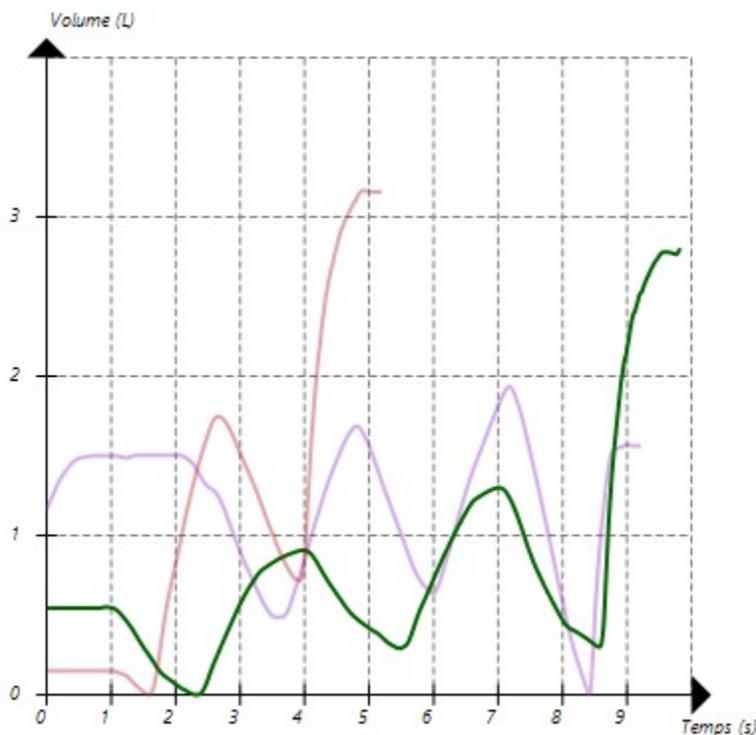

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	1,57 L	2,48 L	2,45 L	4,37 L	56,75 %
VEMS	1,57 L	2,48 L	2,45 L	3,64 L	68,13 %
DEP	8,15 L/s	8,82 L/s	8,54 L/s	-	
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,81 %	120,76 %
Durée d'expiration	0,58 s	1,00 s	0,99 s	-	
DEMM	5,26 L/s	4,12 L/s	4,26 L/s	3,94 L/s	104,57 %
DEMM/ CVF	3,35 s-1	1,66 s-1	1,74 s-1	0,90 s-1	184,44 %
DE75	7,83 L/s	8,28 L/s	7,87 L/s	-	
DE50	5,61 L/s	5,82 L/s	4,39 L/s	-	
DE25	3,63 L/s	4,09 L/s	2,87 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: