



<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANSANA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1990	<b>Profession</b> MECANICIEN
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 993	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,1 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 60 %

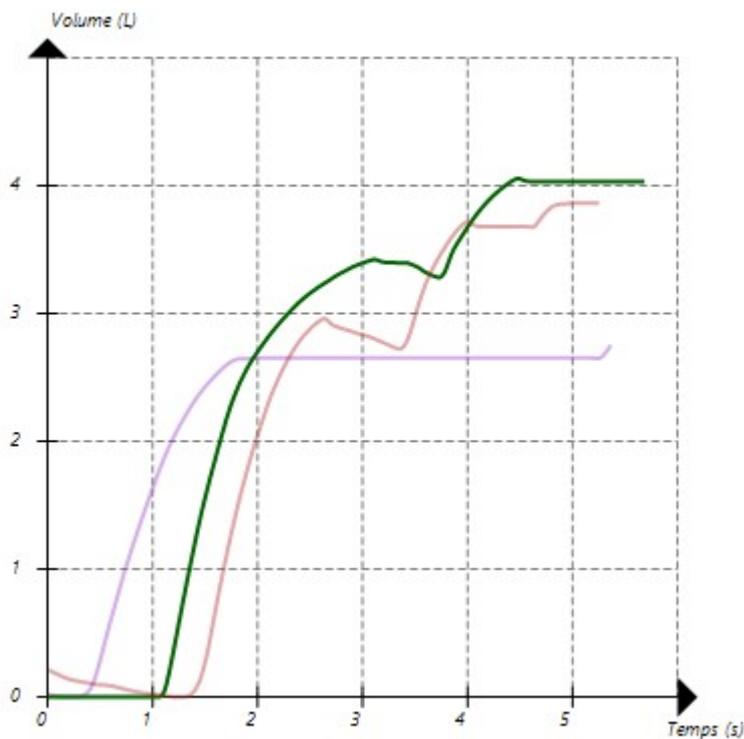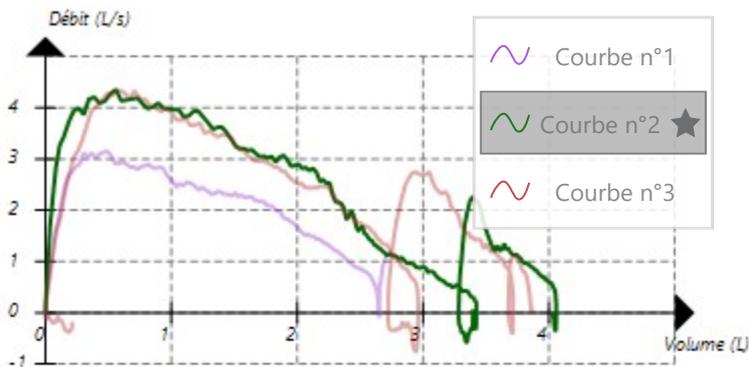

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,76 L	3,42 L	2,96 L	3,80 L	90,00 %
VEMS	2,33 L	2,83 L	2,83 L	3,17 L	89,27 %
DEP	3,20 L/s	4,45 L/s	4,38 L/s	8,33 L/s	53,42 %
VEMS/CVF	84,42 %	82,75 %	95,61 %	82,84 %	99,89 %
Durée d'expiration	5,17 s	3,11 s	1,41 s	-	
DEMM	2,33 L/s	2,95 L/s	3,25 L/s	3,55 L/s	83,10 %
DEMM/CVF	0,84 s-1	0,86 s-1	1,10 s-1	0,93 s-1	92,47 %
DE75	2,82 L/s	4,03 L/s	4,12 L/s	-	
DE50	2,35 L/s	2,96 L/s	3,38 L/s	-	
DE25	1,49 L/s	1,41 L/s	2,46 L/s	-	