

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> NABY LAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 08/01/1986	<b>Profession</b> MAÇON
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 239	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 184 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 101 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,2 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 57 %

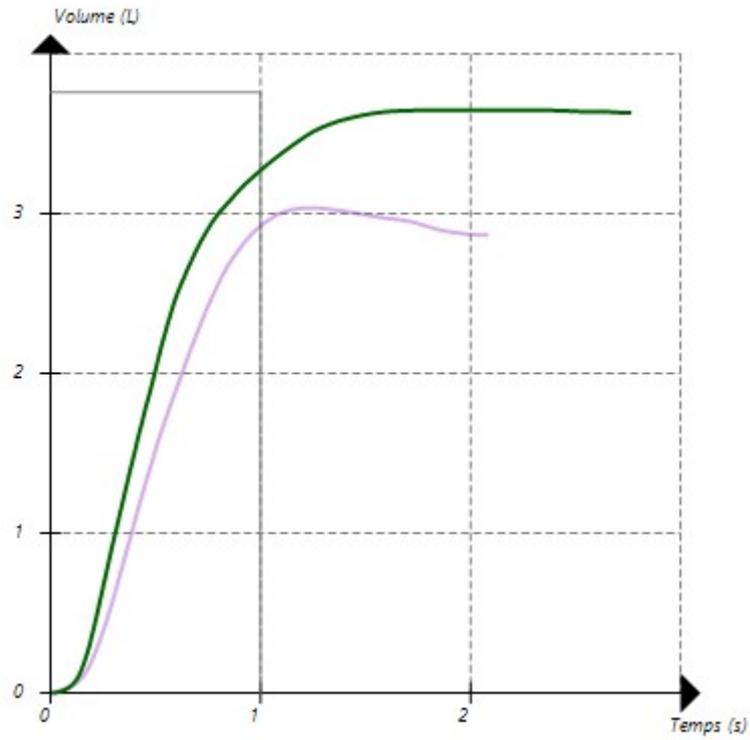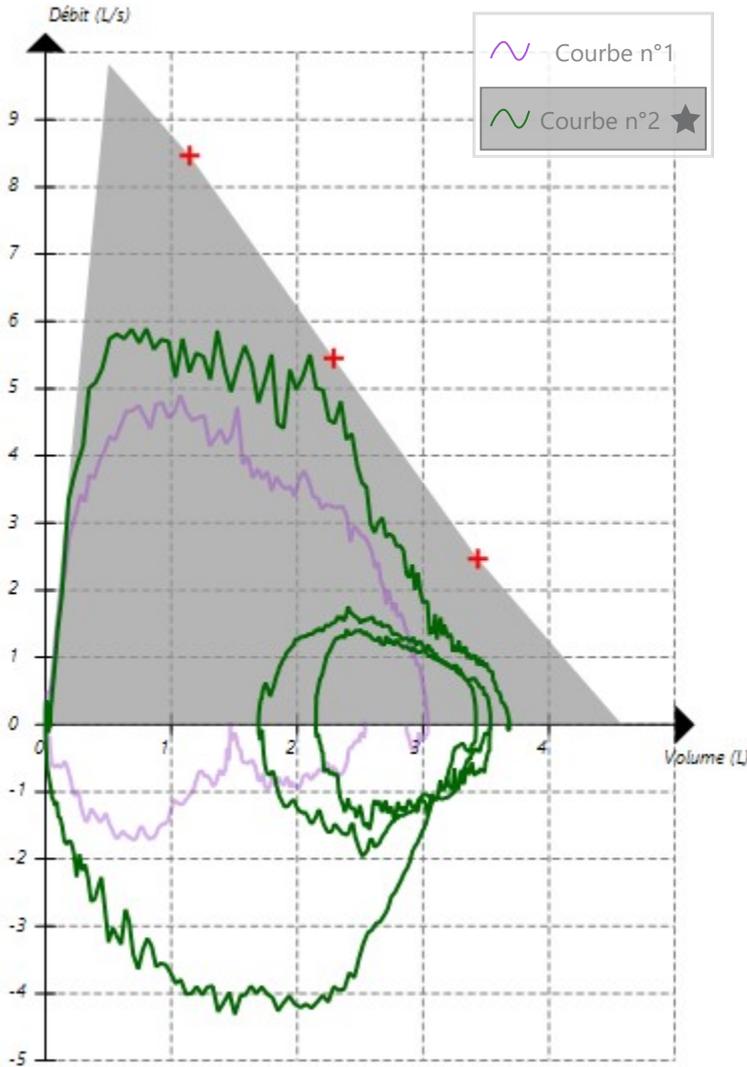

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,04 L	3,65 L	4,58 L	79,69 %
VEMS	3,03 L	3,39 L	3,76 L	90,16 %
DEP	5,05 L/s	6,80 L/s	9,83 L/s	69,18 %
VEMS/ CVF	99,67 %	92,88 %	80,41 %	115,51 %
Durée d'expiration	1,22 s	2,21 s	-	
DEMM	4,09 L/s	4,68 L/s	4,64 L/s	100,86 %
DEMM/ CVF	1,35 s-1	1,28 s-1	0,88 s-1	145,45 %
DE75	4,27 L/s	5,86 L/s	8,47 L/s	69,19 %
DE50	4,93 L/s	5,17 L/s	5,45 L/s	94,86 %
DE25	3,05 L/s	2,63 L/s	2,47 L/s	106,48 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: