

<b>Nom</b> MAMADOUNO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SAA YOLA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1992	<b>Profession</b> OPERATEUR BETONNIERE FIXE
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 87	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 47 %

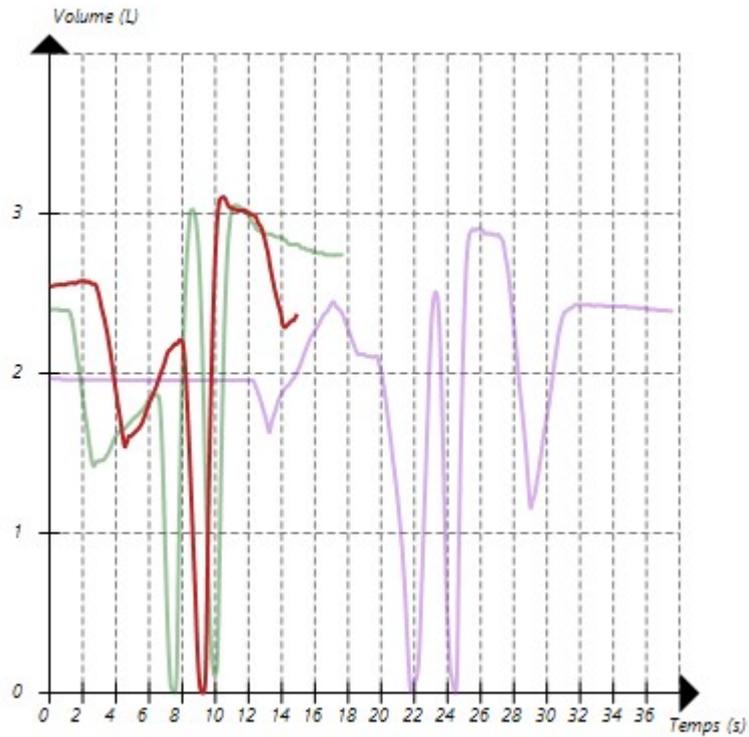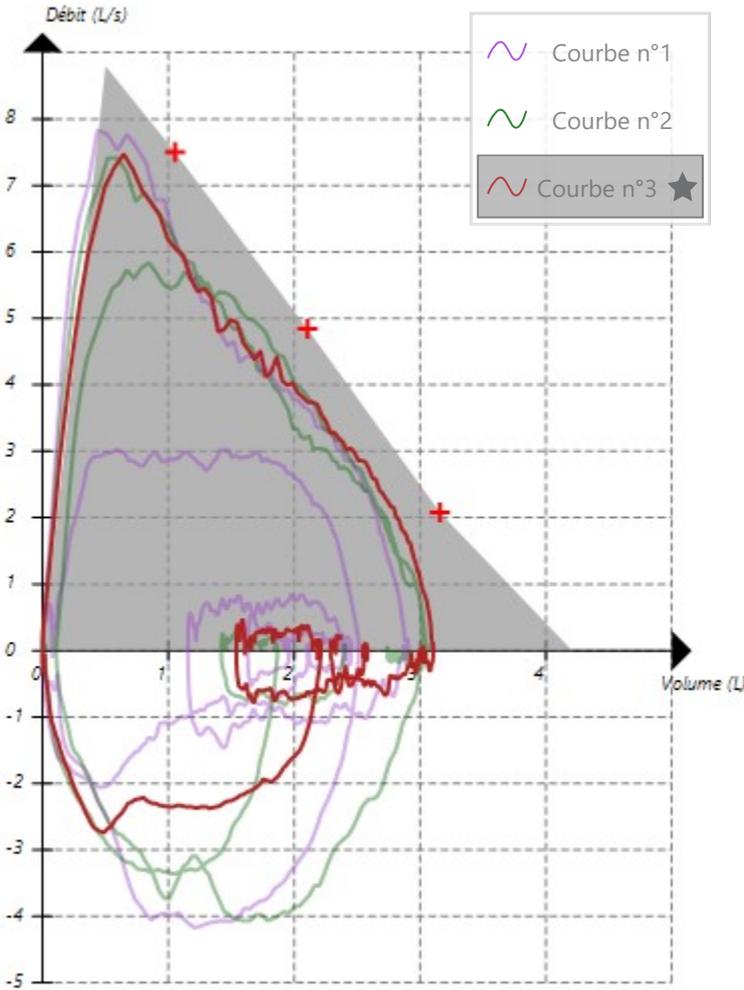

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,91 L	3,03 L	3,11 L	4,21 L	73,87 %
VEMS	2,90 L	3,03 L	3,10 L	3,59 L	86,35 %
DEP	8,00 L/s	7,55 L/s	7,59 L/s	8,80 L/s	86,25 %
VEMS/CVF	99,66 %	100,00 %	99,68 %	81,48 %	122,34 %
Durée d'expiration	1,35 s	1,06 s	1,20 s	-	
DEMM	4,94 L/s	4,66 L/s	4,79 L/s	4,49 L/s	106,68 %
DEMM/CVF	1,70 s-1	1,54 s-1	1,54 s-1	1,07 s-1	143,93 %
DE75	7,67 L/s	6,85 L/s	6,77 L/s	7,50 L/s	90,27 %
DE50	4,57 L/s	4,85 L/s	4,90 L/s	4,84 L/s	101,24 %
DE25	3,35 L/s	2,97 L/s	3,24 L/s	2,08 L/s	155,77 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: