

**Nom KAMANO**  
**Prénom JEAN FARA**  
**Né le** 01/06/1984  
**Age** 41 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 309  
**Taille** 178 cm  
**Poids** 83 kg  
**Valeurs prédites** Eccs/Zapletal  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MENUISIER  
**Entreprise** GPC  
**Service**  
**Fumeur** Ancien fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 3



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27,7 °C

Numéro de série : 253566

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 51 %

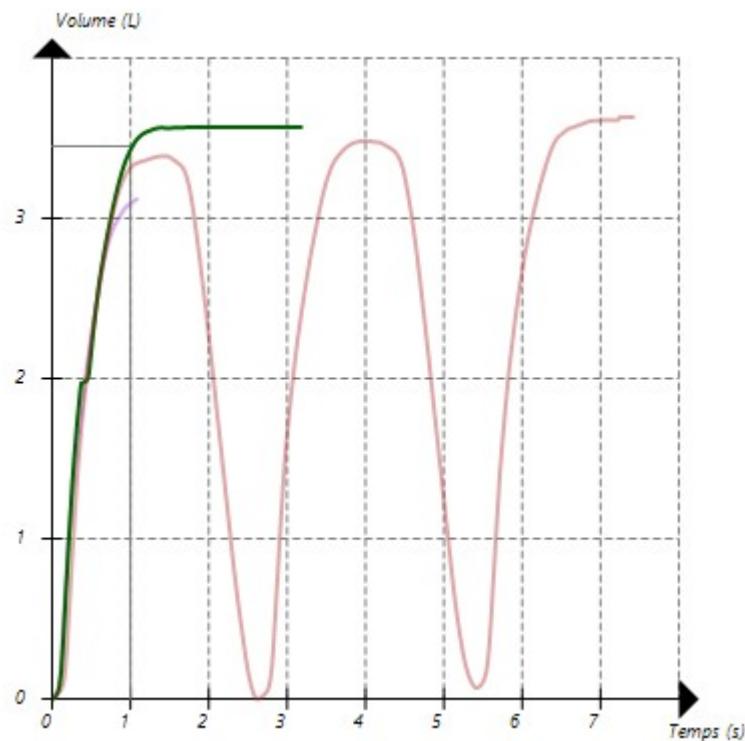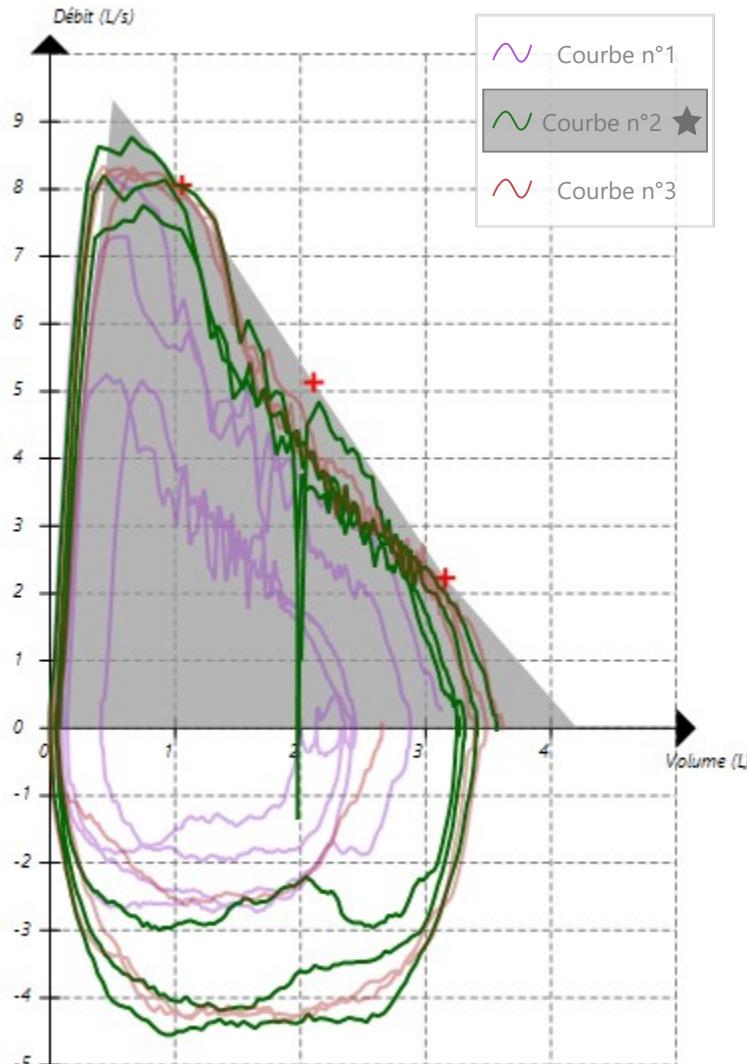

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,13 L	3,57 L	3,37 L	4,21 L	84,80 %
VEMS	3,12 L	3,50 L	3,34 L	3,45 L	101,45 %
DEP	8,27 L/s	8,82 L/s	8,49 L/s	9,33 L/s	94,53 %
VEMS/CVF	99,68 %	98,04 %	99,11 %	79,87 %	122,75 %
Durée d'expiration	1,12 s	1,73 s	1,41 s	-	
DEMM	4,55 L/s	4,21 L/s	4,97 L/s	4,40 L/s	95,68 %
DEMM/CVF	1,45 s <sup>-1</sup>	1,18 s <sup>-1</sup>	1,47 s <sup>-1</sup>	0,91 s <sup>-1</sup>	129,67 %
DE75	7,74 L/s	8,30 L/s	8,25 L/s	8,06 L/s	102,98 %
DE50	5,01 L/s	4,92 L/s	5,35 L/s	5,13 L/s	95,91 %
DE25	3,27 L/s	2,75 L/s	2,87 L/s	2,23 L/s	123,32 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Copyright 2015-2020 - FIM MEDICAL - (+33) 4 72 34 89 89 - (+33) 4 72 33 43 51

Signature de l'opérateur: