

<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABDOUL KARIM	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 29/08/2005	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 18 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 289	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 59 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,9 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 58 %

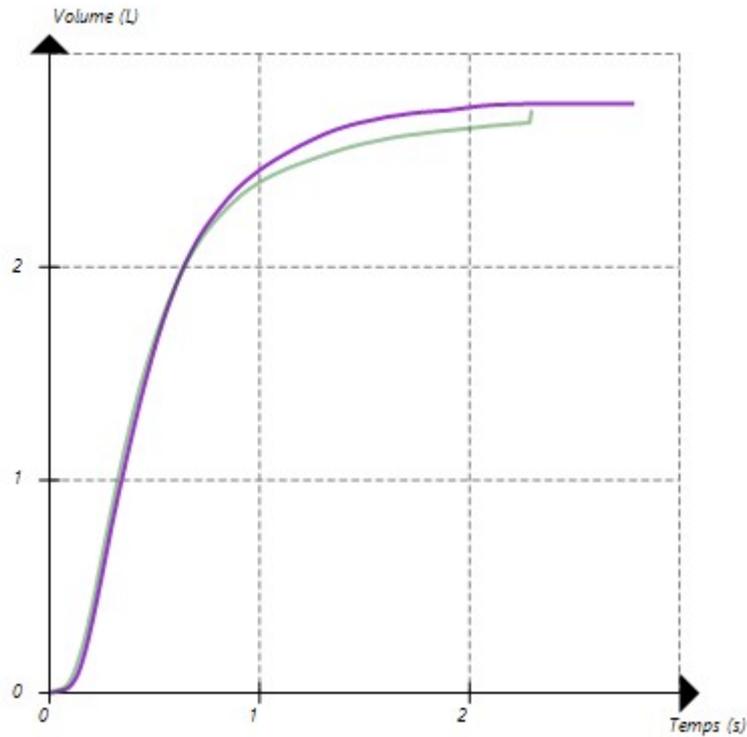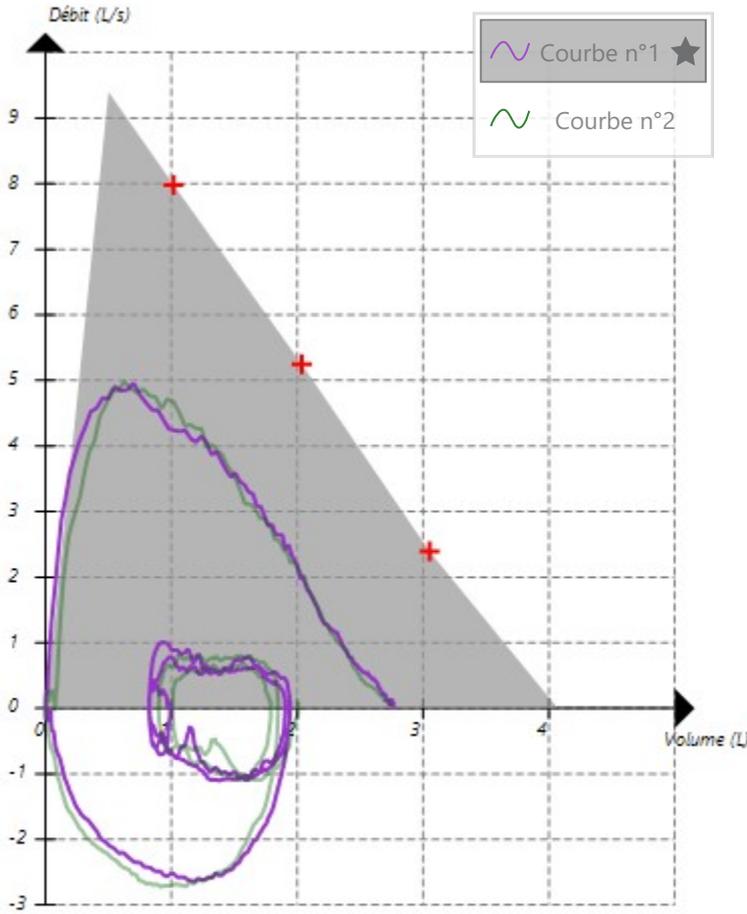

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,77 L	2,67 L	4,07 L	68,06 %
VEMS	2,54 L	2,45 L	3,49 L	72,78 %
DEP	5,06 L/s	5,06 L/s	9,40 L/s	53,83 %
VEMS/ CVF	91,70 %	91,76 %	82,74 %	110,83 %
Durée d'expiration	2,26 s	2,39 s	-	
DEMM	3,47 L/s	3,43 L/s	4,89 L/s	70,96 %
DEMM/ CVF	1,25 s-1	1,28 s-1	1,04 s-1	120,19 %
DE75	5,01 L/s	4,91 L/s	7,98 L/s	62,78 %
DE50	3,66 L/s	3,80 L/s	5,25 L/s	69,71 %
DE25	1,84 L/s	1,87 L/s	2,39 L/s	76,99 %