

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOUBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 25/06/1983	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MENUISIER
<b>ID</b> 222	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 84 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,6 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 54 %

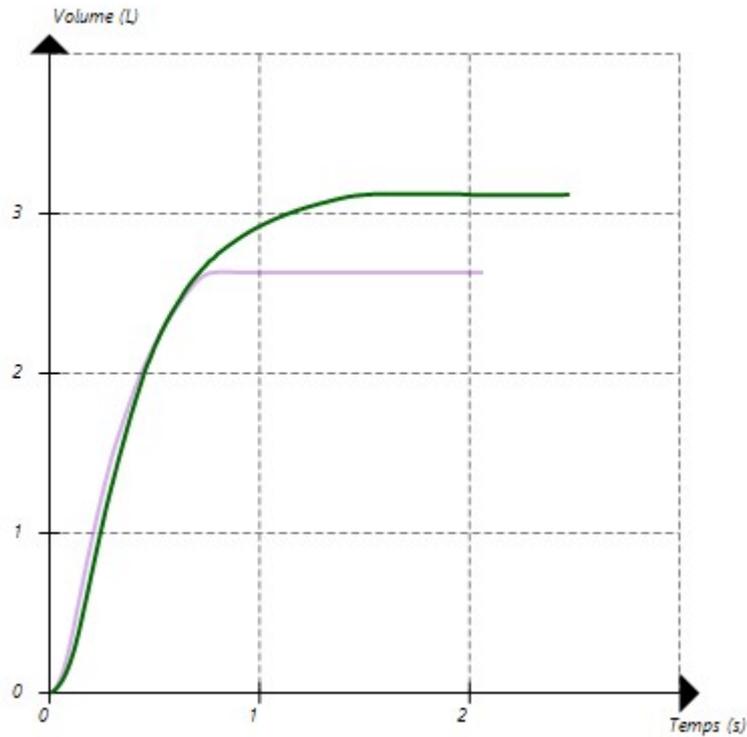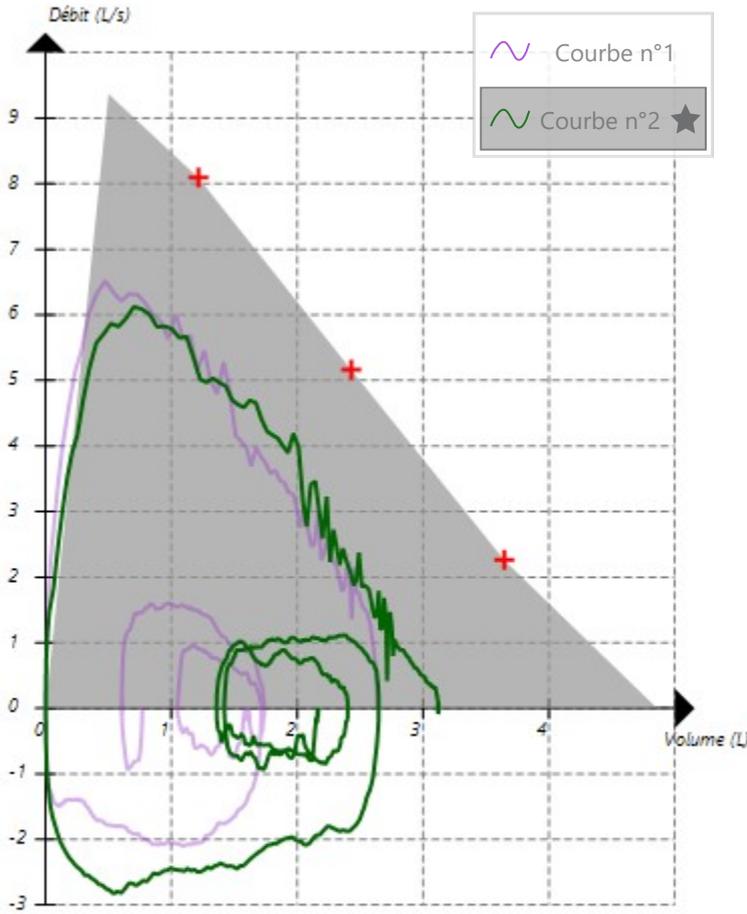

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,63 L	3,12 L	4,86 L	64,20 %
VEMS	2,63 L	2,97 L	4,00 L	74,25 %
DEP	6,66 L/s	6,31 L/s	9,37 L/s	67,34 %
VEMS/ CVF	100,00 %	95,19 %	80,05 %	118,91 %
Durée d'expiration	0,79 s	1,57 s	-	
DEMM	4,81 L/s	4,34 L/s	4,44 L/s	97,75 %
DEMM/ CVF	1,83 s-1	1,39 s-1	0,91 s-1	152,75 %
DE75	6,48 L/s	6,11 L/s	8,09 L/s	75,53 %
DE50	4,98 L/s	4,67 L/s	5,16 L/s	90,50 %
DE25	2,84 L/s	1,86 L/s	2,26 L/s	82,30 %