



<b>Nom</b> TOURE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ISMAEL	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 07/08/1998	<b>Profession</b> Maçon
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 252	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 159 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 59 %

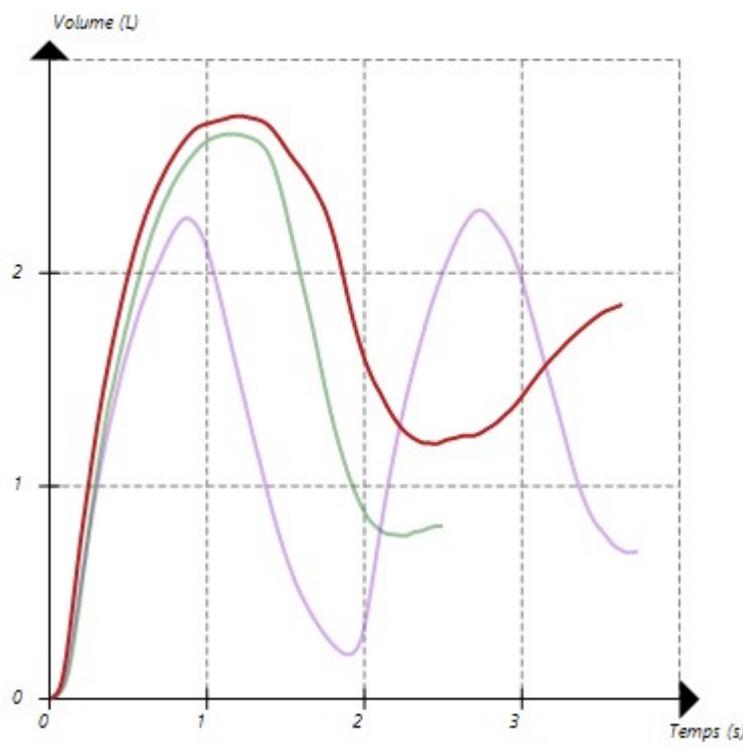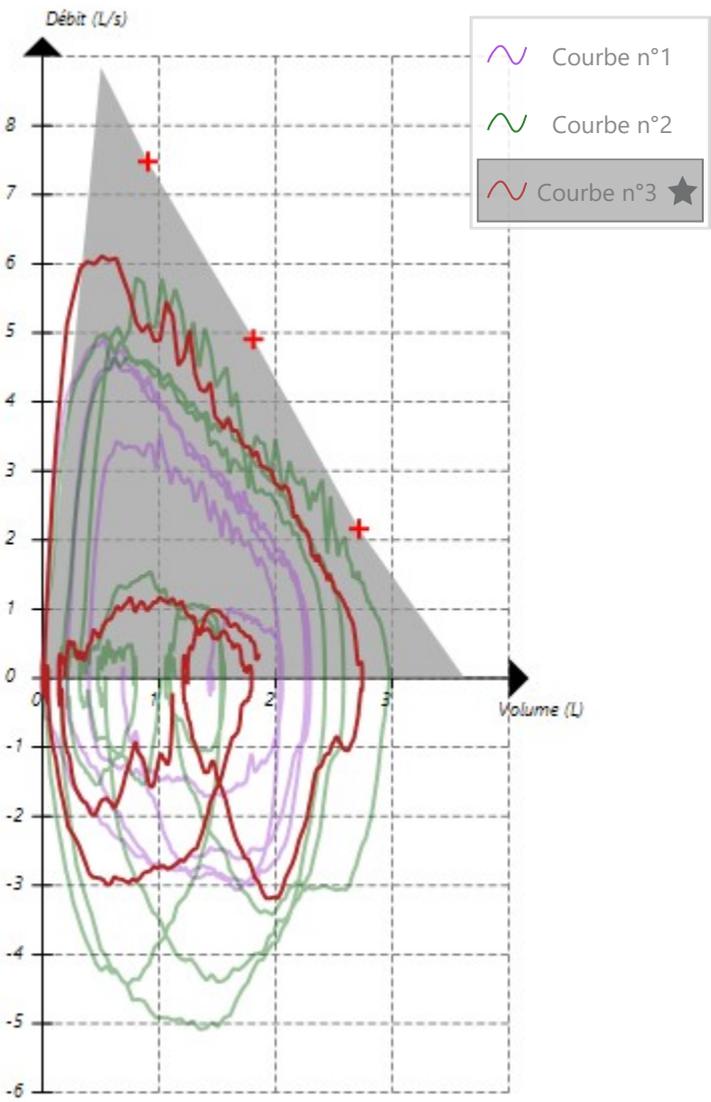

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,26 L	2,65 L	2,73 L	3,62 L	75,41 %
VEMS	2,26 L	2,65 L	2,71 L	3,15 L	86,03 %
DEP	5,07 L/s	6,20 L/s	6,45 L/s	8,85 L/s	72,88 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	99,27 %	82,74 %	119,98 %
Durée d'expiration	0,87 s	1,15 s	1,25 s	-	
DEMM	3,57 L/s	3,85 L/s	4,09 L/s	4,71 L/s	86,84 %
DEMM/ CVF	1,58 s-1	1,45 s-1	1,50 s-1	1,13 s-1	132,74 %
DE75	4,56 L/s	5,88 L/s	5,90 L/s	7,48 L/s	78,88 %
DE50	3,61 L/s	4,16 L/s	4,19 L/s	4,91 L/s	85,34 %
DE25	2,32 L/s	2,80 L/s	2,61 L/s	2,16 L/s	120,83 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: