



<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1977	<b>Profession</b> MENUISIER
<b>Age</b> 47 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 138	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	

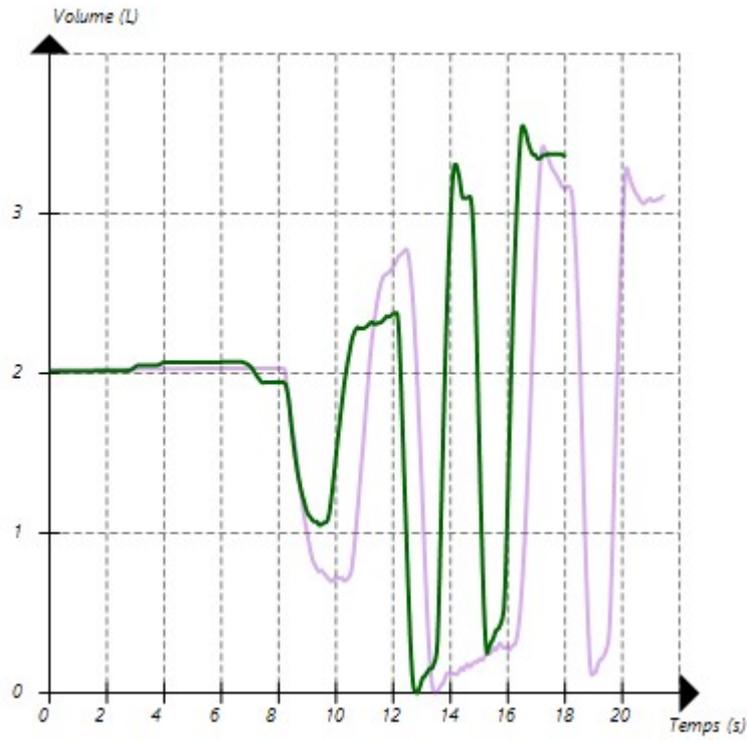

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 25,9 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 42 %

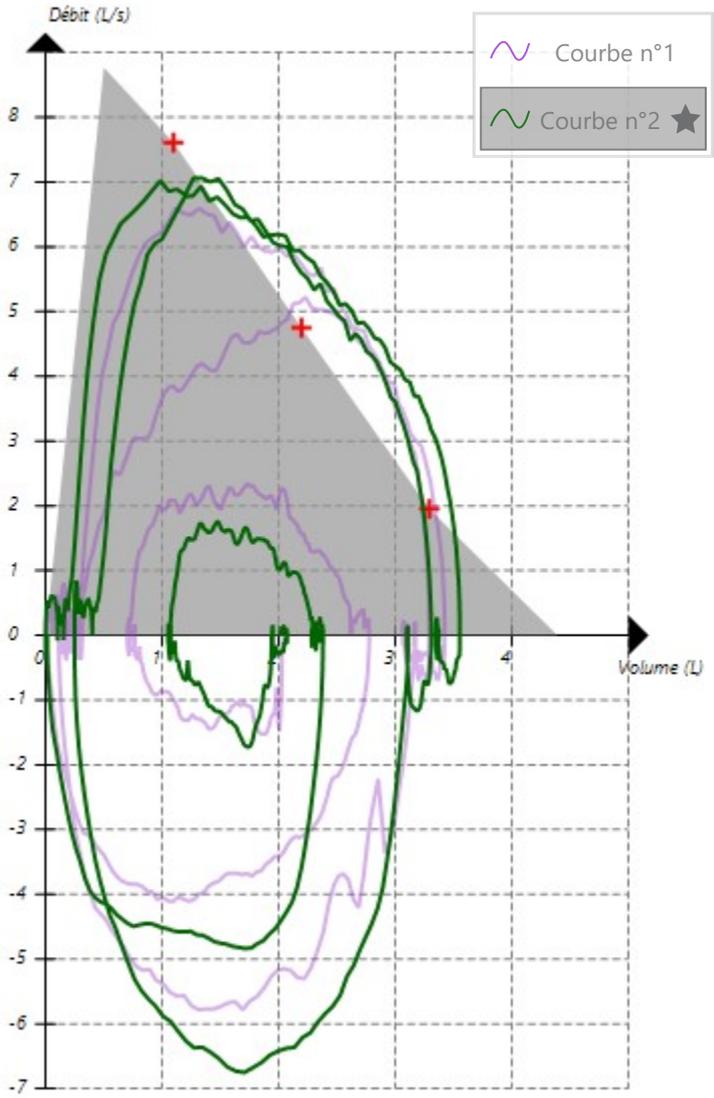

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,08 L	3,16 L	4,39 L	71,98 %
VEMS	3,08 L	3,16 L	3,59 L	88,02 %
DEP	6,85 L/s	7,19 L/s	8,77 L/s	81,98 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	78,80 %	126,90 %
Durée d'expiration	0,89 s	0,88 s	-	
DEMM	6,18 L/s	6,39 L/s	4,04 L/s	158,17 %
DEMM/CVF	2,01 s-1	2,02 s-1	0,92 s-1	219,57 %
DE75	6,20 L/s	6,86 L/s	7,61 L/s	90,14 %
DE50	6,19 L/s	6,50 L/s	4,75 L/s	136,84 %
DE25	5,08 L/s	4,96 L/s	1,95 L/s	254,36 %