



<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOULOUCOU SOULEYMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/10/2000	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 238	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,5 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 57 %

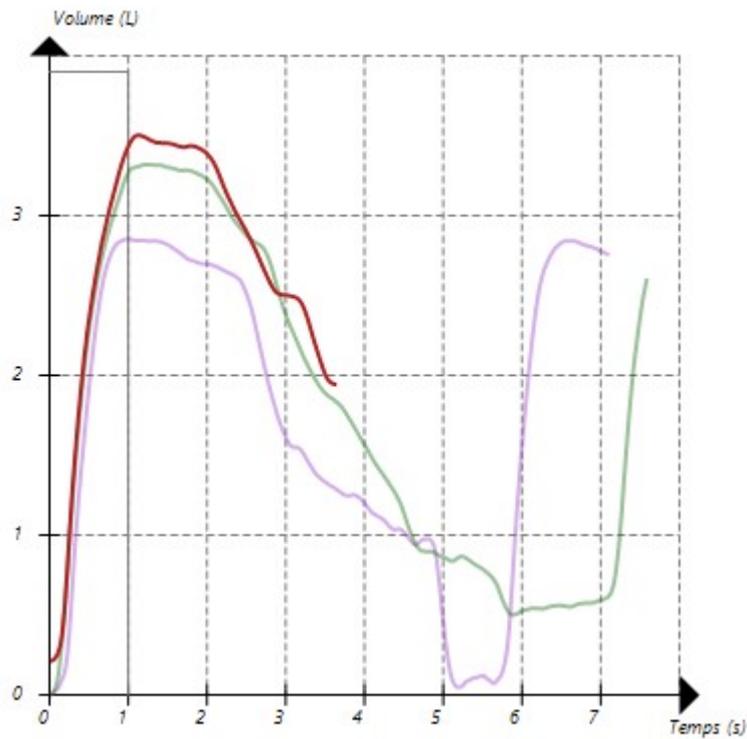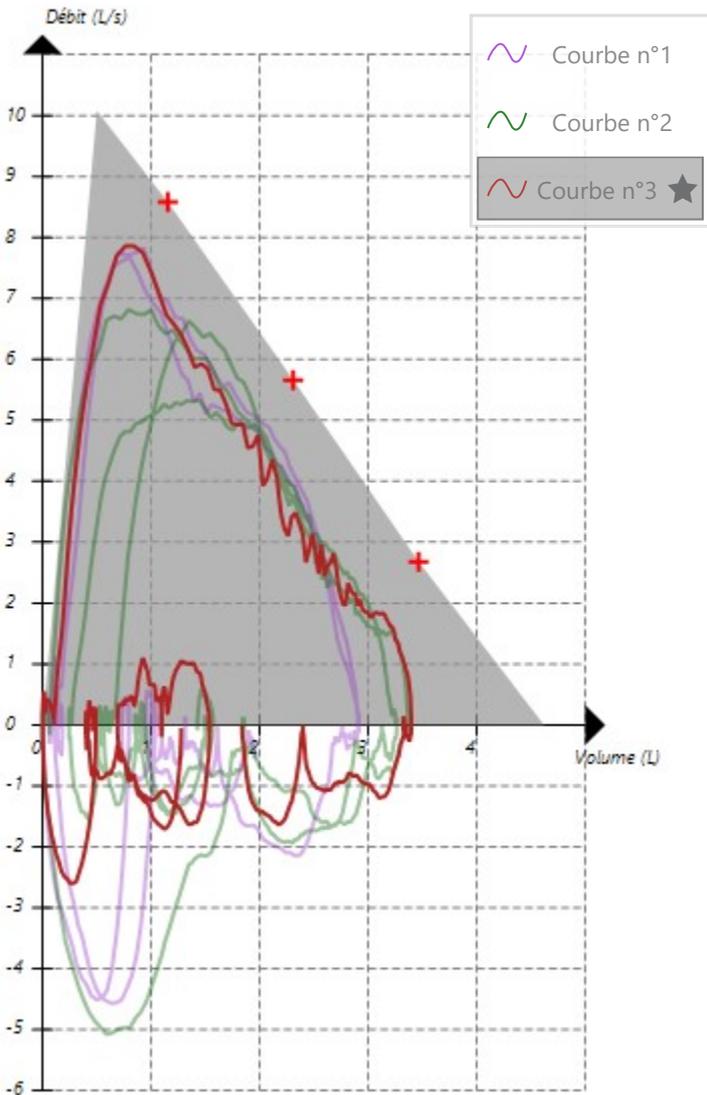

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,85 L	3,32 L	3,40 L	4,62 L	73,59 %
VEMS	2,85 L	3,30 L	3,40 L	3,90 L	87,18 %
DEP	7,89 L/s	6,90 L/s	7,88 L/s	10,08 L/s	78,17 %
VEMS/ CVF	100,00 %	99,40 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,98 s	1,26 s	1,54 s	-	
DEMM	5,62 L/s	4,98 L/s	4,84 L/s	5,10 L/s	94,90 %
DEMM/ CVF	1,97 s-1	1,50 s-1	1,42 s-1	0,96 s-1	147,92 %
DE75	7,89 L/s	6,71 L/s	7,86 L/s	8,58 L/s	91,61 %
DE50	5,16 L/s	5,42 L/s	5,27 L/s	5,66 L/s	93,11 %
DE25	4,31 L/s	2,76 L/s	2,46 L/s	2,68 L/s	91,79 %