

<b>Nom SYLLA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom MALICK</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/02/1997</b>	<b>Profession MECANICIEN</b>
<b>Age 27 Ans</b>	<b>Entreprise GPC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 342</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 178 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 69 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,6 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 55 %

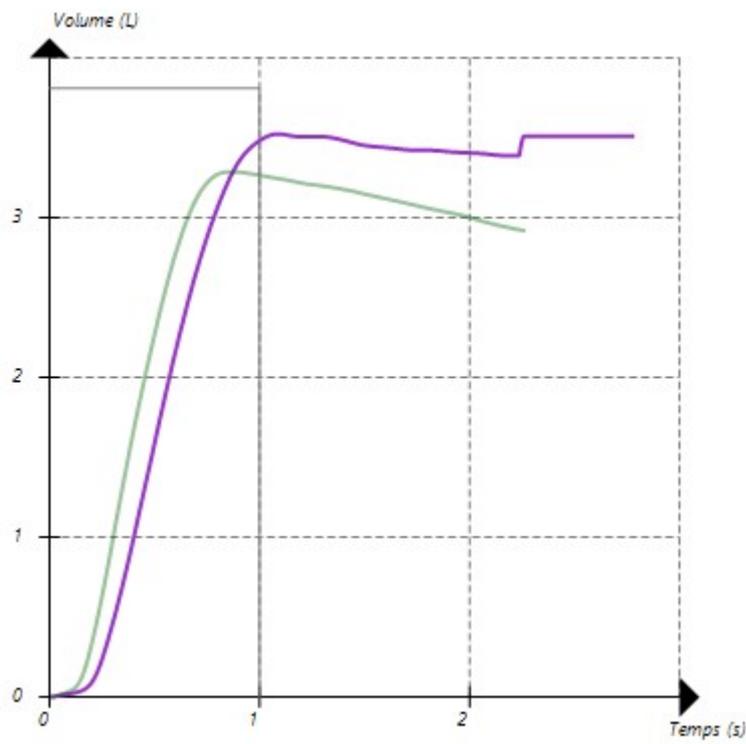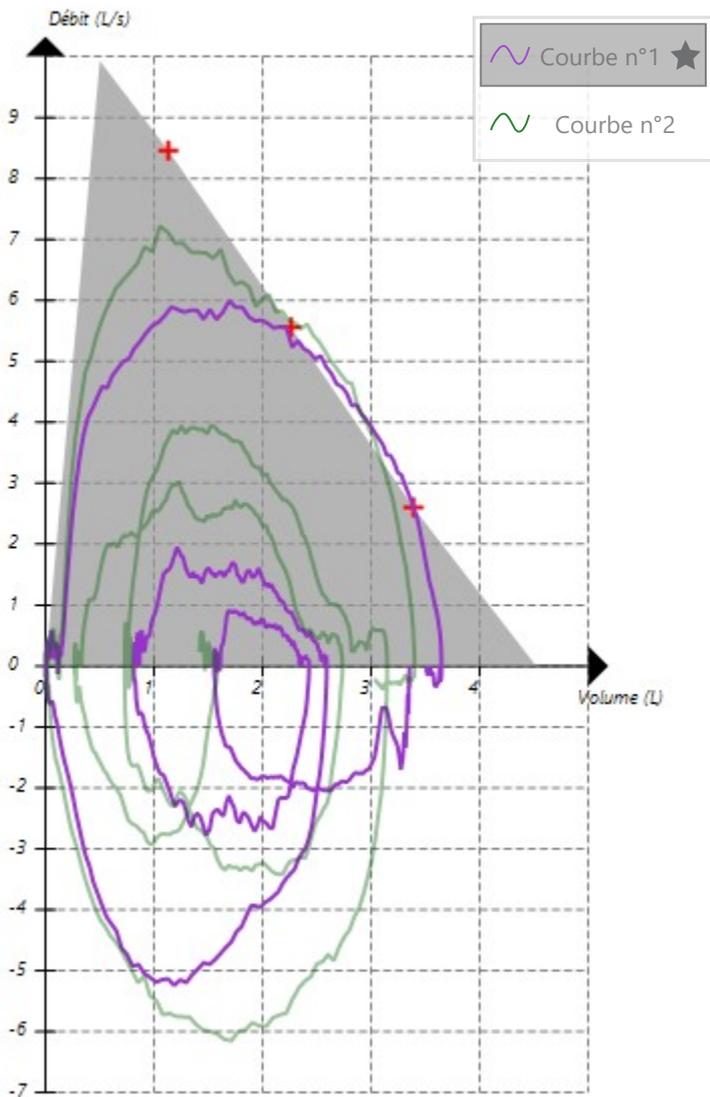

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,53 L	3,29 L	4,52 L	78,10 %
VEMS	3,53 L	3,29 L	3,81 L	92,65 %
DEP	6,10 L/s	7,39 L/s	9,93 L/s	61,43 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	82,38 %	121,39 %
Durée d'expiration	1,10 s	0,86 s	-	
DEMM	5,60 L/s	6,37 L/s	5,00 L/s	112,00 %
DEMM/CVF	1,59 s-1	1,94 s-1	0,96 s-1	165,62 %
DE75	5,54 L/s	6,84 L/s	8,46 L/s	65,48 %
DE50	5,71 L/s	6,02 L/s	5,56 L/s	102,70 %
DE25	4,43 L/s	5,21 L/s	2,60 L/s	170,38 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: