

Nom BANGOURA	Adresse
Prénom THOMAS	Exposition
Né le 23/06/1988	Profession MENUISIER
Age 35 Ans	Entreprise GPC
Genre Masculin	Service
ID 352	Fumeur Non fumeur
Taille 168 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids 69 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur admin admin	



Fim medical
51 rue Primat
+33 (0)4 72 34 89 89
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00


Température ambiante : 29,3 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Humidité : 52 %

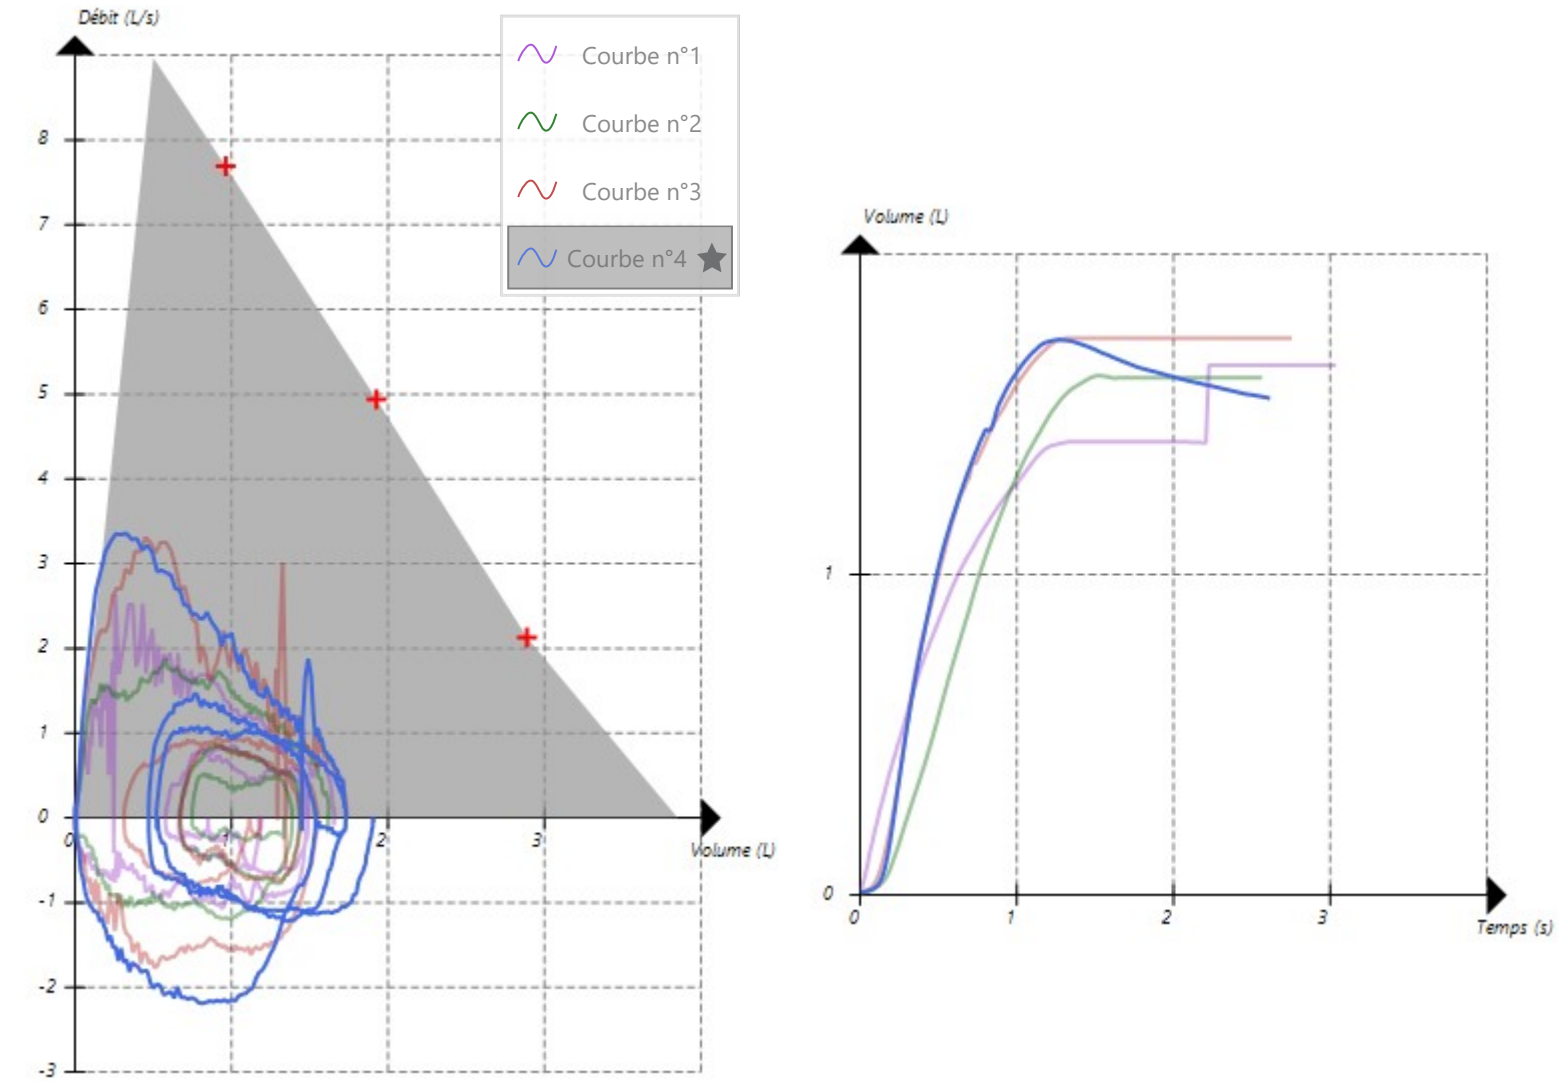

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,41 L	1,62 L	1,74 L	1,73 L	3,85 L	44,94 %
VEMS	1,29 L	1,48 L	1,68 L	1,71 L	3,24 L	52,78 %
DEP	3,15 L/s	2,03 L/s	3,41 L/s	3,40 L/s	8,97 L/s	37,90 %
VEMS/CVF	91,49 %	91,36 %	96,55 %	98,84 %	80,94 %	122,12 %
Durée d'expiration	1,63 s	1,54 s	1,61 s	1,36 s	-	
DEMM	1,37 L/s	1,59 L/s	2,04 L/s	2,15 L/s	4,46 L/s	48,21 %
DEMM/CVF	0,97 s-1	0,98 s-1	1,17 s-1	1,24 s-1	1,01 s-1	122,77 %
DE75	1,61 L/s	1,46 L/s	3,20 L/s	3,15 L/s	7,69 L/s	40,96 %
DE50	1,41 L/s	1,59 L/s	1,79 L/s	2,32 L/s	4,94 L/s	46,96 %
DE25	0,71 L/s	1,28 L/s	2,34 L/s	1,32 L/s	2,13 L/s	61,97 %