

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1989	<b>Profession</b> CHAUFFEUR CAMION PLATEAU
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 14	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 87 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:** NORMAL



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 37 %

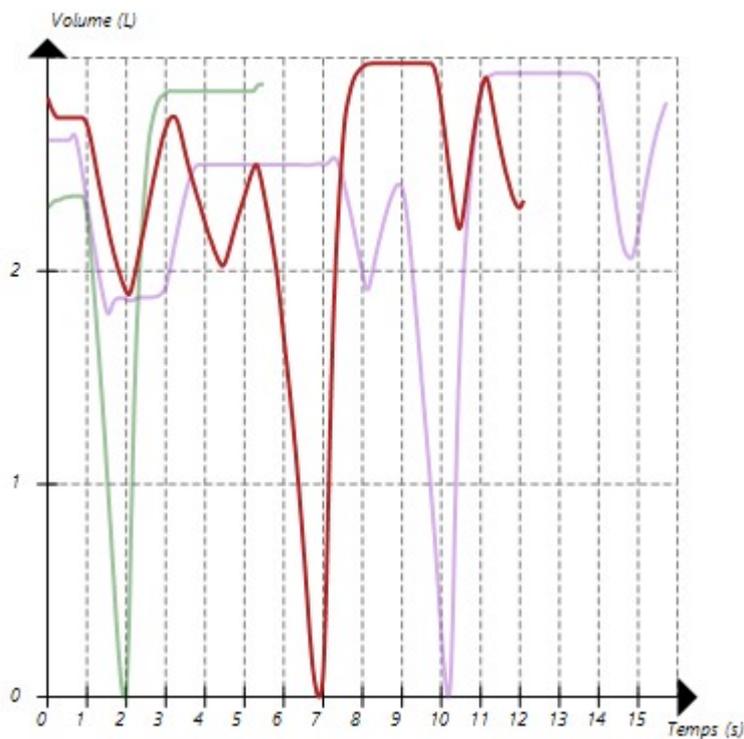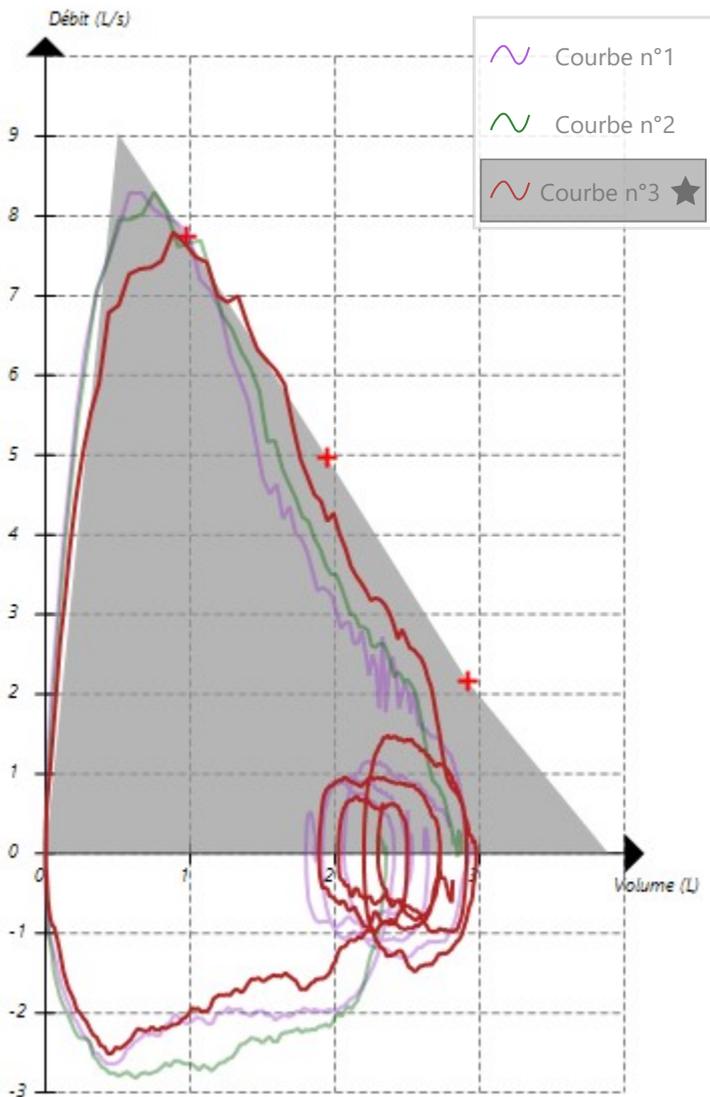

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,93 L	2,88 L	2,98 L	3,89 L	76,61 %
VEMS	2,92 L	2,84 L	2,96 L	3,27 L	90,52 %
DEP	8,37 L/s	8,55 L/s	7,92 L/s	9,04 L/s	87,61 %
VEMS/ CVF	99,66 %	98,61 %	99,33 %	80,94 %	122,72 %
Durée d'expiration	1,18 s	3,44 s	2,81 s	-	
DEMM	4,78 L/s	5,33 L/s	5,66 L/s	4,48 L/s	126,34 %
DEMM/ CVF	1,63 s-1	1,85 s-1	1,90 s-1	1,00 s-1	190,00 %
DE75	8,14 L/s	8,03 L/s	7,59 L/s	7,74 L/s	98,06 %
DE50	5,19 L/s	5,78 L/s	6,25 L/s	4,97 L/s	125,75 %
DE25	2,70 L/s	2,86 L/s	3,18 L/s	2,16 L/s	147,22 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: