



<b>Nom</b> DIAWARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1984	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 389	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 161 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,3 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 52 %

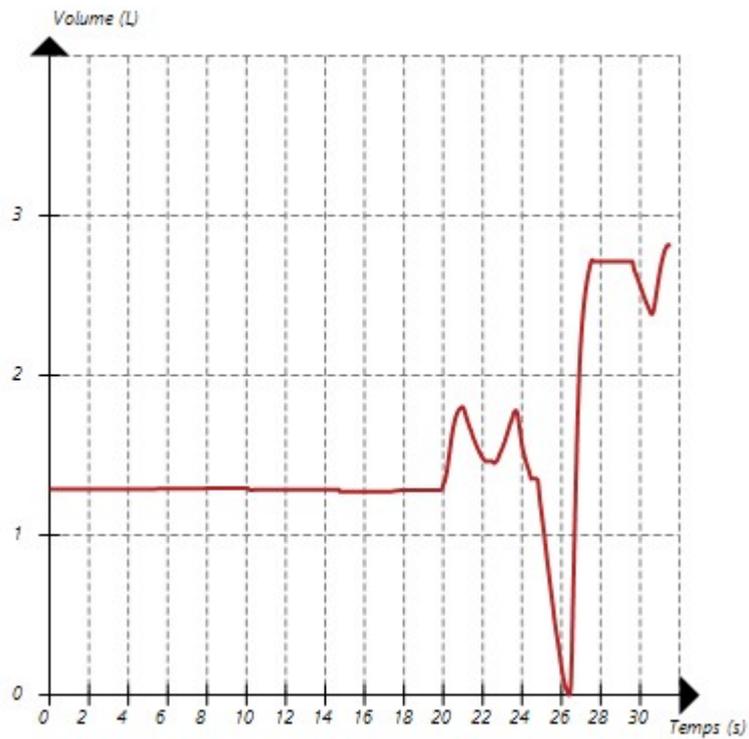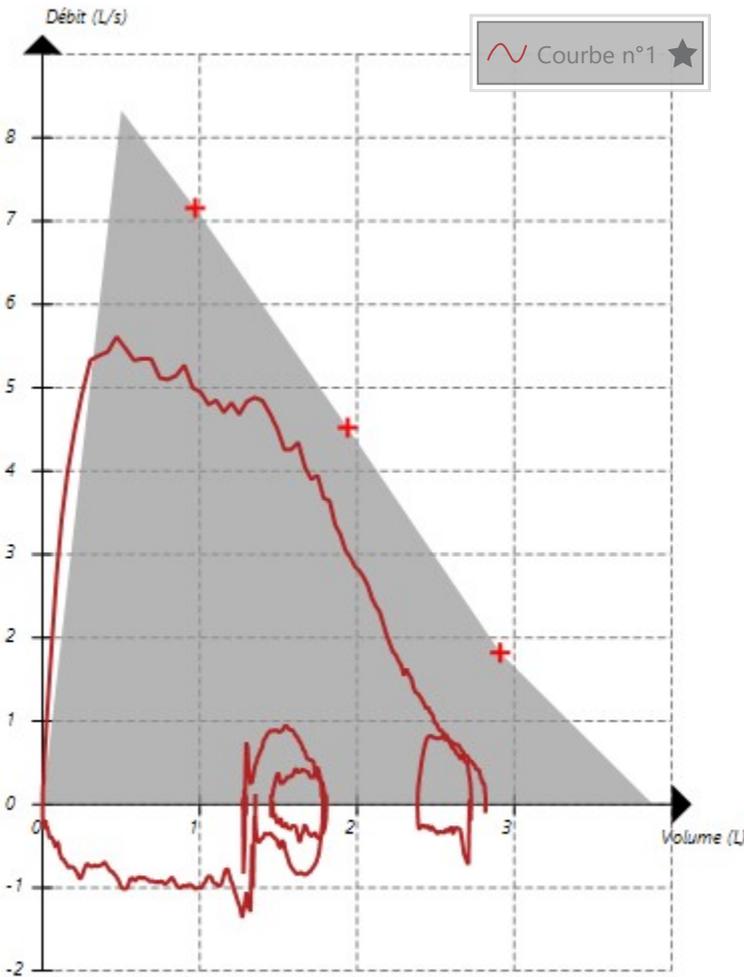

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,72 L	3,88 L	70,10 %
VEMS	2,70 L	3,27 L	82,57 %
DEP	5,66 L/s	8,33 L/s	67,95 %
VEMS/ CVF	99,26 %	80,05 %	124,00 %
Durée d'expiration	1,18 s	-	
DEMM	4,37 L/s	4,11 L/s	106,33 %
DEMM/ CVF	1,61 s-1	1,06 s-1	151,89 %
DE75	5,38 L/s	7,16 L/s	75,14 %
DE50	4,91 L/s	4,52 L/s	108,63 %
DE25	2,76 L/s	1,82 L/s	151,65 %