



<b>Nom</b> SAGNO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KANVALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 26/06/1983	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 170	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 85 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	

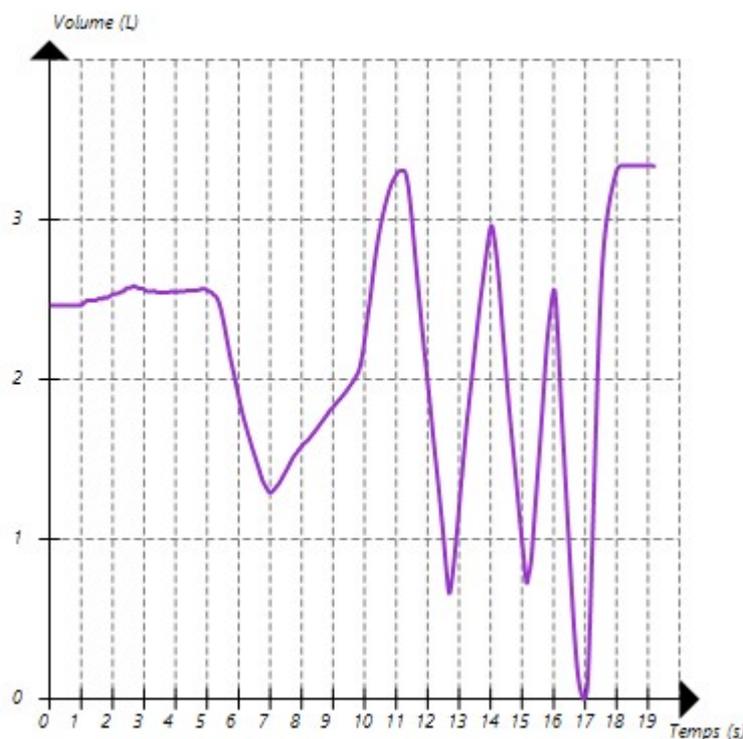

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,8 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 699,1 mmHg  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 49 %

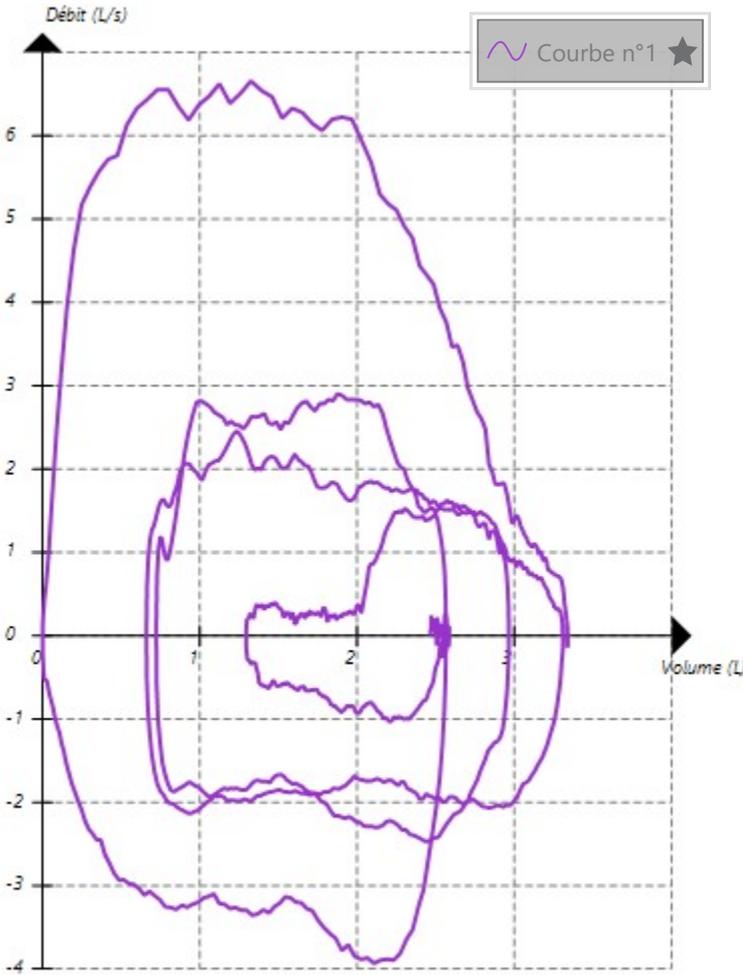

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,34 L	3,71 L	90,03 %
VEMS	3,33 L	3,05 L	109,18 %
DEP	6,75 L/s	8,12 L/s	83,13 %
VEMS/ CVF	99,70 %	81,93 %	121,69 %
Durée d'expiration	1,44 s	-	
DEMM	5,98 L/s	3,34 L/s	179,04 %
DEMM/ CVF	1,79 s-1	0,90 s-1	198,89 %
DE75	6,36 L/s	-	
DE50	6,15 L/s	-	
DE25	4,01 L/s	-	