

<b>Nom</b> SOUMAH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BABARA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 320	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 69 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire mixte.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,6 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 55 %

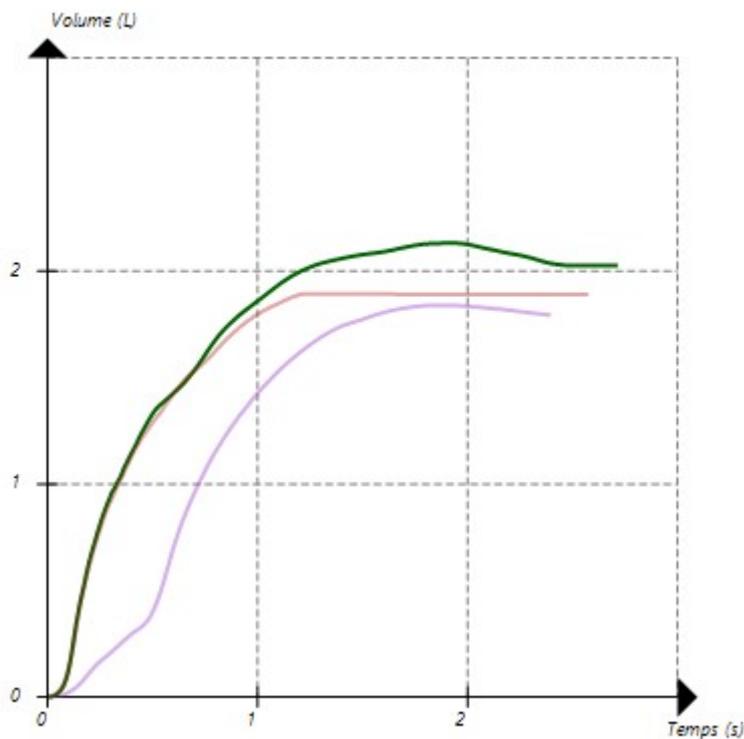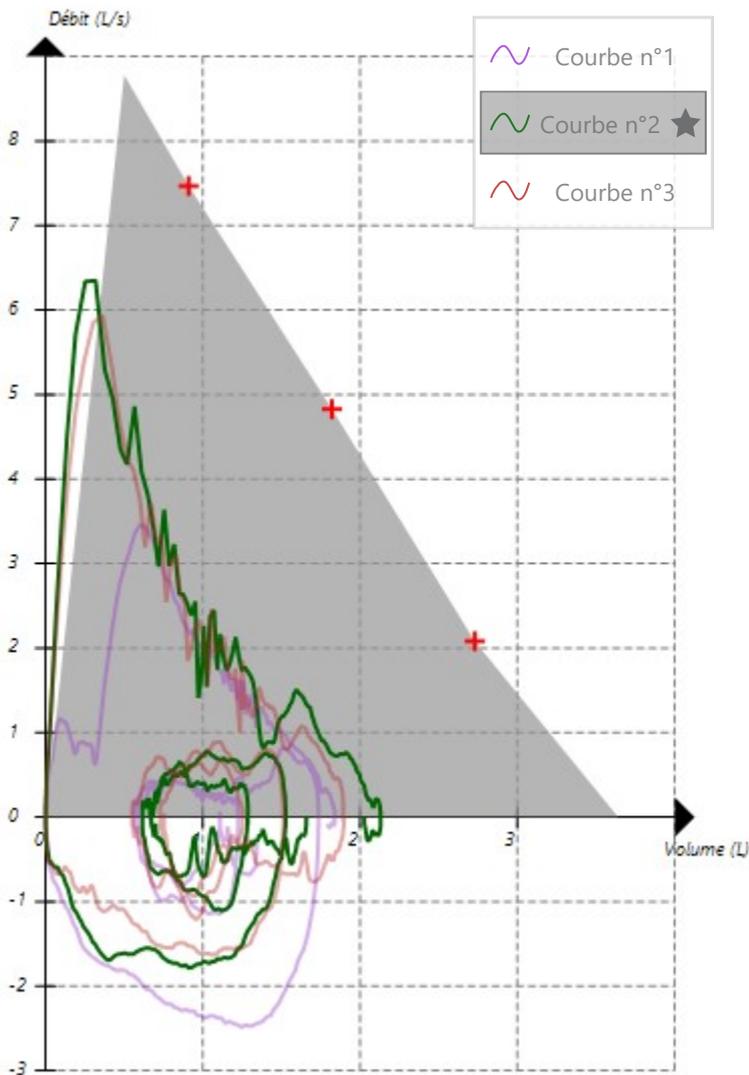

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	1,84 L	2,13 L	1,89 L	3,64 L	58,52 %
VEMS	1,74 L	1,91 L	1,84 L	3,11 L	61,41 %
DEP	3,52 L/s	6,61 L/s	5,99 L/s	8,78 L/s	75,28 %
VEMS/ CVF	94,57 %	89,67 %	97,35 %	81,66 %	109,81 %
Durée d'expiration	1,84 s	1,94 s	1,23 s	-	
DEMM	2,11 L/s	1,87 L/s	2,19 L/s	4,52 L/s	41,37 %
DEMM/ CVF	1,15 s-1	0,88 s-1	1,16 s-1	1,08 s-1	81,48 %
DE75	2,67 L/s	4,50 L/s	4,68 L/s	7,47 L/s	60,24 %
DE50	2,16 L/s	2,57 L/s	2,42 L/s	4,83 L/s	53,21 %
DE25	1,28 L/s	1,51 L/s	1,33 L/s	2,08 L/s	72,60 %