

**Nom TRAORE**  
**Prénom SAMBA**  
**Né le** 18/07/1987  
**Age** 38 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 751  
**Taille** 184 cm  
**Poids** 69 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** PLOMBIER  
**Entreprise** WELHY  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27,8 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 87,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 56 %

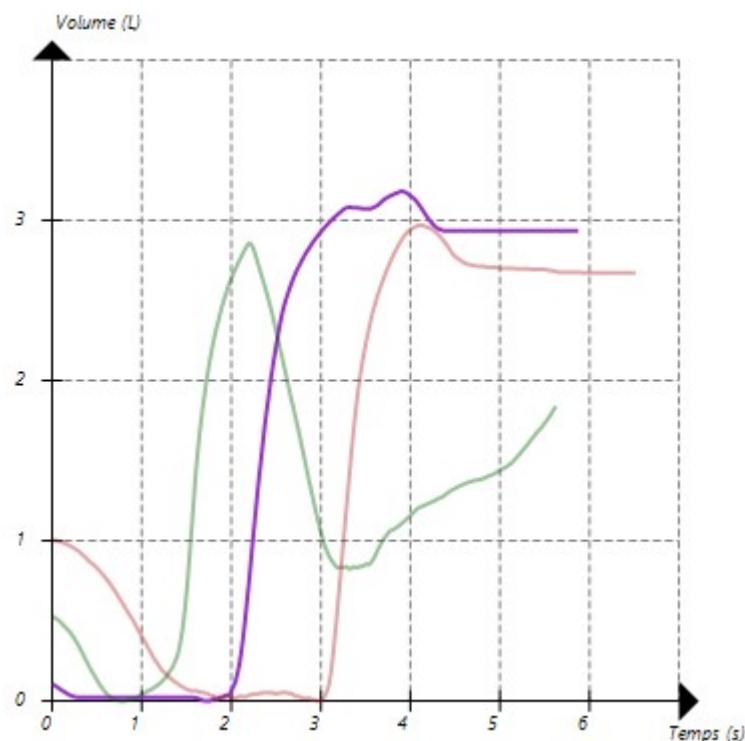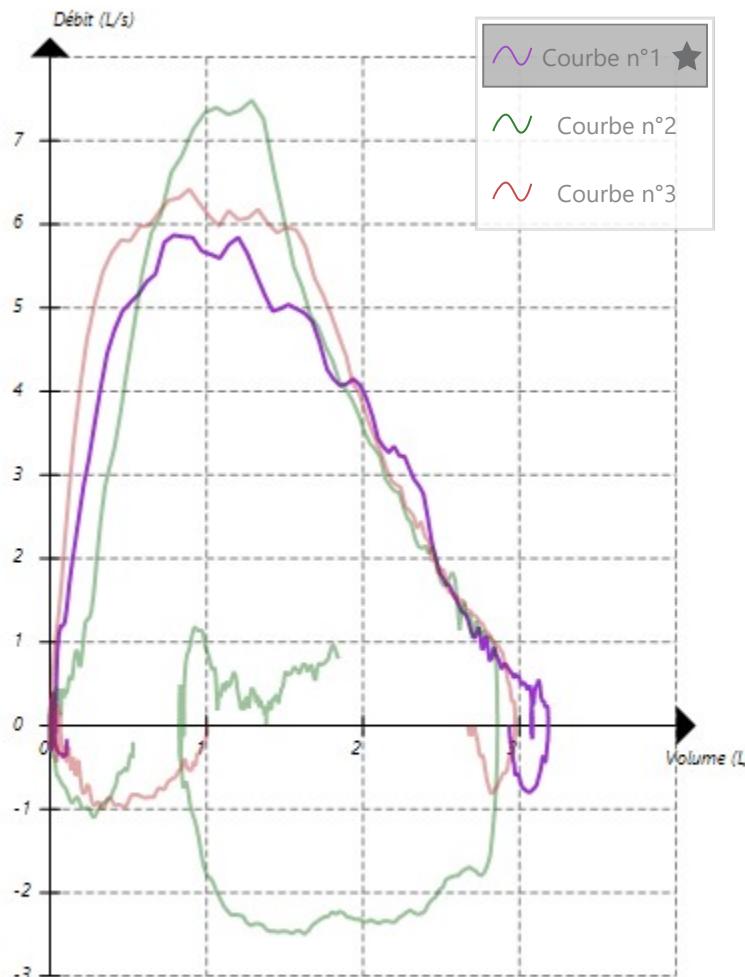

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,15 L	2,86 L	2,97 L	4,79 L	65,76 %
VEMS	2,94 L	2,86 L	2,97 L	3,93 L	74,81 %
DEP	5,92 L/s	7,51 L/s	6,52 L/s	9,93 L/s	59,62 %
VEMS/CVF	93,33 %	100,00 %	100,00 %	82,29 %	113,42 %
Durée d'expiration	1,94 s	1,40 s	1,13 s	-	
DEMM	4,51 L/s	5,49 L/s	5,14 L/s	4,08 L/s	110,54 %
DEMM/CVF	1,43 s <sup>-1</sup>	1,92 s <sup>-1</sup>	1,73 s <sup>-1</sup>	0,85 s <sup>-1</sup>	168,24 %
DE75	5,82 L/s	6,16 L/s	6,23 L/s	-	
DE50	4,98 L/s	6,58 L/s	5,99 L/s	-	
DE25	2,64 L/s	2,86 L/s	2,84 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Copyright 2015-2020 - FIM MEDICAL - (+33) 4 72 34 89 89 - (+33) 4 72 33 43 51

Signature de l'opérateur: