



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AMARA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> NETTOYEUR
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> WELHY-CIS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 61	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 3
<b>Opérateur</b> admin admin	

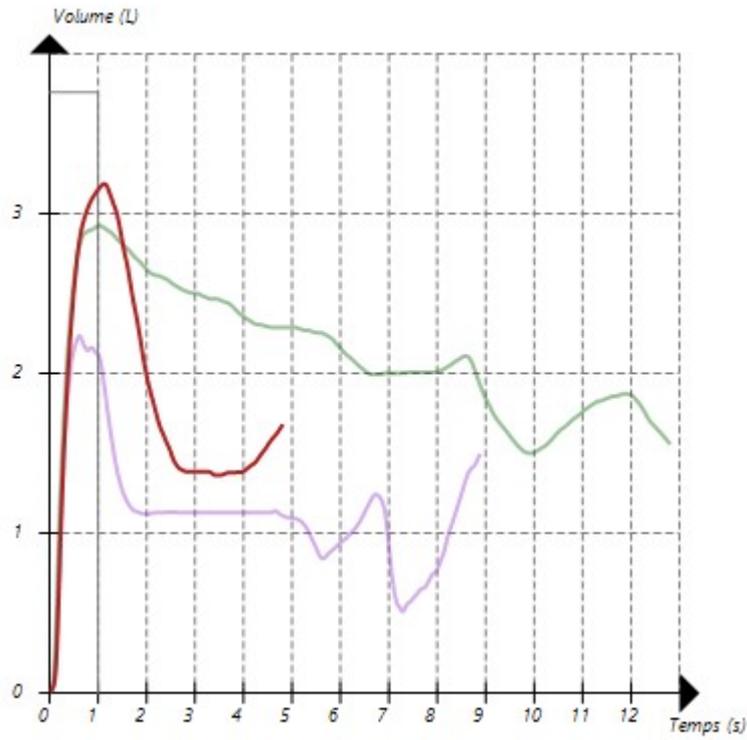

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,4 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 47 %

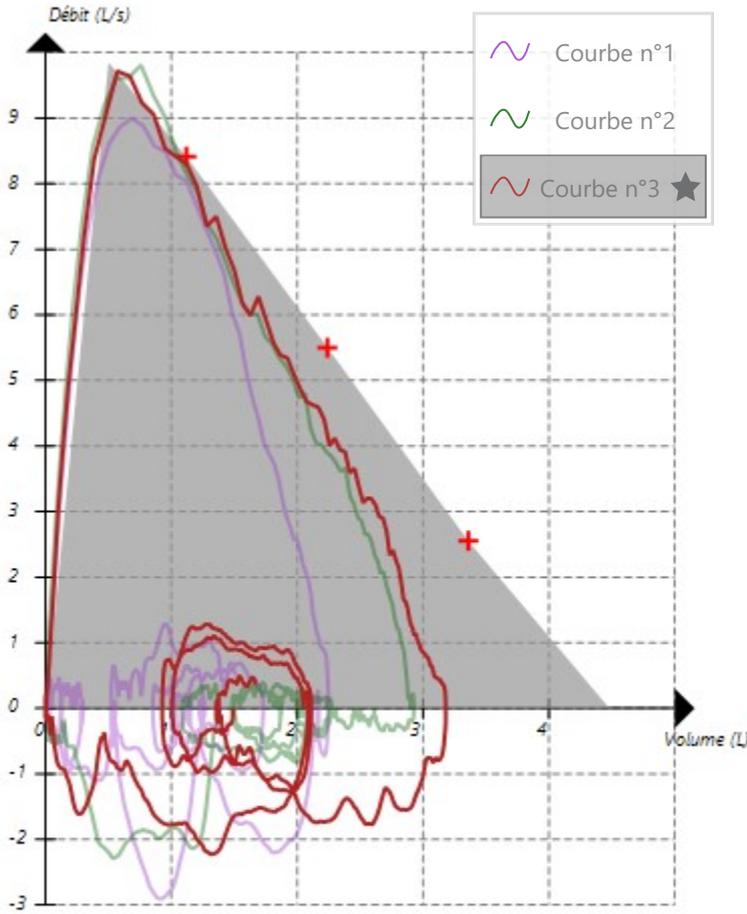

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,24 L	2,93 L	3,18 L	4,48 L	70,98 %
VEMS	2,24 L	2,93 L	3,18 L	3,76 L	84,57 %
DEP	9,11 L/s	9,96 L/s	9,79 L/s	9,85 L/s	99,39 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,02 %	121,92 %
Durée d'expiration	0,62 s	1,05 s	1,20 s	-	
DEMM	7,36 L/s	6,53 L/s	6,16 L/s	4,91 L/s	125,46 %
DEMM/CVF	3,29 s-1	2,23 s-1	1,94 s-1	0,95 s-1	204,21 %
DE75	8,82 L/s	9,84 L/s	9,56 L/s	8,41 L/s	113,67 %
DE50	8,03 L/s	6,59 L/s	6,02 L/s	5,50 L/s	109,45 %
DE25	4,47 L/s	3,92 L/s	3,92 L/s	2,55 L/s	153,73 %