



<b>Nom</b> MAMY	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MISSAN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/04/1971	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 53 Ans	<b>Entreprise</b> WELHY
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> CUISINIER
<b>ID</b> 236	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 76 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 57 %

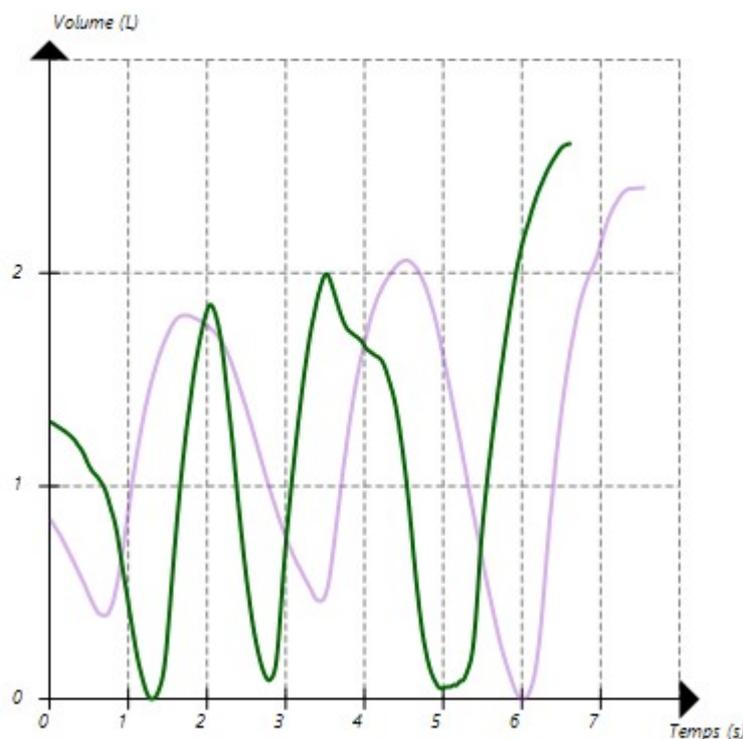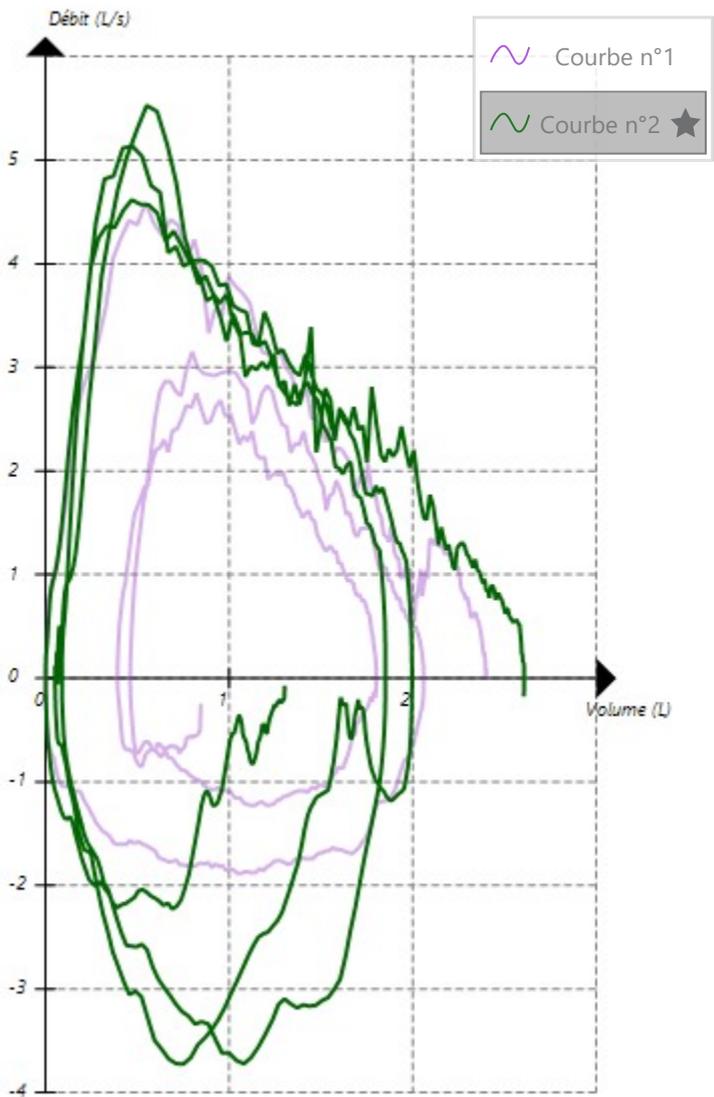

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,40 L	2,54 L	3,52 L	72,16 %
VEMS	2,31 L	2,44 L	2,80 L	87,14 %
DEP	4,72 L/s	5,61 L/s	7,69 L/s	72,95 %
VEMS/ CVF	96,25 %	96,06 %	79,55 %	120,75 %
Durée d'expiration	1,54 s	1,44 s	-	
DEMM	2,99 L/s	2,91 L/s	2,82 L/s	103,19 %
DEMM/ CVF	1,25 s-1	1,15 s-1	0,80 s-1	143,75 %
DE75	4,40 L/s	4,91 L/s	-	
DE50	3,03 L/s	2,75 L/s	-	
DE25	1,80 L/s	1,95 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: