


<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LONCENY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1992	<b>Profession</b> PLONGEUR
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> WELHY-CIS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 45	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 24,9 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 46 %

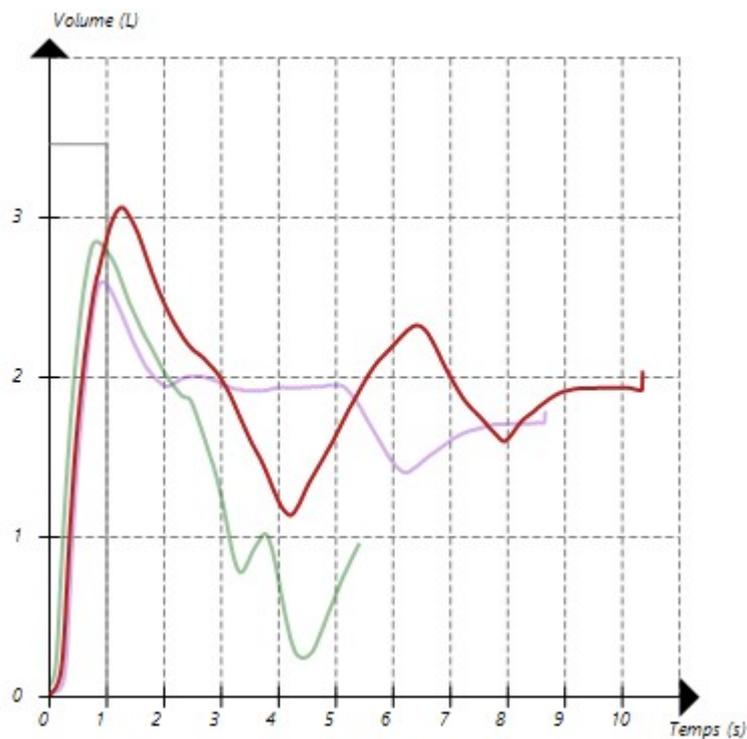

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,59 L	2,81 L	3,06 L	4,12 L	74,27 %
VEMS	2,59 L	2,81 L	3,04 L	3,46 L	87,86 %
DEP	7,56 L/s	7,48 L/s	8,14 L/s	9,35 L/s	87,06 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	99,35 %	81,48 %	121,93 %
Durée d'expiration	1,15 s	1,17 s	1,34 s	-	
DEMM	5,00 L/s	5,15 L/s	4,21 L/s	4,67 L/s	90,15 %
DEMM/ CVF	1,93 s-1	1,83 s-1	1,38 s-1	0,99 s-1	139,39 %
DE75	6,82 L/s	7,04 L/s	6,65 L/s	7,99 L/s	83,23 %
DE50	4,84 L/s	4,93 L/s	4,25 L/s	5,18 L/s	82,05 %
DE25	3,56 L/s	3,69 L/s	2,53 L/s	2,31 L/s	109,52 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: