

<b>Nom</b> SQUARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FATOUMATA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2002	<b>Profession</b> NETTOYEUR
<b>Age</b> 22 Ans	<b>Entreprise</b> WELHY-CIS
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 06	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:** NORMAL



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,9 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 41 %

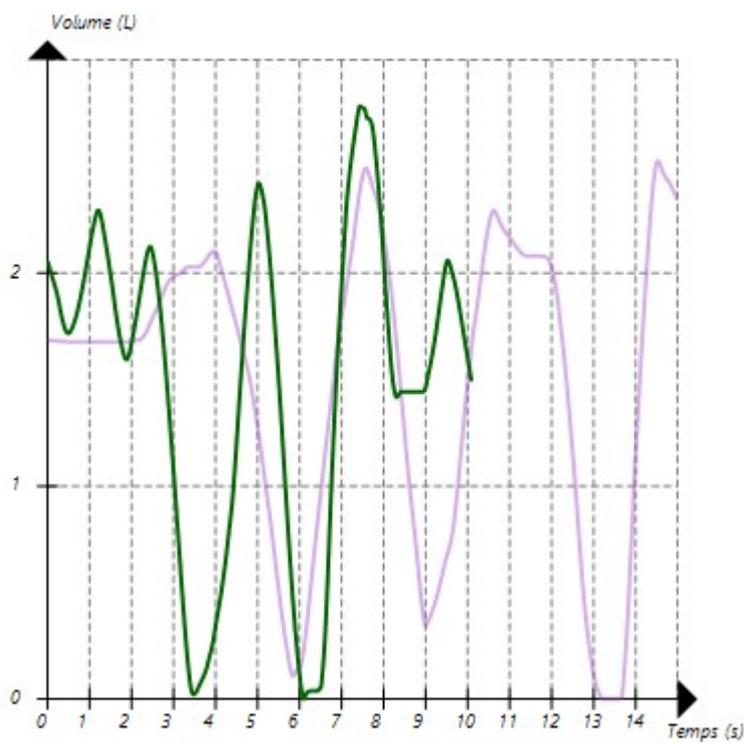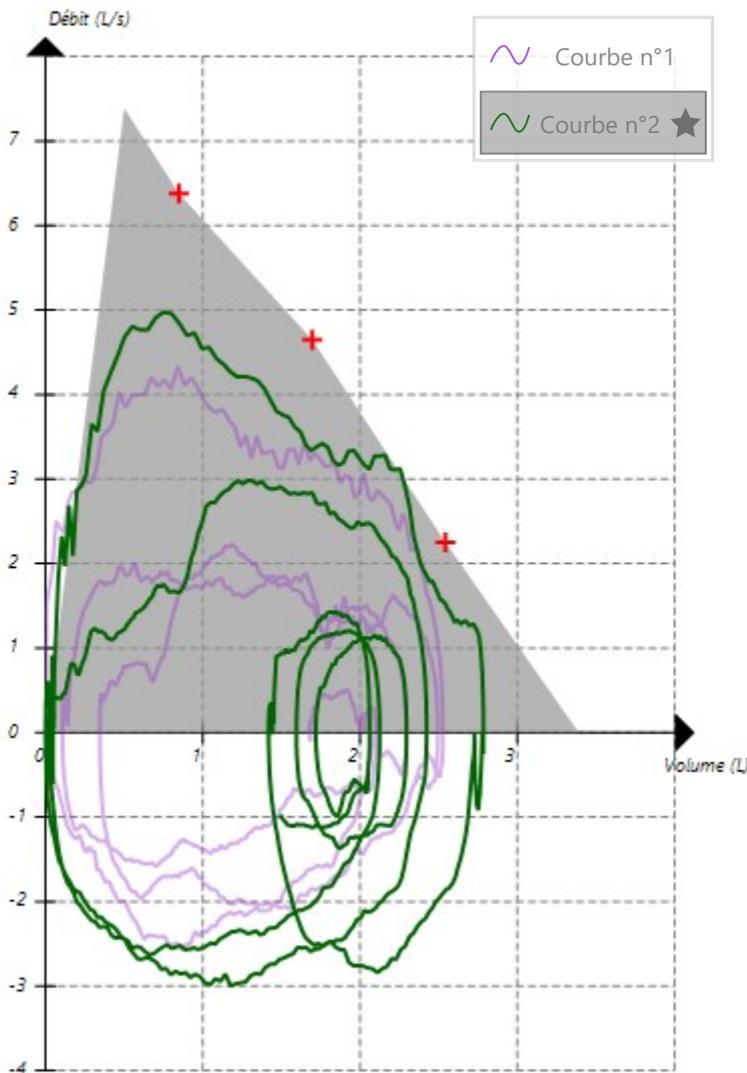

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,53 L	2,74 L	3,39 L	80,83 %
VEMS	2,53 L	2,74 L	2,97 L	92,26 %
DEP	4,46 L/s	5,04 L/s	7,39 L/s	68,20 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	84,30 %	118,62 %
Durée d'expiration	0,86 s	0,95 s	-	
DEMM	3,64 L/s	3,95 L/s	4,18 L/s	94,50 %
DEMM/ CVF	1,44 s-1	1,44 s-1	1,07 s-1	134,58 %
DE75	3,92 L/s	4,99 L/s	6,38 L/s	78,21 %
DE50	3,61 L/s	4,02 L/s	4,65 L/s	86,45 %
DE25	2,99 L/s	3,32 L/s	2,25 L/s	147,56 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: