

**Nom** KONATE  
**Prénom** BANGALY  
**Né le** 01/01/1987  
**Age** 37 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 154  
**Taille** 164 cm  
**Poids** 53 kg  
**Valeurs prédites** Knudsen  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** HTM  
**Entreprise** WELHY CIS  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,3 °C

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Humidité : 48 %

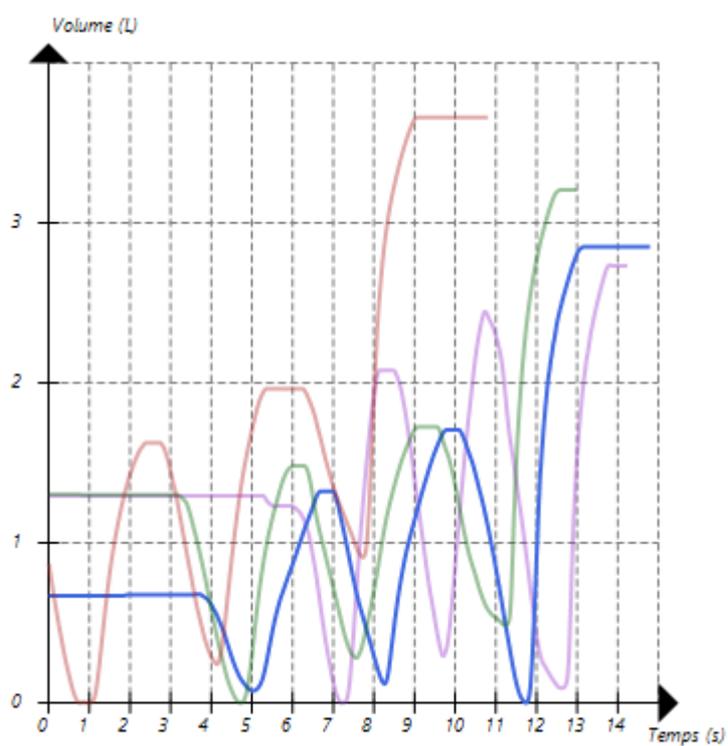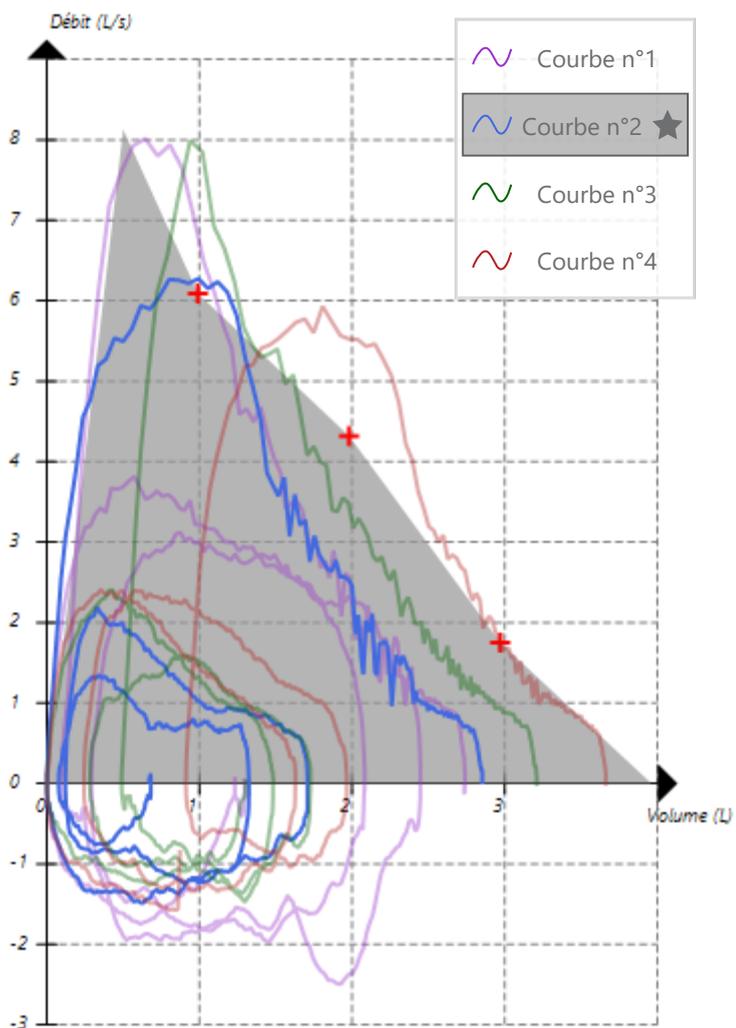

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Courbe n°4	Prédits	% Prédits
CVF	2,64 L	2,85 L	2,72 L	2,75 L	3,96 L	71,97 %
VEMS	2,64 L	2,71 L	2,62 L	2,64 L	3,32 L	81,63 %
DÉP	8,18 L/s	6,45 L/s	8,13 L/s	6,01 L/s	8,13 L/s	79,34 %
VEMS/CVF	100,00 %	95,09 %	96,32 %	96,00 %	82,82 %	114,82 %
Durée d'expiration	1,17 s	1,42 s	1,36 s	1,35 s	-	
DEMM	3,96 L/s	3,78 L/s	3,48 L/s	3,78 L/s	3,63 L/s	104,13 %
DEMM/CVF	1,50 s <sup>-1</sup>	1,33 s <sup>-1</sup>	1,28 s <sup>-1</sup>	1,37 s <sup>-1</sup>	0,92 s <sup>-1</sup>	144,57 %
DE75	7,60 L/s	5,93 L/s	6,65 L/s	5,71 L/s	6,09 L/s	97,37 %
DE50	4,58 L/s	3,94 L/s	3,51 L/s	5,00 L/s	4,32 L/s	91,20 %
DE25	1,55 L/s	1,79 L/s	1,56 L/s	1,56 L/s	1,75 L/s	102,29 %