

<b>Nom camara</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom amara</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1991	<b>Profession</b> PLONGEUR
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> WELHY-CIS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 30	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Conclusion:** NORMAL

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 24,8 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 59 %

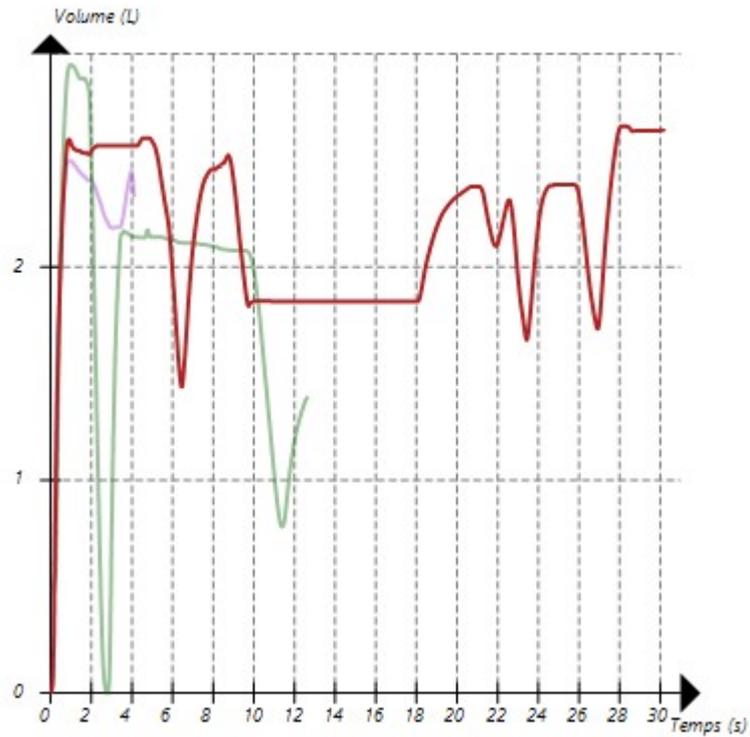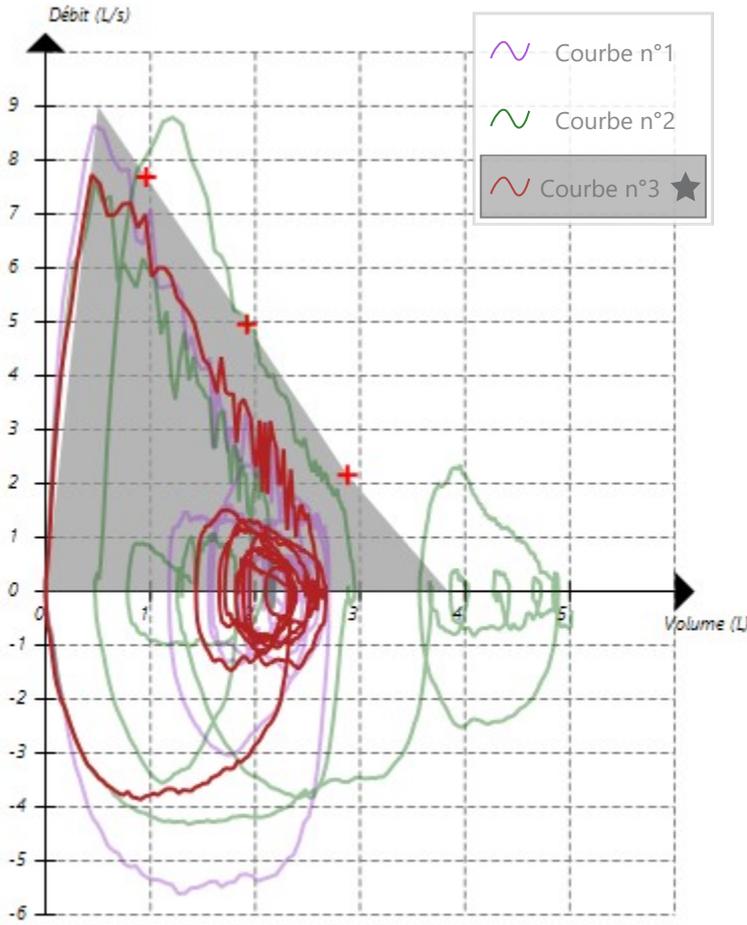

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,50 L	2,48 L	2,60 L	3,84 L	67,71 %
VEMS	2,50 L	2,48 L	2,60 L	3,25 L	80,00 %
DEP	9,18 L/s	9,06 L/s	8,12 L/s	9,00 L/s	90,22 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,30 %	123,00 %
Durée d'expiration	0,94 s	0,99 s	0,89 s	-	
DEMM	4,79 L/s	5,71 L/s	5,00 L/s	4,53 L/s	110,38 %
DEMM/ CVF	1,92 s-1	2,30 s-1	1,92 s-1	1,03 s-1	186,41 %
DE75	8,08 L/s	8,53 L/s	7,33 L/s	7,69 L/s	95,32 %
DE50	5,73 L/s	6,19 L/s	5,34 L/s	4,96 L/s	107,66 %
DE25	2,50 L/s	3,66 L/s	2,87 L/s	2,16 L/s	132,87 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: