

<b>Nom</b> KUROURMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AMINATA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 15/12/1982	<b>Profession</b> NETTOYEUR
<b>Age</b> 41 Ans	<b>Entreprise</b> WELHY-CIS
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 10	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 94 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:** NORMAL



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,9 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 42 %

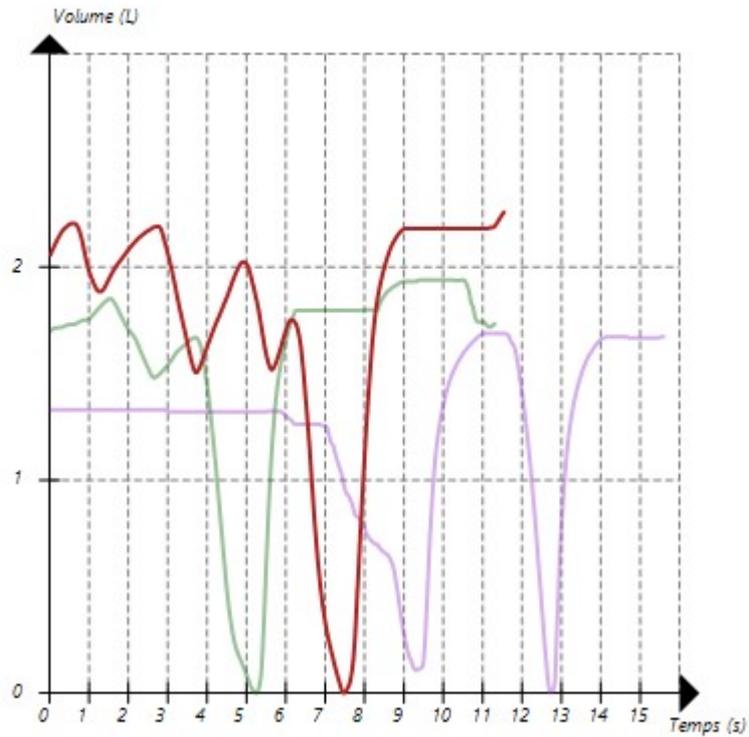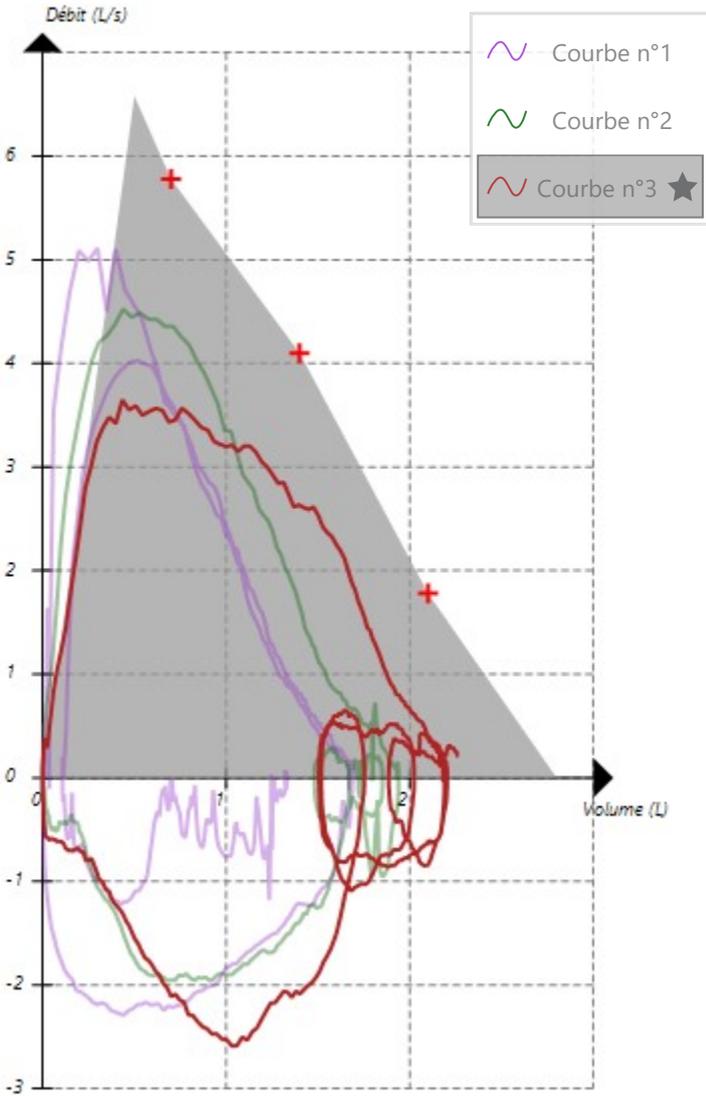

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,64 L	1,94 L	2,26 L	2,80 L	80,71 %
VEMS	1,59 L	1,80 L	2,10 L	2,41 L	87,14 %
DEP	5,66 L/s	4,62 L/s	3,81 L/s	6,58 L/s	57,90 %
VEMS/ CVF	96,95 %	92,78 %	92,92 %	81,23 %	114,39 %
Durée d'expiration	1,32 s	4,15 s	4,11 s	-	
DEMM	2,66 L/s	3,04 L/s	2,96 L/s	3,56 L/s	83,15 %
DEMM/ CVF	1,62 s-1	1,57 s-1	1,31 s-1	1,11 s-1	118,02 %
DE75	4,65 L/s	4,43 L/s	3,58 L/s	5,78 L/s	61,94 %
DE50	2,87 L/s	3,46 L/s	3,15 L/s	4,10 L/s	76,83 %
DE25	1,22 L/s	1,37 L/s	1,83 L/s	1,78 L/s	102,81 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: