

<b>Nom</b> SOUMAORO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALHASSANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 07/02/1988	<b>Profession</b> HTM
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> WELHY-CIS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 35	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 62 %

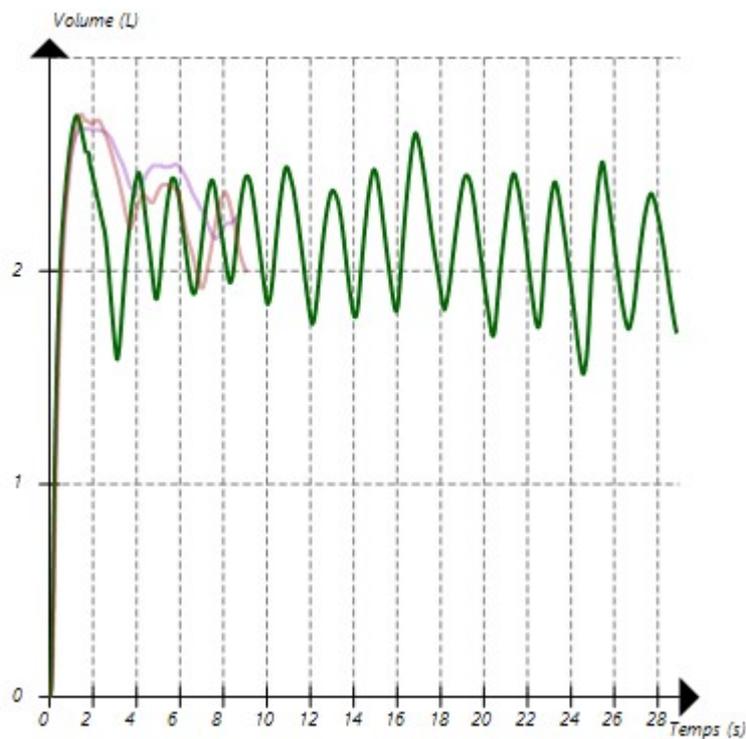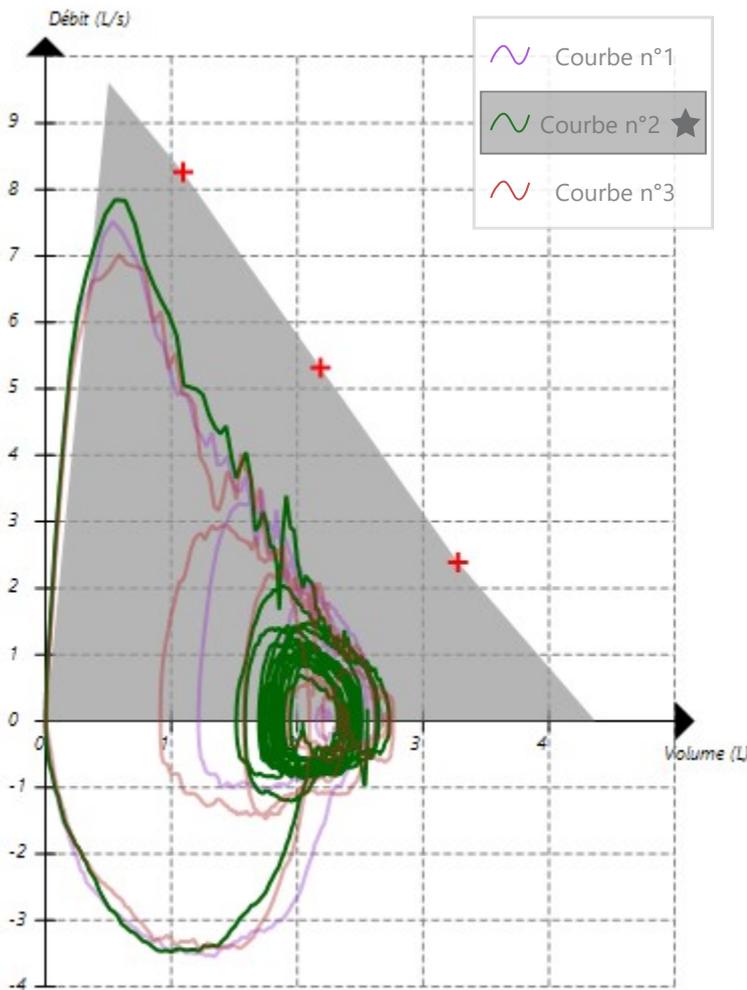

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,67 L	2,73 L	2,74 L	4,37 L	62,47 %
VEMS	2,59 L	2,68 L	2,62 L	3,62 L	74,03 %
DEP	7,74 L/s	8,05 L/s	7,14 L/s	9,61 L/s	83,77 %
VEMS/ CVF	97,00 %	98,17 %	95,62 %	80,77 %	121,54 %
Durée d'expiration	1,50 s	1,26 s	1,46 s	-	
DEMM	3,91 L/s	4,08 L/s	3,65 L/s	4,63 L/s	88,12 %
DEMM/ CVF	1,46 s-1	1,49 s-1	1,33 s-1	0,92 s-1	161,96 %
DE75	7,16 L/s	7,64 L/s	7,03 L/s	8,26 L/s	92,49 %
DE50	4,28 L/s	4,49 L/s	3,50 L/s	5,32 L/s	84,40 %
DE25	1,95 L/s	1,97 L/s	1,97 L/s	2,39 L/s	82,43 %