



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1999	<b>Profession</b> MAGASINIER
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> WELLY CIS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 622	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 69 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,2 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 57 %

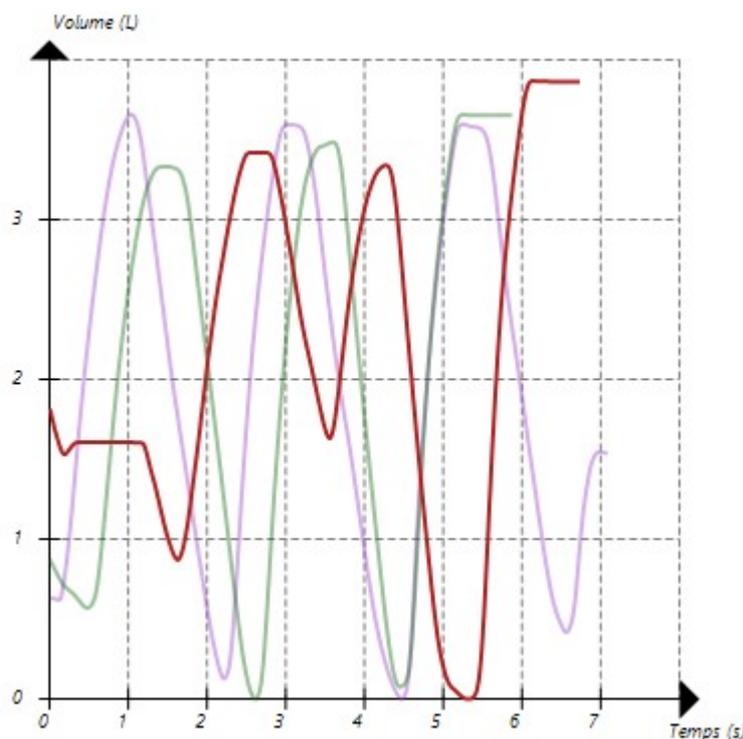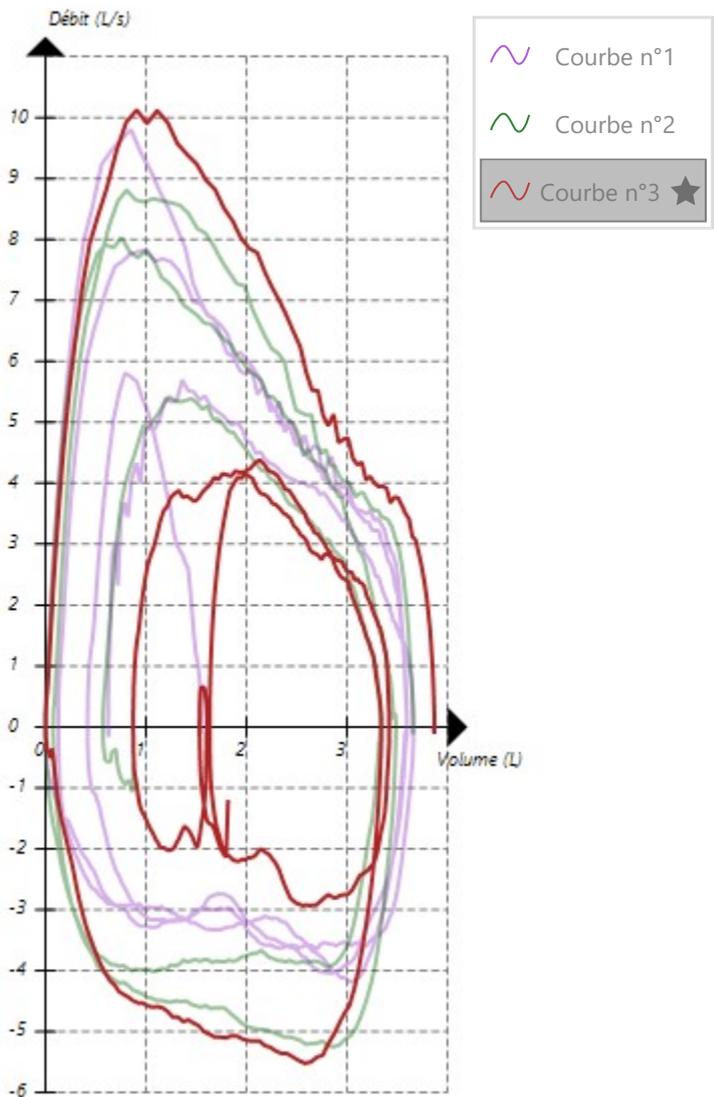

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,60 L	3,58 L	3,87 L	4,77 L	81,13 %
VEMS	3,60 L	3,58 L	3,87 L	4,02 L	96,27 %
DEP	9,85 L/s	8,92 L/s	10,24 L/s	10,02 L/s	102,20 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,49 %	118,36 %
Durée d'expiration	0,77 s	0,80 s	0,82 s	-	
DEMM	6,40 L/s	7,00 L/s	7,71 L/s	4,44 L/s	173,65 %
DEMM/ CVF	1,78 s-1	1,96 s-1	1,99 s-1	0,93 s-1	213,98 %
DE75	9,65 L/s	8,63 L/s	9,83 L/s	-	
DE50	6,03 L/s	7,27 L/s	8,05 L/s	-	
DE25	4,83 L/s	4,59 L/s	4,79 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: