

**Nom SAGNO**  
**Prénom OUMAR**  
**Né le** 05/03/1999  
**Age** 25 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 158  
**Taille** 161 cm  
**Poids** 50 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** HTM  
**Entreprise** WELHY CIS  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,6 °C

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Humidité : 48 %

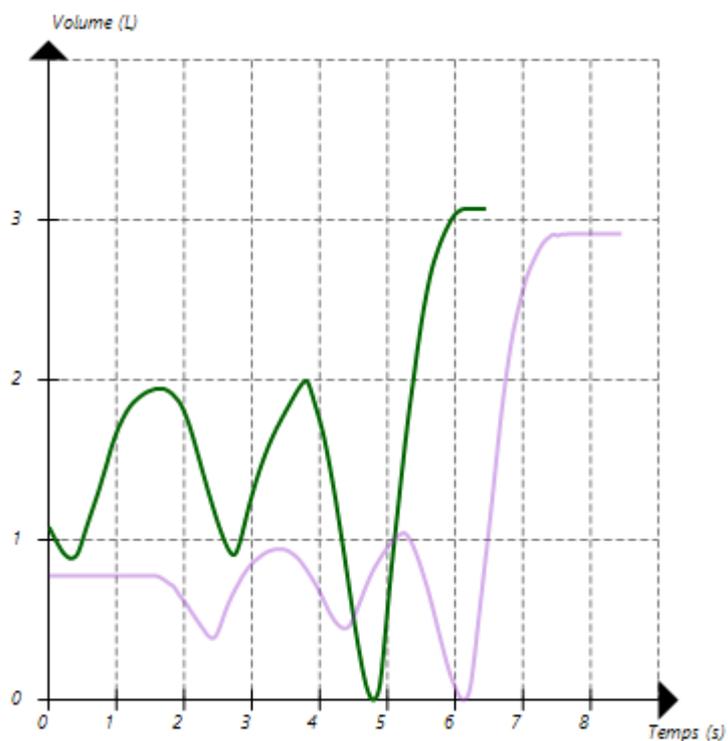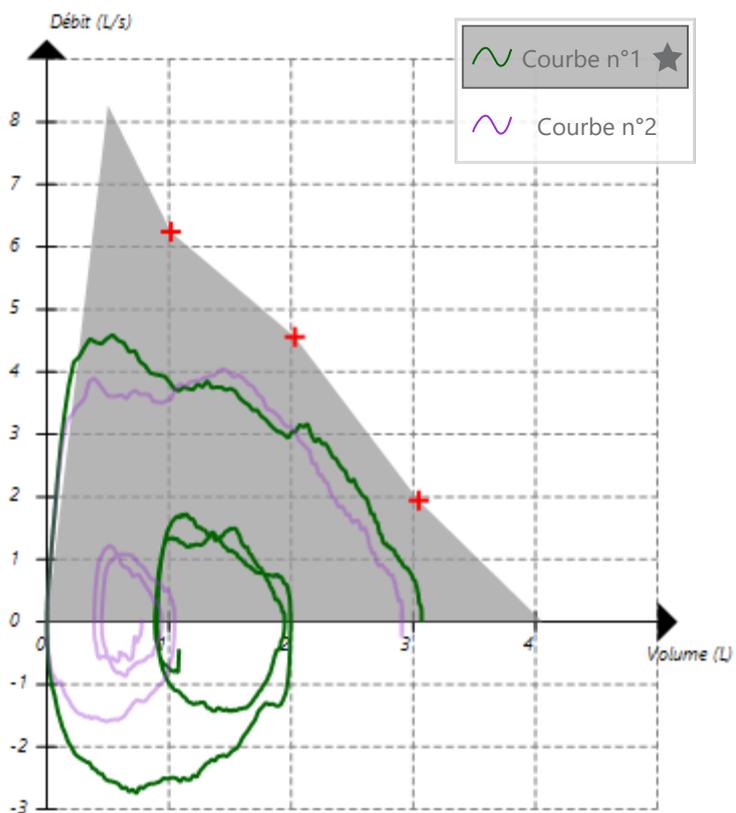

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,07 L	2,91 L	4,06 L	75,62 %
VEMS	2,95 L	2,81 L	3,47 L	85,01 %
DÉP	4,61 L/s	4,08 L/s	8,27 L/s	55,74 %
VEMS/CVF	96,09 %	96,56 %	84,08 %	114,28 %
Durée d'expiration	1,42 s	2,34 s	-	
DEMM	3,53 L/s	3,62 L/s	3,89 L/s	90,75 %
DEMM/CVF	1,15 s <sup>-1</sup>	1,24 s <sup>-1</sup>	0,96 s <sup>-1</sup>	119,79 %
DE75	4,16 L/s	3,68 L/s	6,24 L/s	66,67 %
DE50	3,64 L/s	4,03 L/s	4,56 L/s	79,82 %
DE25	2,78 L/s	2,60 L/s	1,94 L/s	143,30 %