

<b>Nom GROVOGUI</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom OUIDOH</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1994</b>	<b>Profession NETTOYAGE</b>
<b>Age 30 Ans</b>	<b>Entreprise WELHY CIS</b>
<b>Genre Féminin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 148</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 157 cm</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids 59 kg</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Valeurs prédites Knudson</b>	
<b>Opérateur admin admin</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,6 °C  
 Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Humidité : 50 %

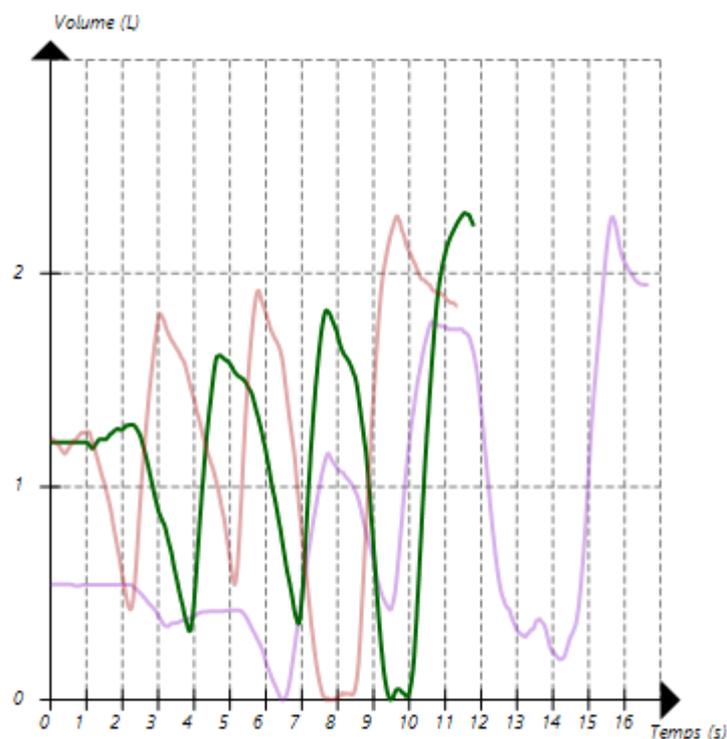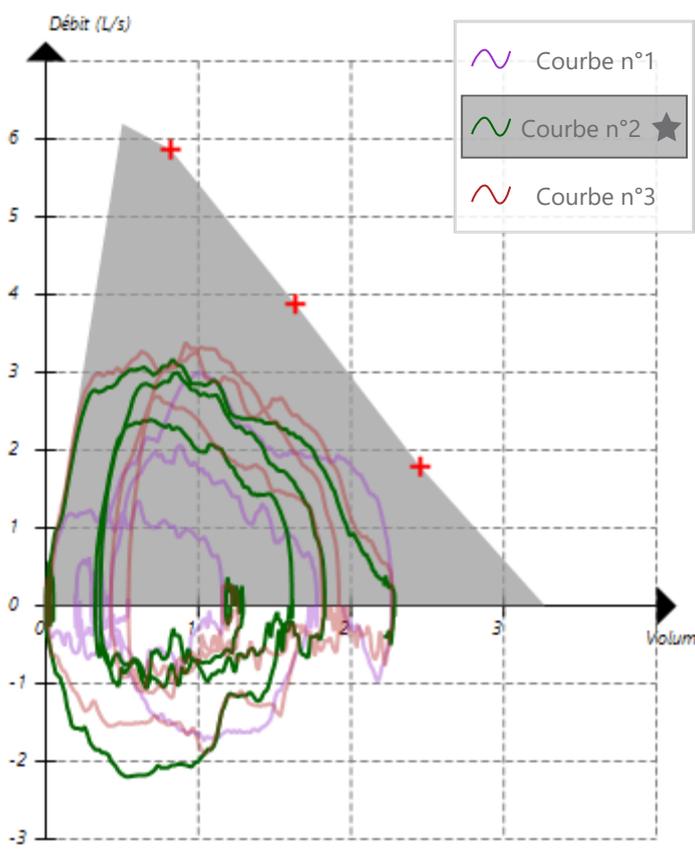

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,07 L	2,27 L	2,24 L	3,27 L	69,42 %
VEMS	2,07 L	2,13 L	2,20 L	2,82 L	75,53 %
DÉP	3,07 L/s	3,21 L/s	3,45 L/s	6,20 L/s	51,77 %
VEMS/ CVF	100,00 %	93,83 %	98,21 %	86,94 %	107,93 %
Durée d'expiration	1,48 s	1,62 s	1,27 s	-	
DEMM	2,38 L/s	2,68 L/s	2,88 L/s	3,37 L/s	79,53 %
DEMM/ CVF	1,15 s-1	1,18 s-1	1,29 s-1	1,03 s-1	114,56 %
DE75	2,13 L/s	3,06 L/s	3,15 L/s	5,87 L/s	52,13 %
DE50	2,50 L/s	2,80 L/s	2,90 L/s	3,88 L/s	72,16 %
DE25	1,90 L/s	2,02 L/s	2,31 L/s	1,79 L/s	112,85 %