

<b>Nom</b> DIABATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FANYTA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1998	<b>Profession</b> NETTOYEUR
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> WELHY-CIS
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 85 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:** NORMAL



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 42 %

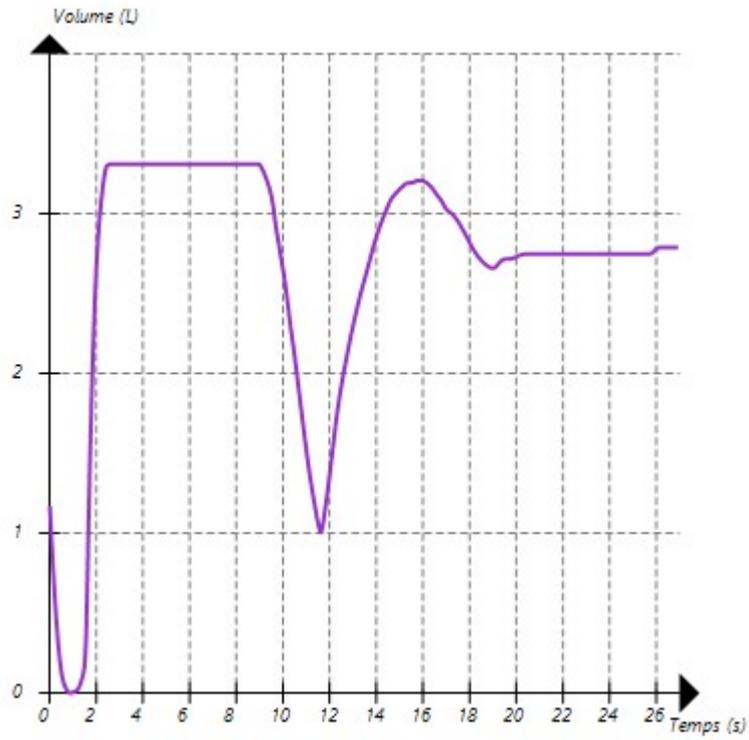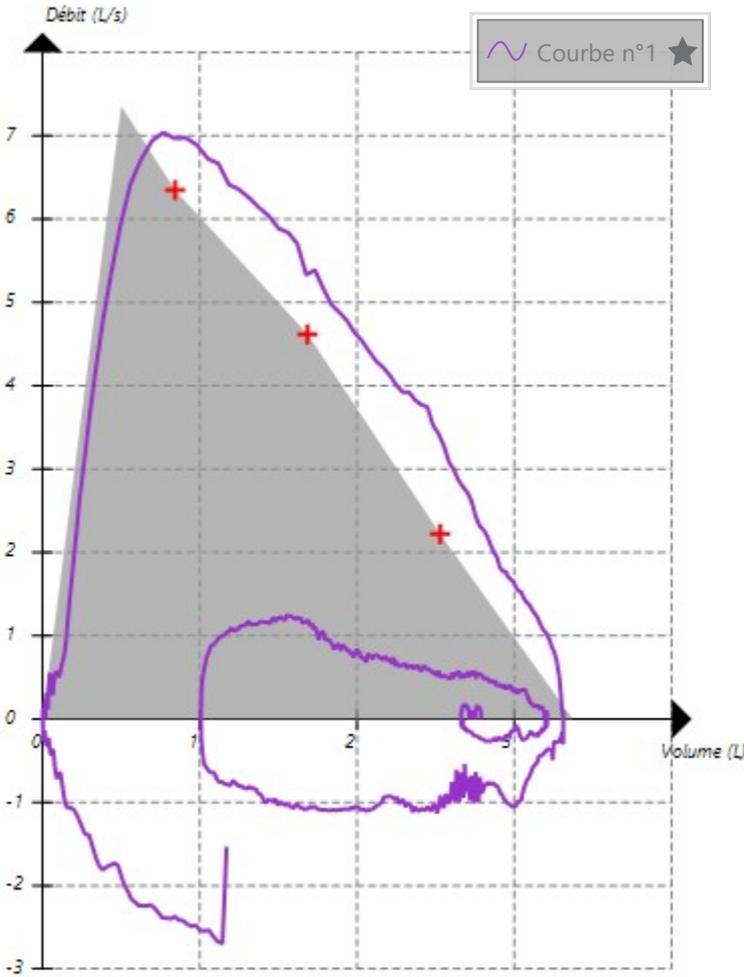

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,31 L	3,37 L	98,22 %
VEMS	3,31 L	2,95 L	112,20 %
DEP	7,13 L/s	7,36 L/s	96,88 %
VEMS/ CVF	100,00 %	84,11 %	118,89 %
Durée d'expiration	1,71 s	-	
DEMM	5,32 L/s	4,14 L/s	128,50 %
DEMM/ CVF	1,61 s-1	1,07 s-1	150,47 %
DE75	6,90 L/s	6,35 L/s	108,66 %
DE50	5,44 L/s	4,62 L/s	117,75 %
DE25	3,51 L/s	2,22 L/s	158,11 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: