



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> NABY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1986	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3740	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 87 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 33 %

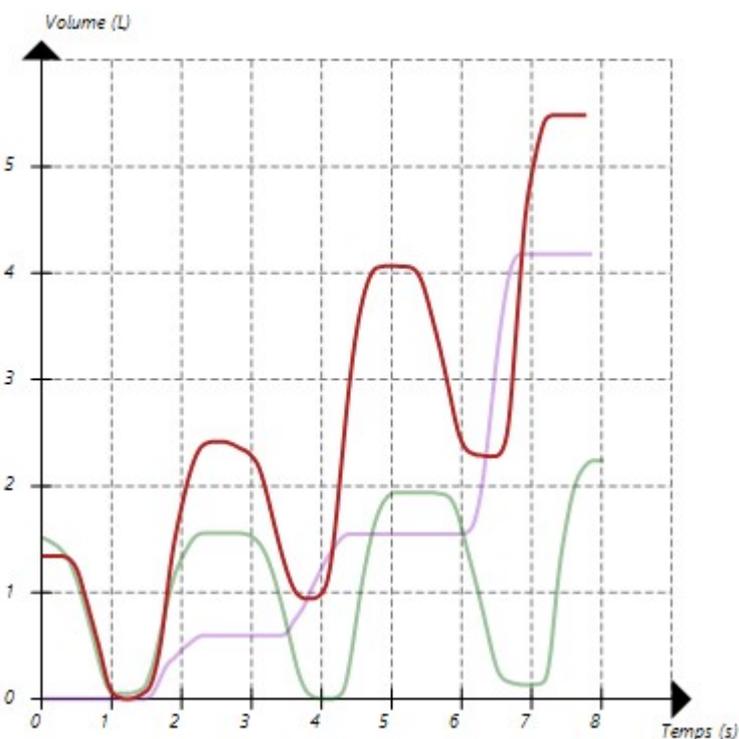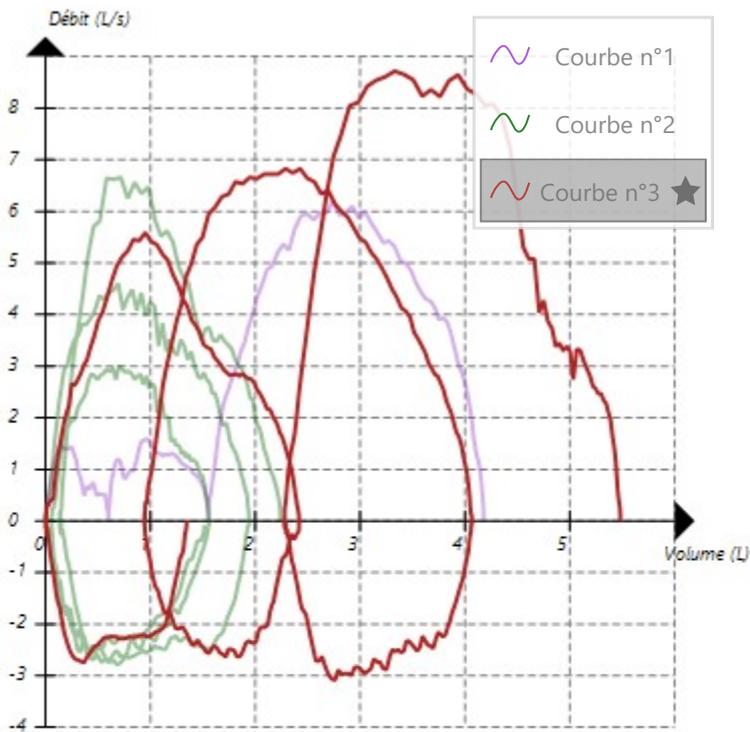

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,18 L	2,10 L	3,20 L	4,18 L	76,56 %
VEMS	4,18 L	2,10 L	3,20 L	3,44 L	93,02 %
DEP	6,30 L/s	6,87 L/s	8,93 L/s	8,91 L/s	100,22 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	82,11 %	121,79 %
Durée d'expiration	6,84 s	1,01 s	0,88 s	-	
DEMM	0,79 L/s	5,01 L/s	7,89 L/s	3,66 L/s	215,57 %
DEMM/ CVF	0,19 s-1	2,39 s-1	2,47 s-1	0,88 s-1	280,68 %
DE75	1,33 L/s	6,45 L/s	8,38 L/s	-	
DE50	4,80 L/s	5,70 L/s	8,59 L/s	-	
DE25	5,74 L/s	3,57 L/s	4,88 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: