

<b>Nom</b> XUAN	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 06/06/1974	<b>Profession</b> CARPENTER
<b>Age</b> 51 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 6785	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 28,5 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 77 %

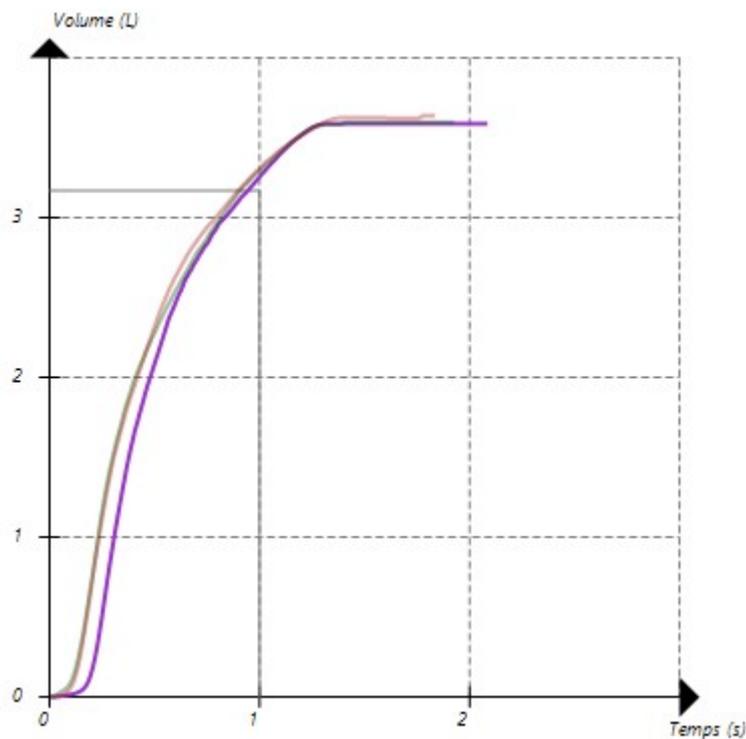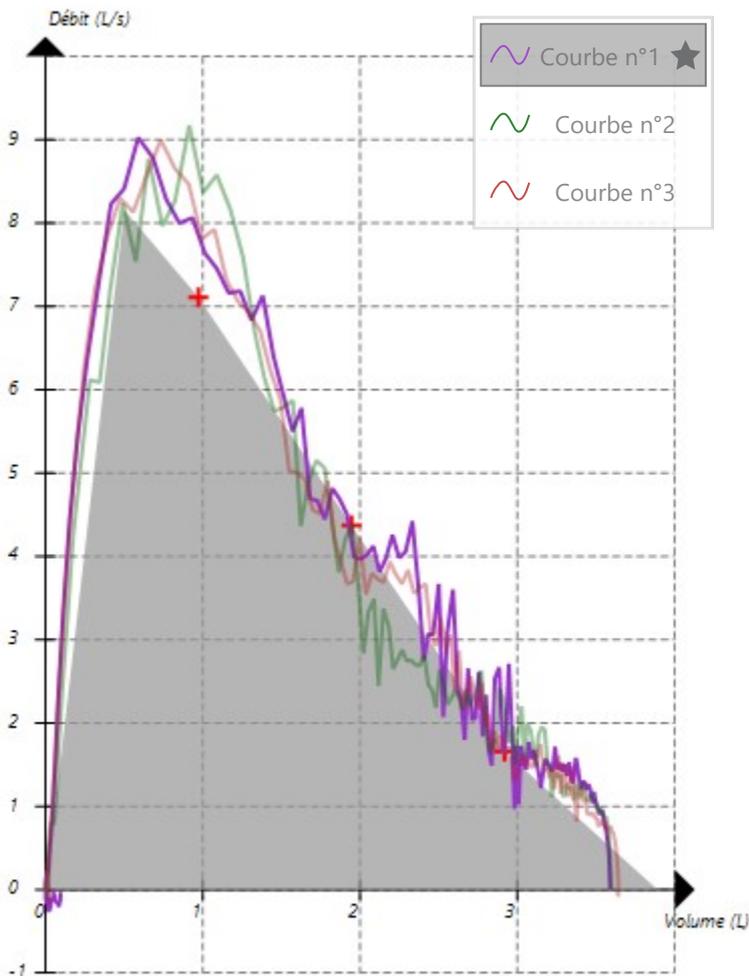

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,59 L	3,58 L	3,63 L	3,89 L	92,29 %
VEMS	3,51 L	3,43 L	3,44 L	3,17 L	110,73 %
DEP	9,33 L/s	9,39 L/s	9,25 L/s	8,16 L/s	114,34 %
VEMS/CVF	97,77 %	95,81 %	94,77 %	78,08 %	125,22 %
Durée d'expiration	1,55 s	1,41 s	1,40 s	-	
DEMM	4,65 L/s	4,05 L/s	4,40 L/s	3,73 L/s	124,66 %
DEMM/CVF	1,30 s-1	1,13 s-1	1,21 s-1	0,96 s-1	135,42 %
DE75	8,40 L/s	9,35 L/s	8,42 L/s	7,11 L/s	118,14 %
DE50	5,36 L/s	4,57 L/s	4,28 L/s	4,37 L/s	122,65 %
DE25	2,99 L/s	2,06 L/s	2,20 L/s	1,66 L/s	180,12 %