



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1987	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1622	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 28,5 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 93,4 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 53 %

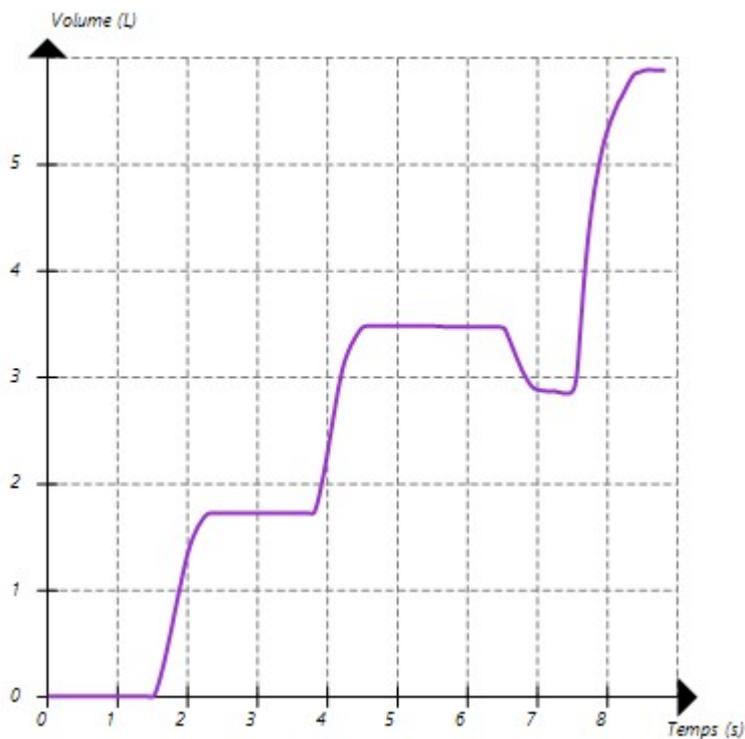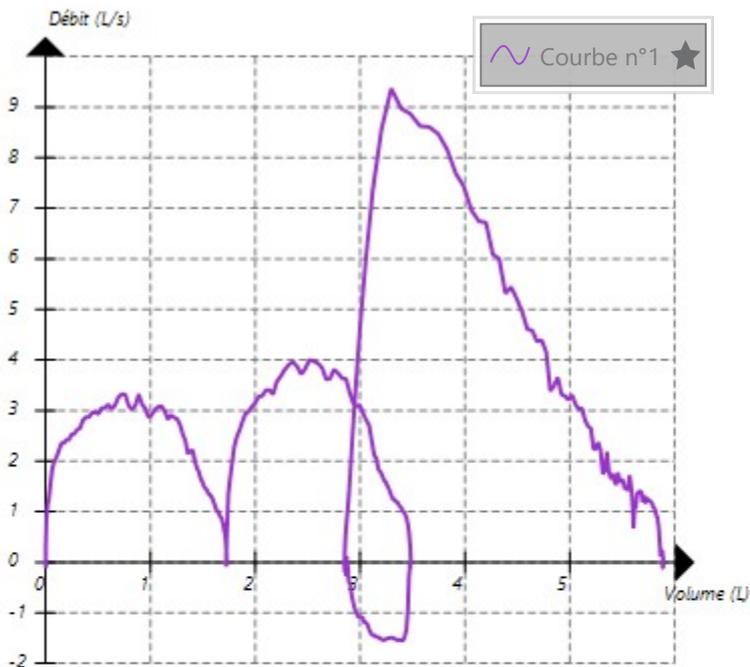

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,04 L	3,65 L	83,29 %
VEMS	3,03 L	3,04 L	99,67 %
DEP	9,61 L/s	8,07 L/s	119,08 %
VEMS/ CVF	99,67 %	82,48 %	120,84 %
Durée d'expiration	1,22 s	-	
DEMM	5,24 L/s	3,39 L/s	154,57 %
DEMM/ CVF	1,72 s-1	0,93 s-1	184,95 %
DE75	8,62 L/s	-	
DE50	5,89 L/s	-	
DE25	2,90 L/s	-	