

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KERFALA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 12/10/1977	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 46 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 01459	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> ITS (Crapo)	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédits sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,4 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 55 %

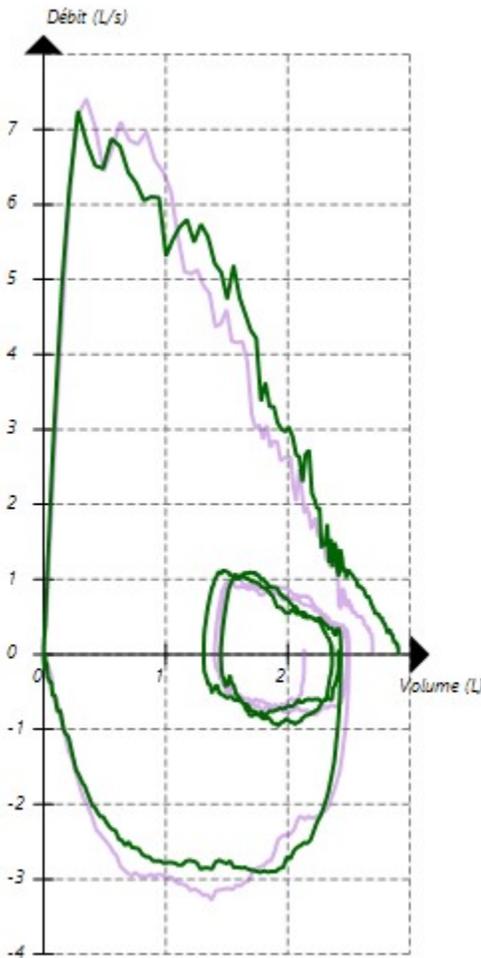

~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2 ★

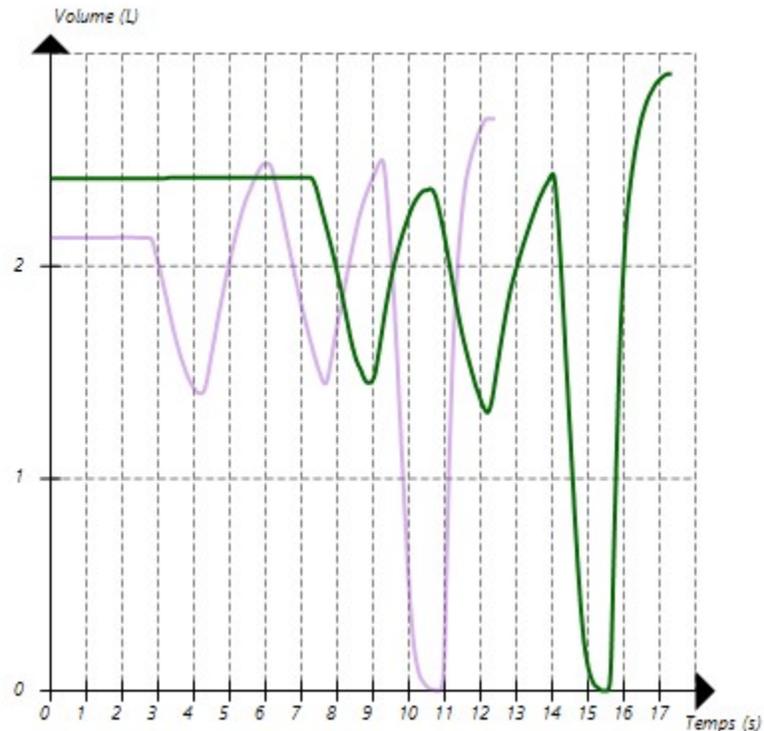

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,69 L	2,91 L	3,97 L	73,30 %
VEMS	2,63 L	2,76 L	3,31 L	83,38 %
DEP	7,57 L/s	7,32 L/s	-	-
VEMS/ CVF	97,77 %	94,85 %	82,70 %	114,69 %
Durée d'expiration	1,39 s	1,80 s	-	-
DEMM	4,43 L/s	4,44 L/s	3,65 L/s	121,64 %
DEMM/ CVF	1,65 s-1	1,53 s-1	0,92 s-1	166,30 %
DE75	6,81 L/s	5,96 L/s	-	-
DE50	4,77 L/s	5,17 L/s	-	-
DE25	2,87 L/s	2,68 L/s	-	-

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: