

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3813	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,2 °C


Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 29 %

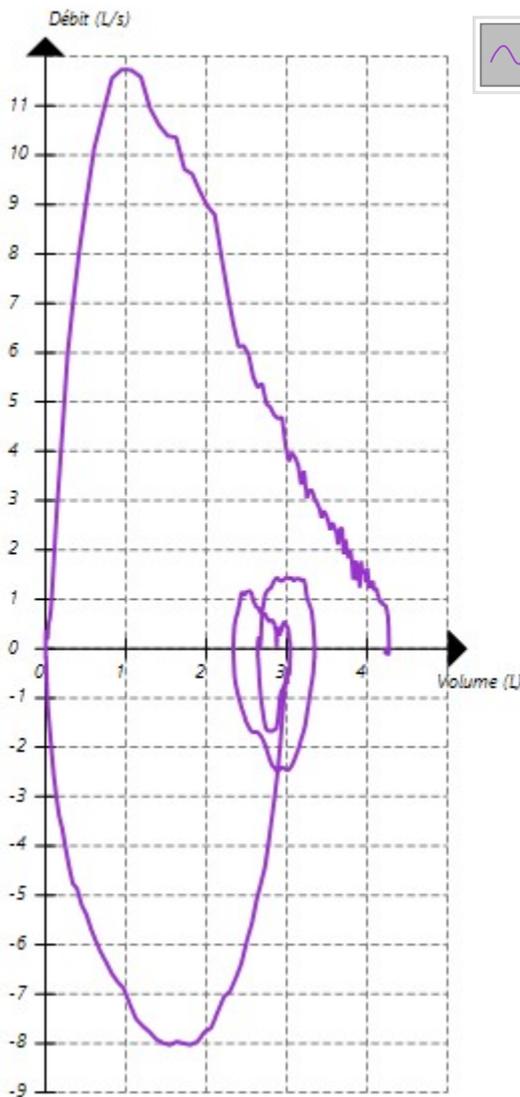

Courbe n°1 ★

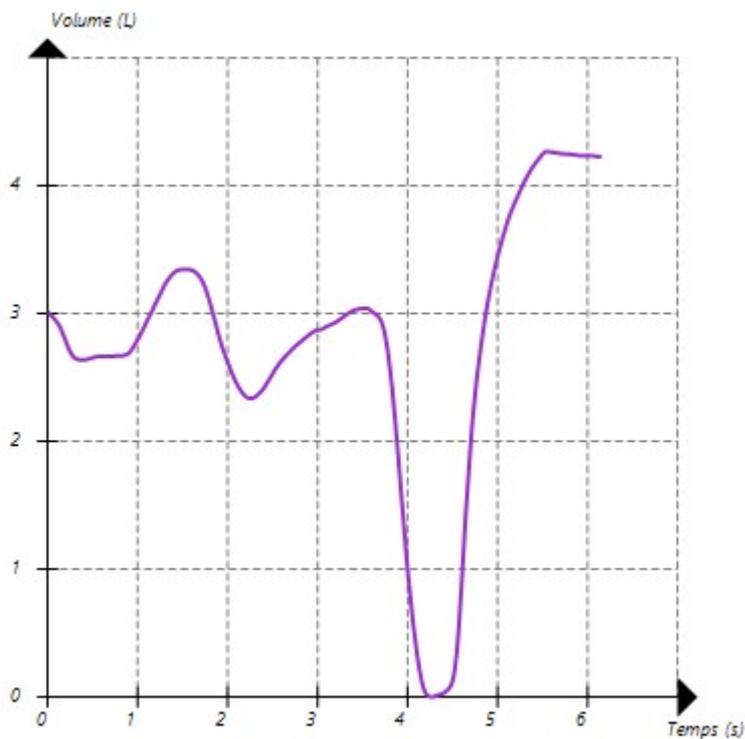

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,27 L	4,46 L	95,74 %
VEMS	4,26 L	3,74 L	113,90 %
DEP	11,90 L/s	9,47 L/s	125,66 %
VEMS/CVF	99,77 %	83,76 %	119,11 %
Durée d'expiration	1,27 s	-	
DEMM	6,95 L/s	4,12 L/s	168,69 %
DEMM/CVF	1,63 s-1	0,92 s-1	177,17 %
DE75	11,67 L/s	-	
DE50	8,56 L/s	-	
DE25	3,64 L/s	-	