



<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FABORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2000	<b>Profession</b> MECHANIC
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CR 18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1567	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 182 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 82 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 61 %

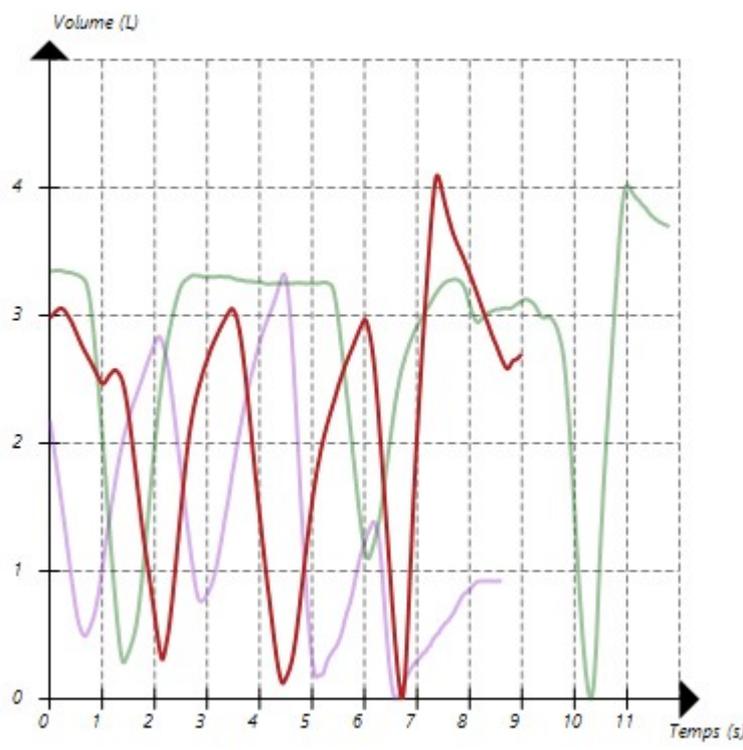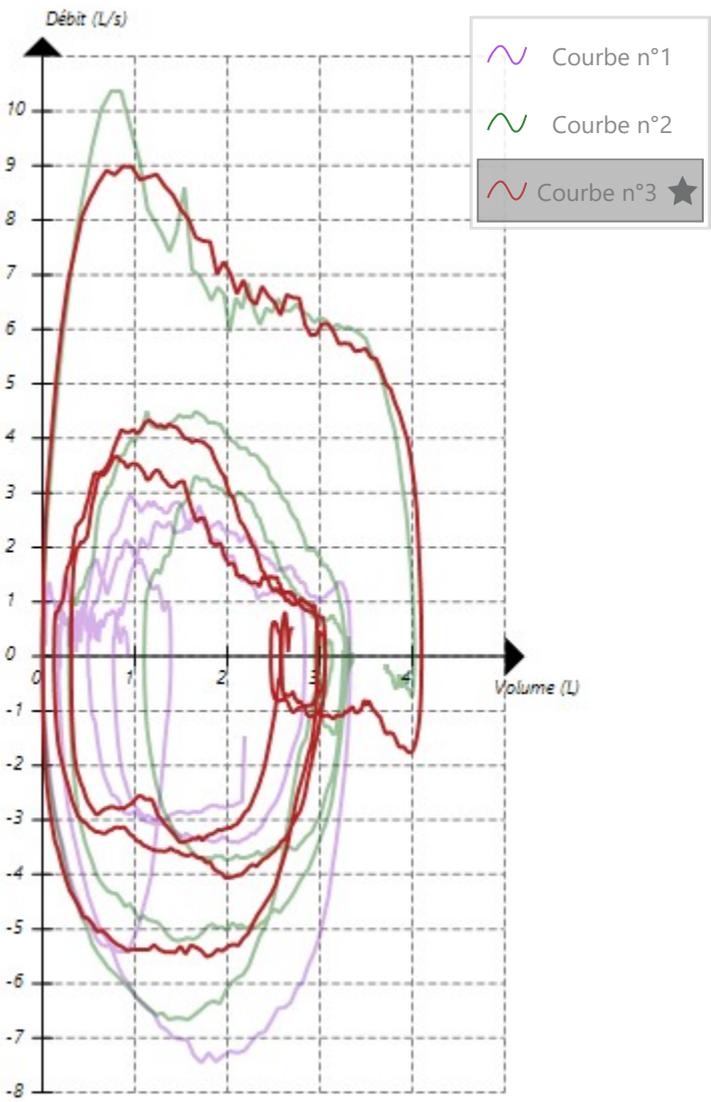

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,34 L	4,02 L	4,10 L	4,92 L	83,33 %
VEMS	2,08 L	4,02 L	4,10 L	4,16 L	98,56 %
DEP	2,98 L/s	10,48 L/s	9,02 L/s	10,30 L/s	87,57 %
VEMS/ CVF	88,89 %	100,00 %	100,00 %	84,85 %	117,86 %
Durée d'expiration	1,41 s	0,69 s	0,67 s	-	
DEMM	2,24 L/s	7,00 L/s	7,27 L/s	4,60 L/s	158,04 %
DEMM/ CVF	0,96 s-1	1,74 s-1	1,77 s-1	0,93 s-1	190,32 %
DE75	2,65 L/s	9,38 L/s	8,79 L/s	-	
DE50	2,44 L/s	5,53 L/s	6,81 L/s	-	
DE25	1,32 L/s	6,25 L/s	5,95 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: