



<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1970	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 54 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3863	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 182 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 28 %

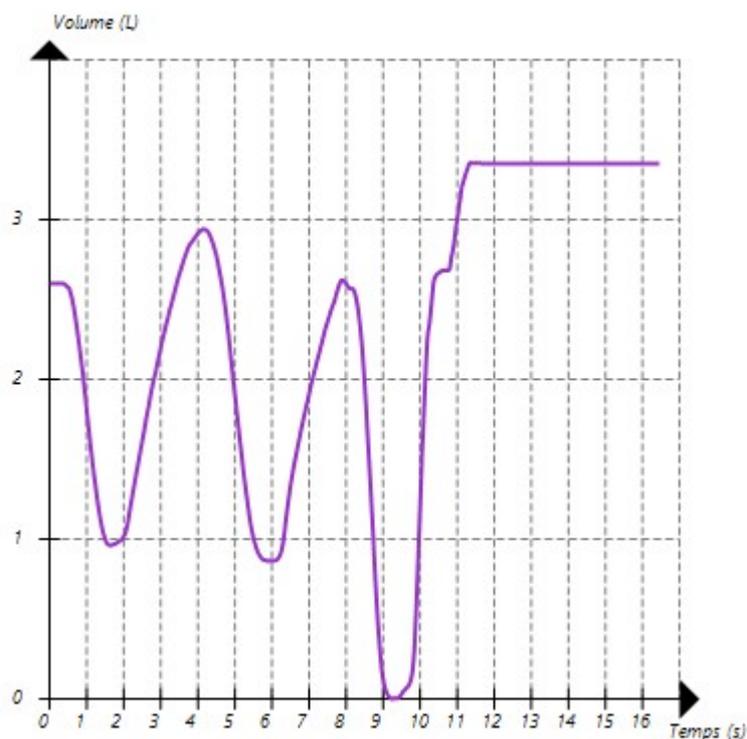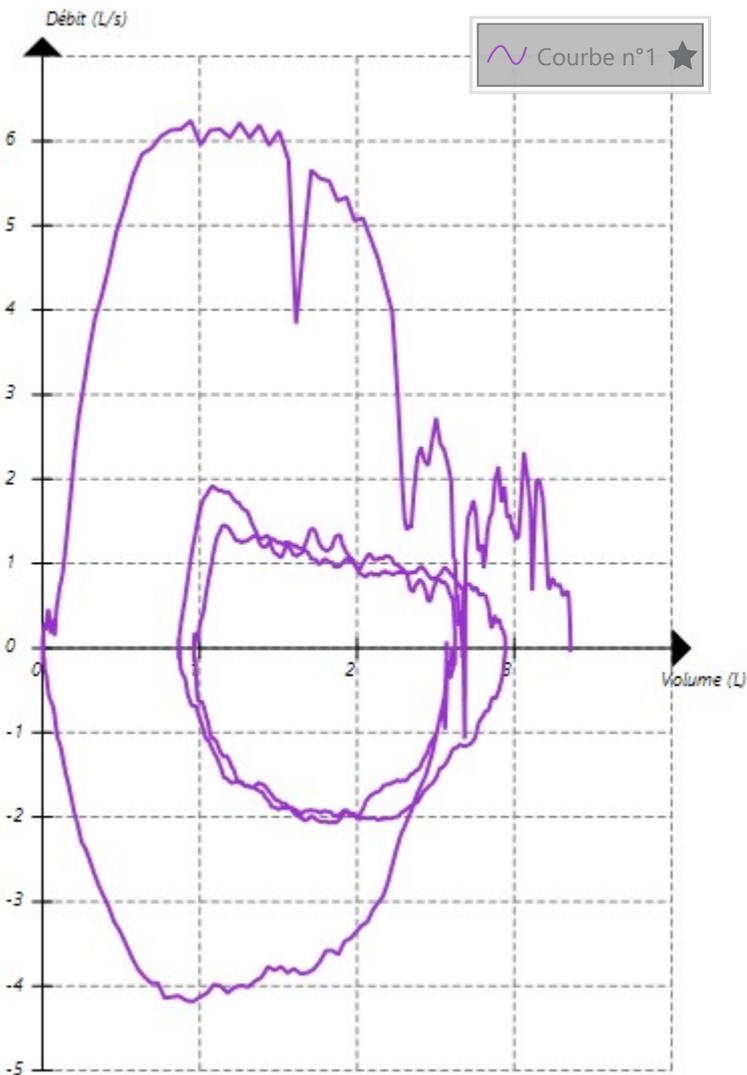

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,35 L	4,45 L	75,28 %
VEMS	2,70 L	3,48 L	77,59 %
DEP	6,40 L/s	7,83 L/s	81,74 %
VEMS/ CVF	80,60 %	79,33 %	101,60 %
Durée d'expiration	1,97 s	-	
DEMM	4,39 L/s	3,07 L/s	143,00 %
DEMM/ CVF	1,31 s-1	0,69 s-1	189,86 %
DE75	6,20 L/s	-	
DE50	5,44 L/s	-	
DE25	2,48 L/s	-	