



<b>Nom</b> DIAWARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> DUMP TRUCK DRIVER
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 113	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Ecacs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,7 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 44 %

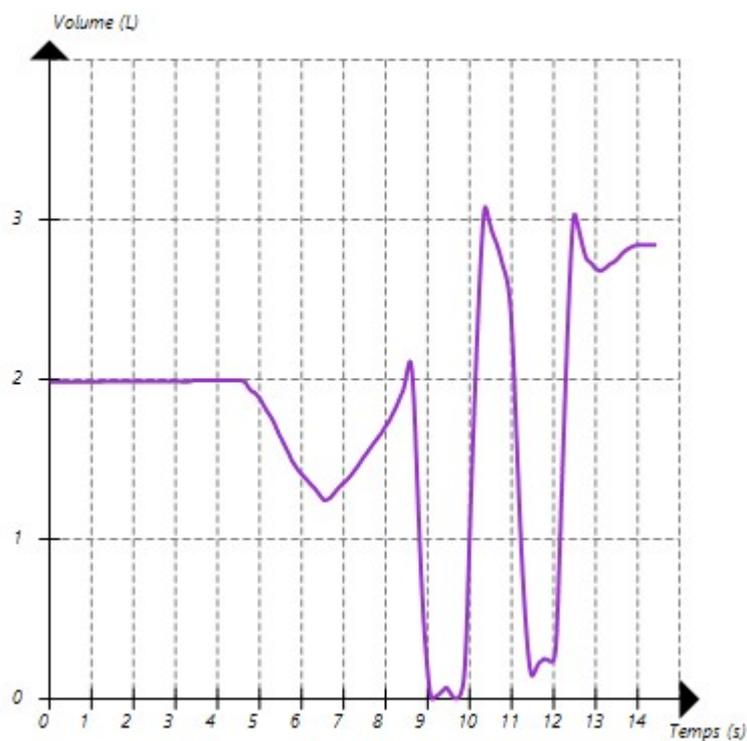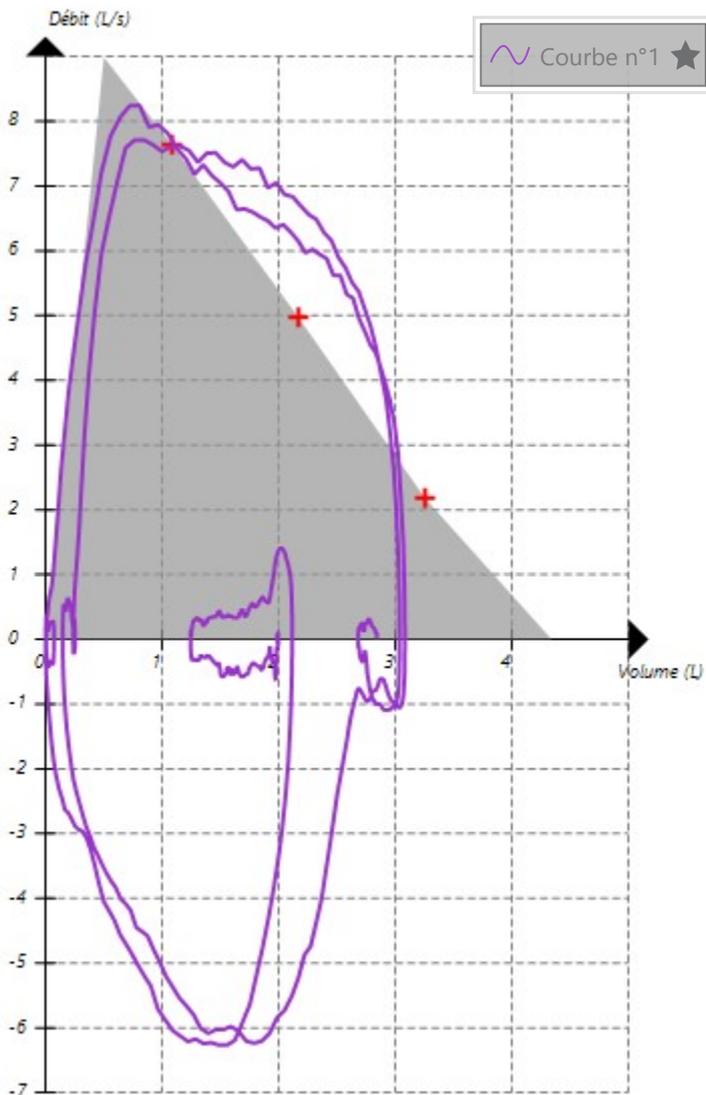

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,08 L	4,34 L	70,97 %
VEMS	3,08 L	3,72 L	82,80 %
DEP	8,36 L/s	8,99 L/s	92,99 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,02 %	121,92 %
Durée d'expiration	0,74 s	-	
DEMM	7,06 L/s	4,64 L/s	152,16 %
DEMM/ CVF	2,29 s-1	1,07 s-1	214,02 %
DE75	8,35 L/s	7,64 L/s	109,29 %
DE50	6,82 L/s	4,97 L/s	137,22 %
DE25	5,85 L/s	2,18 L/s	268,35 %