

<b>Nom</b> KOMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 512	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 153 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 54 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,4 °C  
 Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Humidité : 46 %

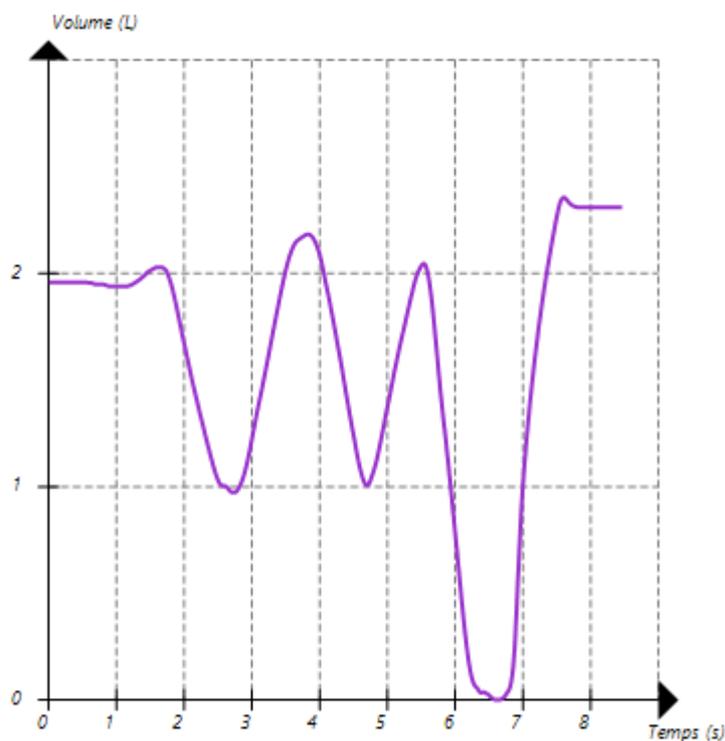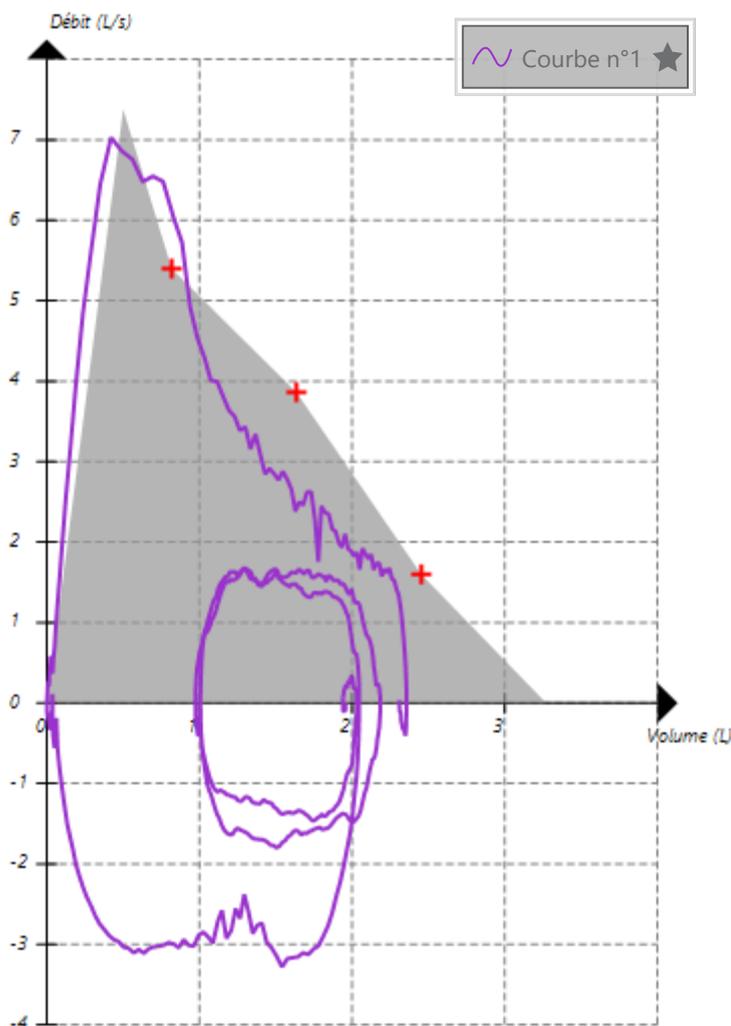

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,36 L	3,27 L	72,17 %
VEMS	2,36 L	2,82 L	83,69 %
DÉP	7,25 L/s	7,38 L/s	98,24 %
VEMS/CVF	100,00 %	83,66 %	119,53 %
Durée d'expiration	1,00 s	-	
DEMM	3,79 L/s	3,29 L/s	115,20 %
DEMM/CVF	1,61 s <sup>-1</sup>	1,01 s <sup>-1</sup>	159,41 %
DE75	6,74 L/s	5,40 L/s	124,81 %
DE50	3,72 L/s	3,86 L/s	96,37 %
DE25	2,47 L/s	1,60 L/s	154,38 %