



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 13/03/1995	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> IR ASSISTANT
<b>ID</b> 1710	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 51 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 54 %

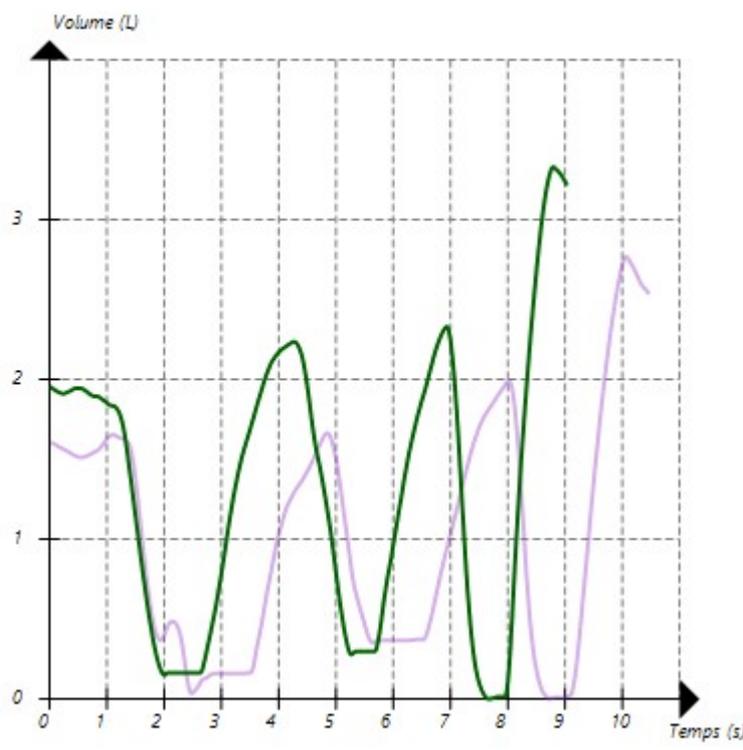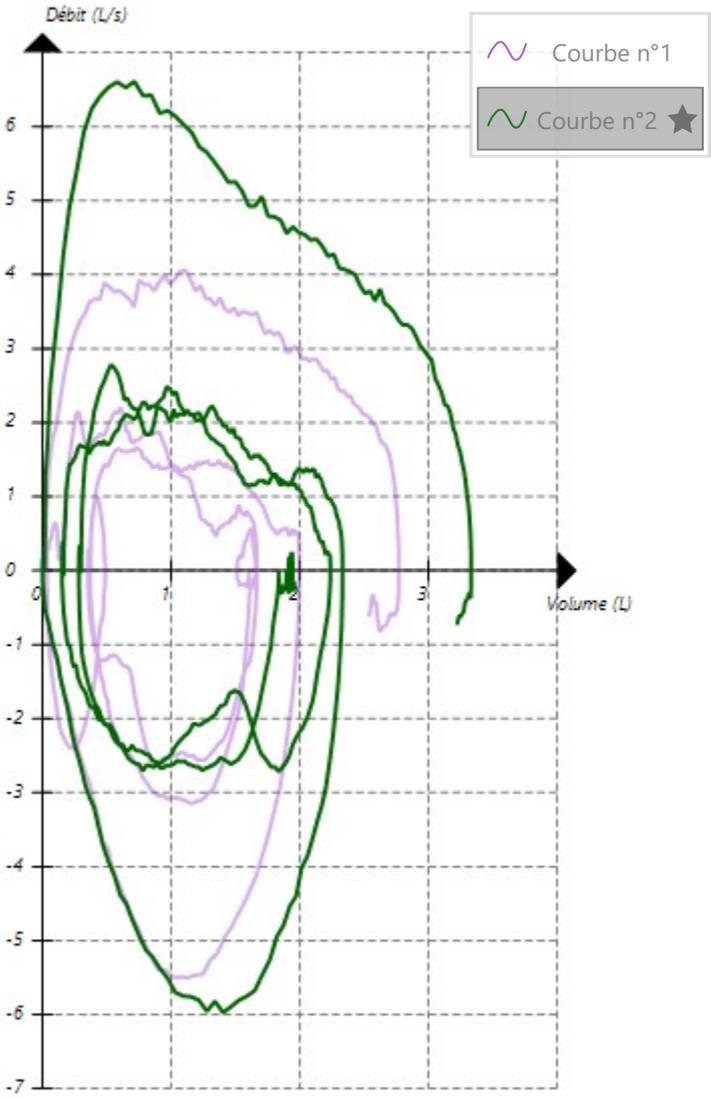

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,77 L	3,33 L	4,30 L	77,44 %
VEMS	2,77 L	3,33 L	3,62 L	91,99 %
DEP	4,15 L/s	6,74 L/s	9,22 L/s	73,10 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	83,94 %	119,13 %
Durée d'expiration	1,34 s	1,13 s	-	
DEMM	3,59 L/s	5,05 L/s	4,05 L/s	124,69 %
DEMM/CVF	1,30 s-1	1,52 s-1	0,94 s-1	161,70 %
DE75	3,59 L/s	6,50 L/s	-	
DE50	3,72 L/s	4,99 L/s	-	
DE25	2,82 L/s	3,74 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: