

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1980	<b>Profession</b> CLEANER
<b>Age</b> 45 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4573	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 32,5 °C  
 Pression atmosphérique : 95,4 kPa  
 Humidité : 56 %

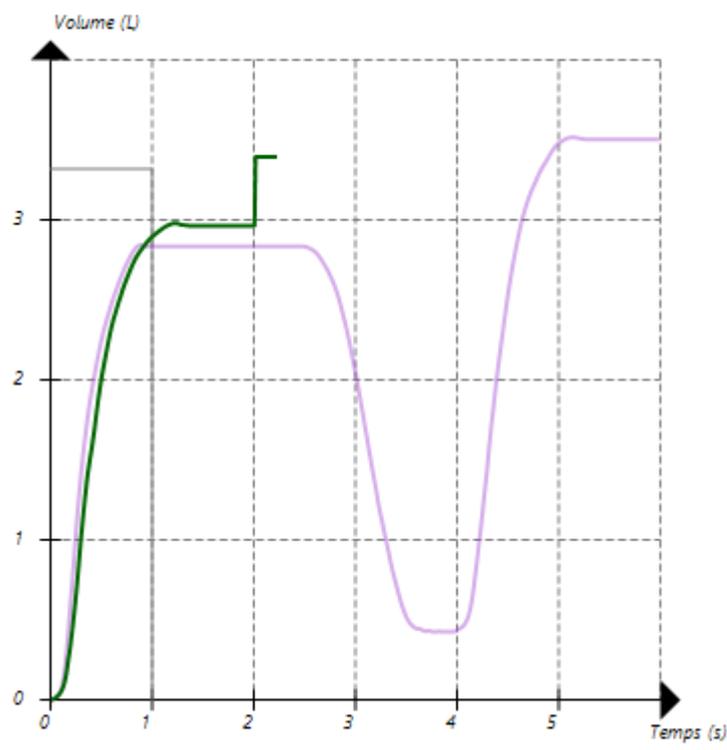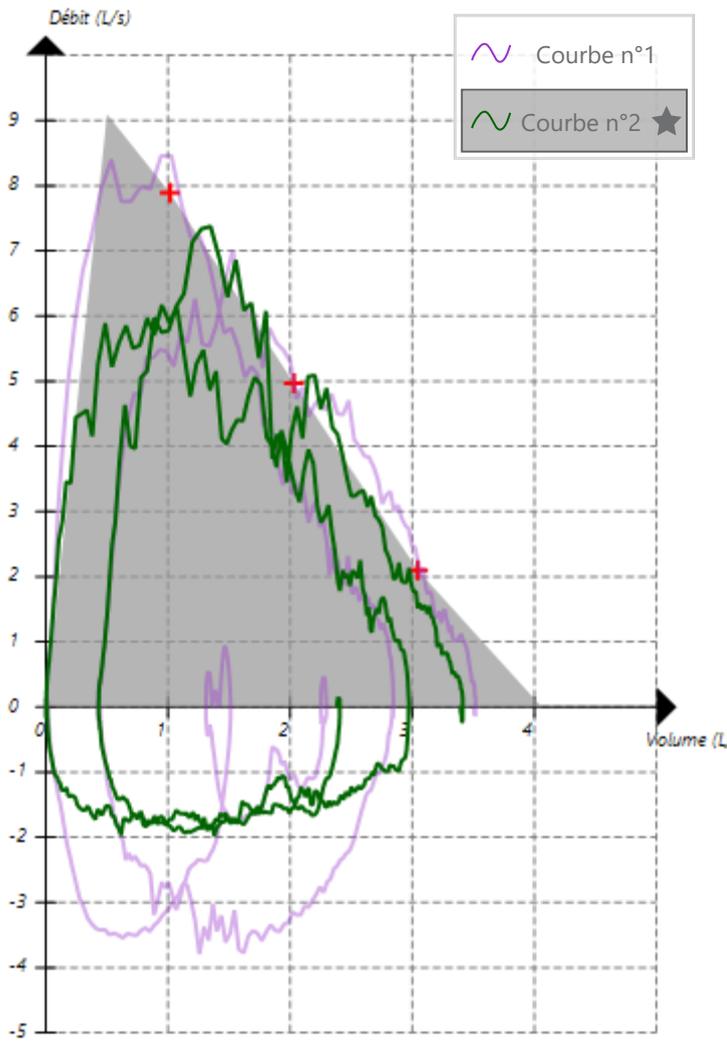

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,84 L	2,98 L	4,06 L	73,40 %
VEMS	2,84 L	2,97 L	3,32 L	89,46 %
DÉP	8,79 L/s	7,68 L/s	9,10 L/s	84,40 %
VEMS/ CVF	100,00 %	99,66 %	79,16 %	125,90 %
Durée d'expiration	0,97 s	1,24 s	-	
DEMM	5,64 L/s	4,90 L/s	4,20 L/s	116,67 %
DEMM/ CVF	1,99 s-1	1,64 s-1	0,90 s-1	182,22 %
DE75	7,79 L/s	6,86 L/s	7,89 L/s	86,95 %
DE50	5,90 L/s	4,24 L/s	4,97 L/s	85,31 %
DE25	3,02 L/s	3,30 L/s	2,10 L/s	157,14 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: