


<b>Nom</b> SAGNO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BANGALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/2002	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 22 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 6996	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 76 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 65 %

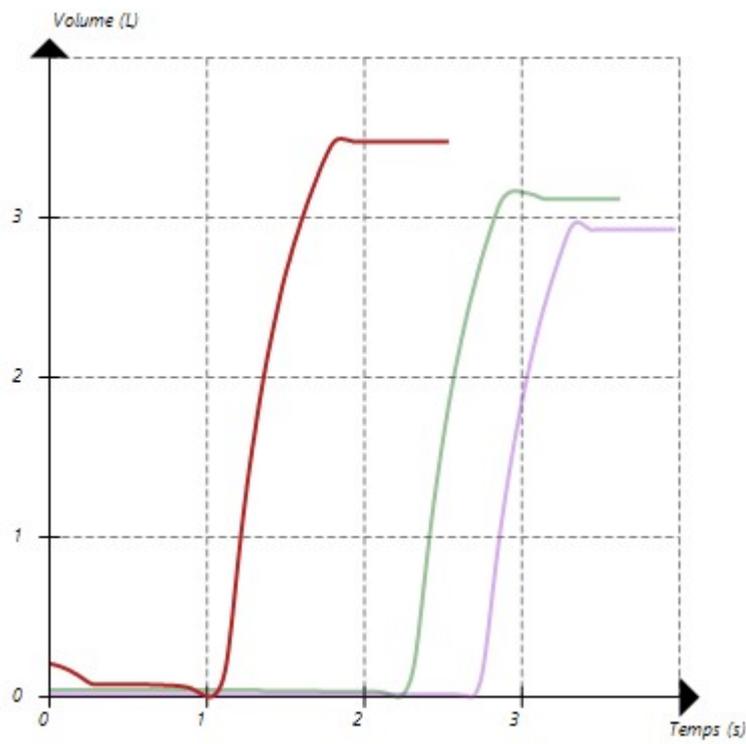

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,97 L	3,17 L	3,49 L	4,37 L	79,86 %
VEMS	2,97 L	3,17 L	3,49 L	3,74 L	93,32 %
DEP	8,76 L/s	8,99 L/s	9,54 L/s	9,41 L/s	101,38 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85,22 %	117,34 %
Durée d'expiration	0,67 s	0,74 s	0,83 s	-	
DEMM	5,72 L/s	6,12 L/s	6,00 L/s	4,31 L/s	139,21 %
DEMM/ CVF	1,93 s-1	1,93 s-1	1,72 s-1	0,99 s-1	173,74 %
DE75	8,15 L/s	8,62 L/s	8,89 L/s	-	
DE50	5,45 L/s	6,35 L/s	6,23 L/s	-	
DE25	3,81 L/s	4,08 L/s	3,81 L/s	-	