

<b>Nom</b> MARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SOULEYMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1999	<b>Profession</b> BULLDOZER
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1451	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 55 %

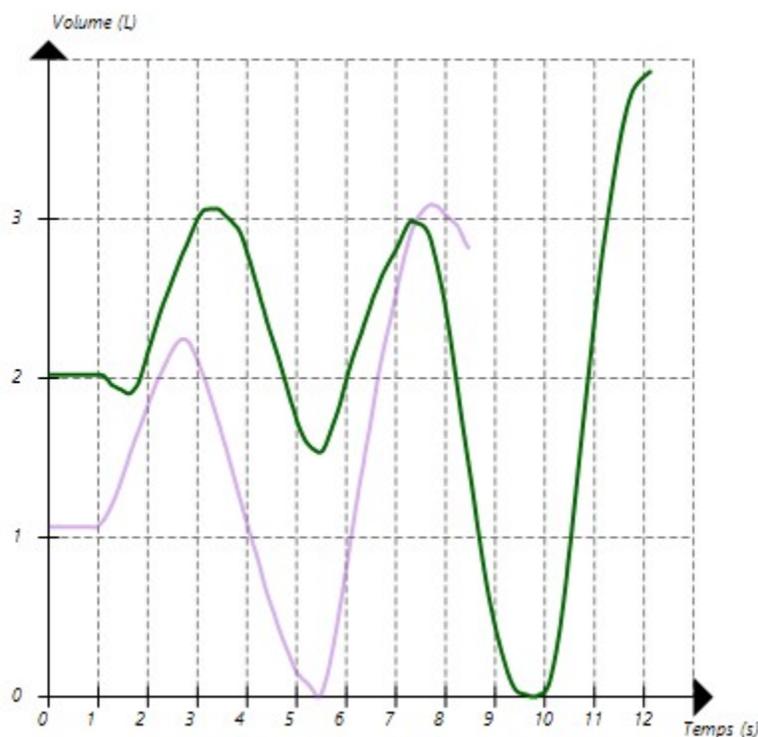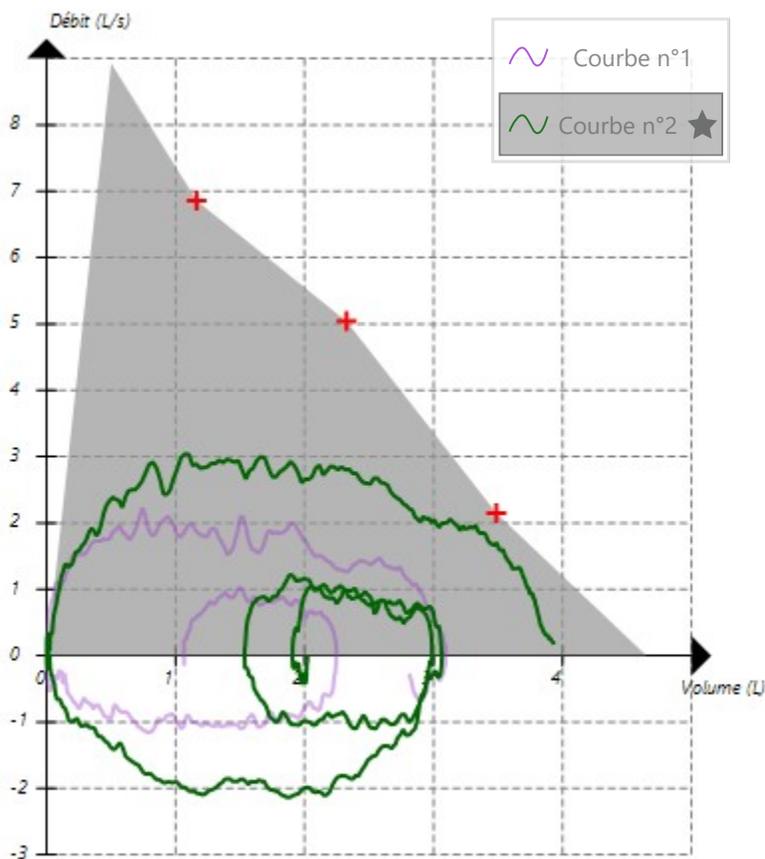

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,09 L	3,93 L	4,65 L	84,52 %
VEMS	1,93 L	2,83 L	3,93 L	72,01 %
DEP	2,25 L/s	3,10 L/s	8,93 L/s	34,71 %
VEMS/ CVF	62,46 %	72,01 %	84,08 %	85,64 %
Durée d'expiration	2,29 s	2,36 s	-	
DEMM	1,77 L/s	2,75 L/s	4,30 L/s	63,95 %
DEMM/ CVF	0,57 s-1	0,70 s-1	0,92 s-1	76,09 %
DE75	1,99 L/s	2,68 L/s	6,86 L/s	39,07 %
DE50	1,90 L/s	2,61 L/s	5,04 L/s	51,79 %
DE25	1,28 L/s	2,07 L/s	2,15 L/s	96,28 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: