

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom OUSMANE</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1985</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 39 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 659</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 168 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 65 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,8 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 58 %

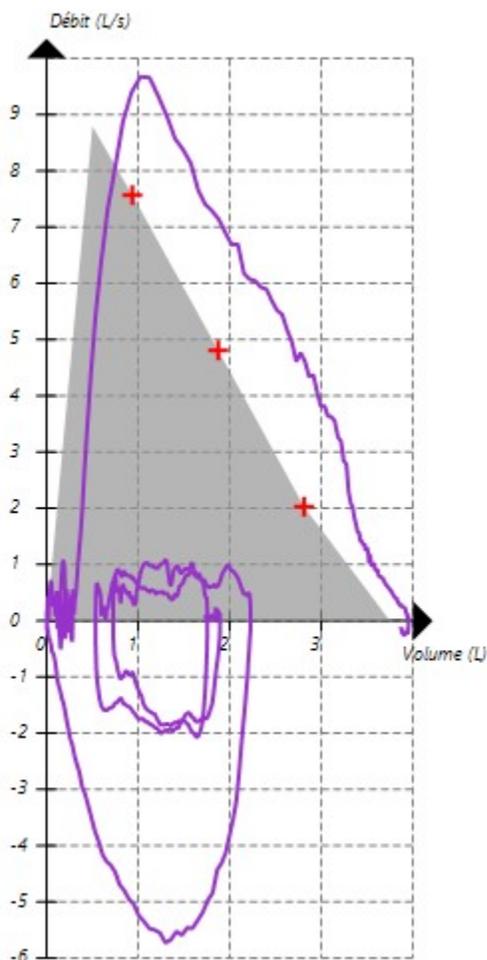

Courbe n°1 ★

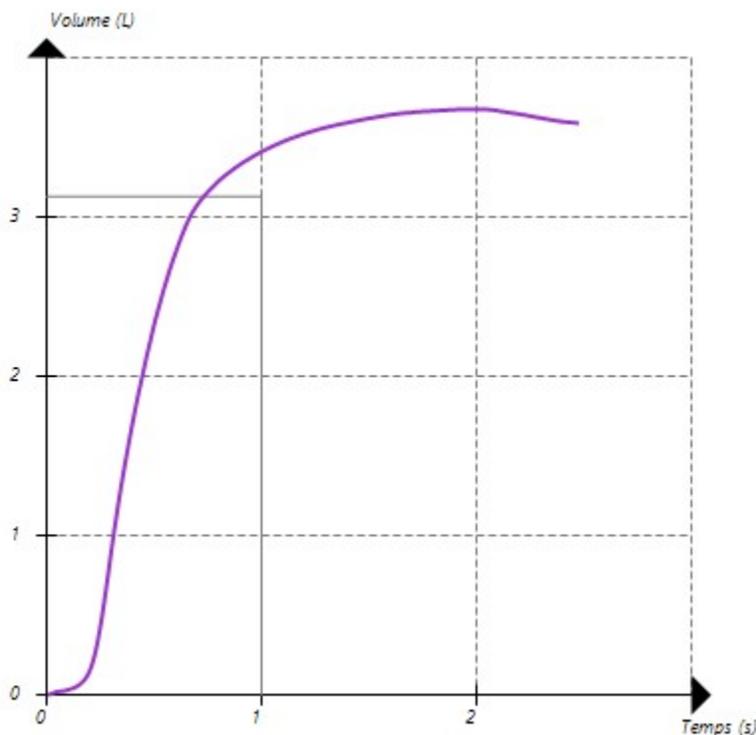

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,68 L	3,75 L	98,13 %
VEMS	3,53 L	3,13 L	112,78 %
DEP	10,00 L/s	8,80 L/s	113,64 %
VEMS/CVF	95,92 %	80,23 %	119,56 %
Durée d'expiration	1,93 s	-	
DEMM	6,27 L/s	4,29 L/s	146,15 %
DEMM/CVF	1,70 s-1	1,00 s-1	170,00 %
DE75	9,51 L/s	7,57 L/s	125,63 %
DE50	6,45 L/s	4,81 L/s	134,10 %
DE25	3,83 L/s	2,03 L/s	188,67 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: