

Nom CAMARA	Adresse
Prénom BANGALY	Exposition
Né le 01/01/1998	Profession MANOEUVRE
Age 26 Ans	Entreprise CR18
Genre Masculin	Service
ID 533	Fumeur Non fumeur
Taille 164 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids 60 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO	



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,8 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 52 %

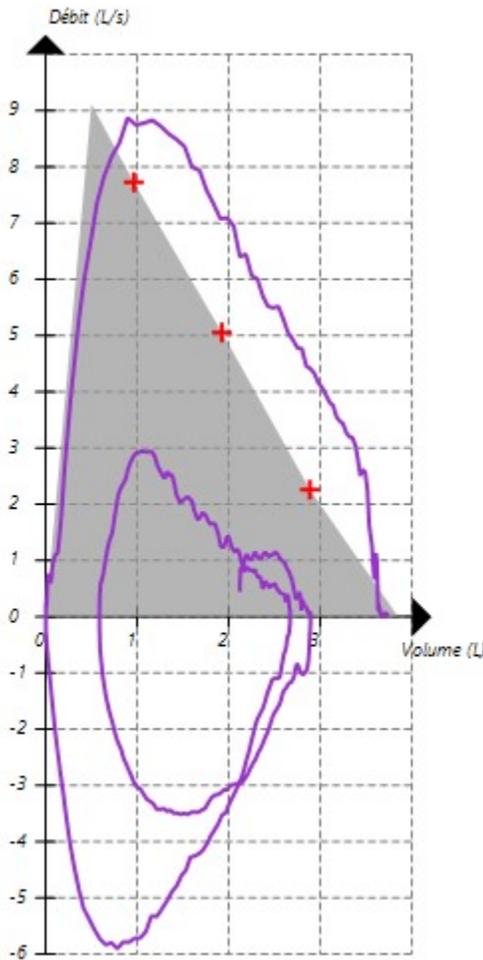

Courbe n°1 ★

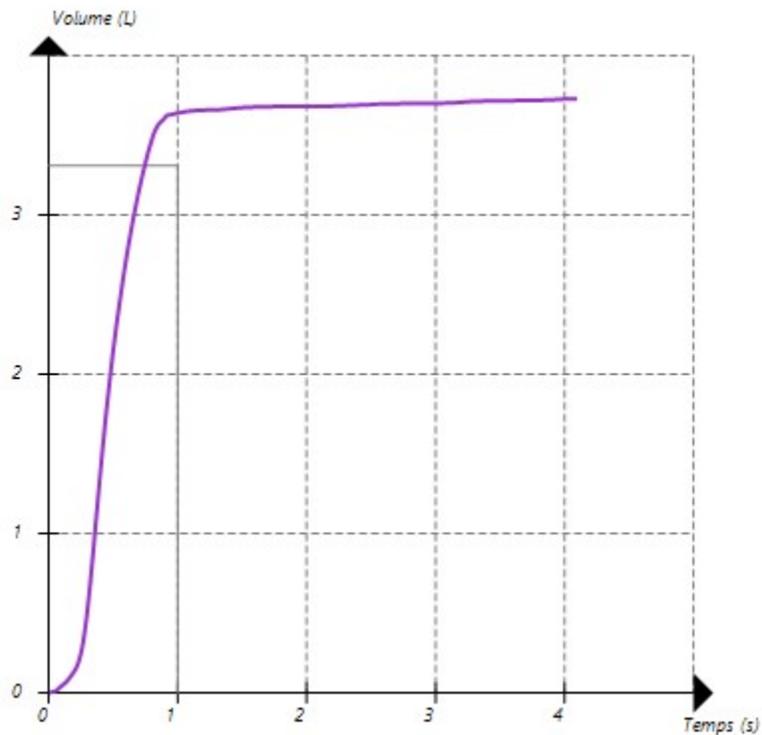

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,73 L	3,85 L	96,88 %
VEMS	3,66 L	3,31 L	110,57 %
DEP	8,98 L/s	9,12 L/s	98,46 %
VEMS/CVF	98,12 %	82,56 %	118,85 %
Durée d'expiration	4,11 s	-	
DEMM	7,01 L/s	4,77 L/s	146,96 %
DEMM/CVF	1,88 s-1	1,08 s-1	174,07 %
DE75	8,91 L/s	7,73 L/s	115,27 %
DE50	7,22 L/s	5,06 L/s	142,69 %
DE25	4,83 L/s	2,26 L/s	213,72 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: