



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIDIKI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1984	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 41 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 9582	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 68 %

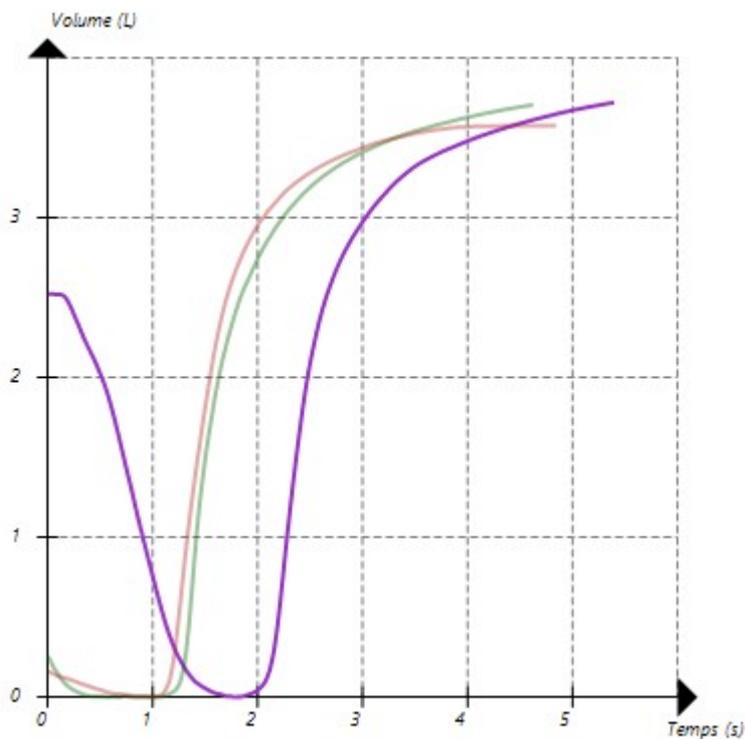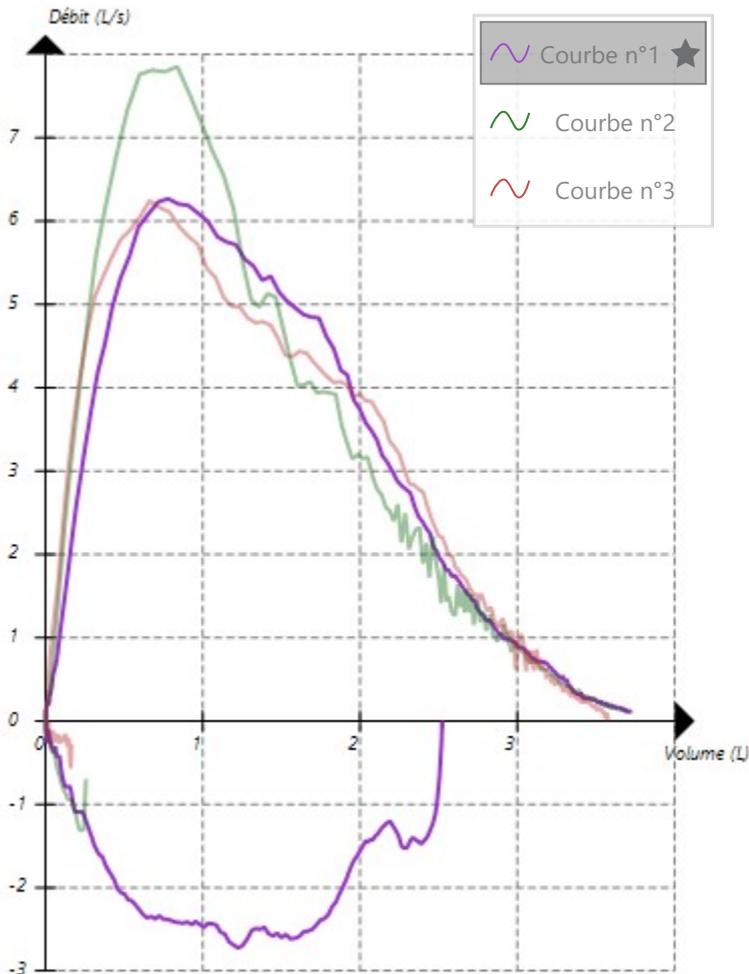

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,72 L	3,71 L	3,58 L	4,26 L	87,32 %
VEMS	3,08 L	3,04 L	3,09 L	3,48 L	88,51 %
DEP	6,32 L/s	7,94 L/s	6,32 L/s	9,02 L/s	70,07 %
VEMS/CVF	82,80 %	81,94 %	86,31 %	81,74 %	101,30 %
Durée d'expiration	3,62 s	3,61 s	3,57 s	-	
DEMM	3,30 L/s	2,97 L/s	3,67 L/s	3,65 L/s	90,41 %
DEMM/CVF	0,89 s-1	0,80 s-1	1,03 s-1	0,86 s-1	103,49 %
DE75	6,09 L/s	7,51 L/s	5,89 L/s	-	
DE50	4,28 L/s	3,91 L/s	4,16 L/s	-	
DE25	1,23 L/s	1,32 L/s	1,61 L/s	-	