



<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1988	<b>Profession</b> WELDER
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 56	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 94 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 34,1 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 45 %

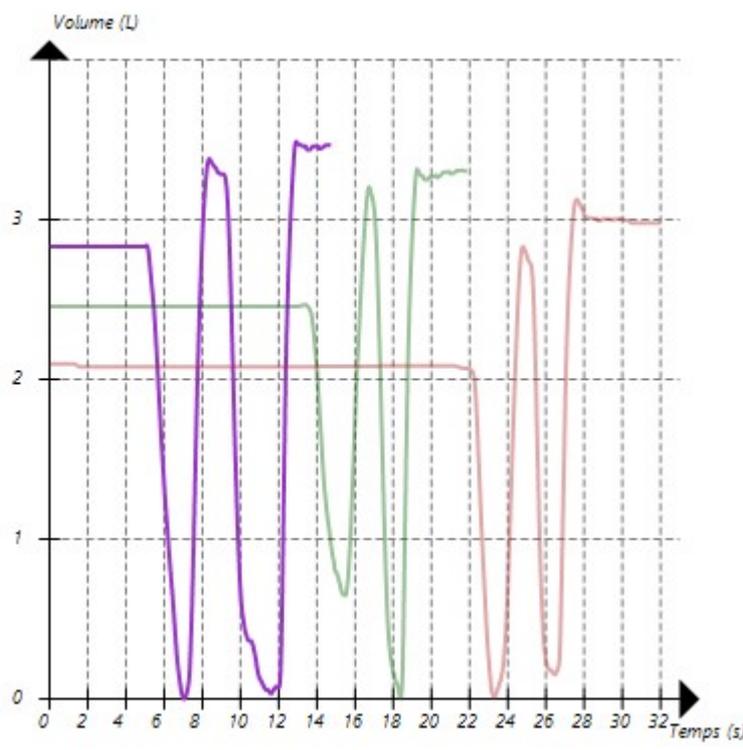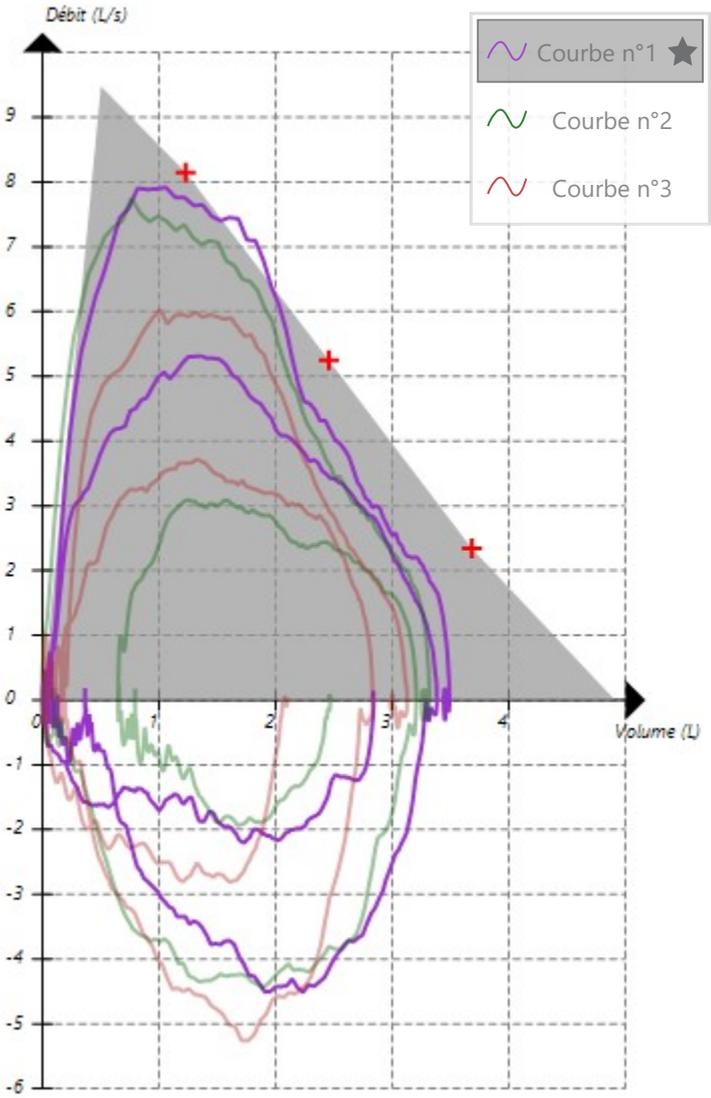

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,42 L	3,32 L	2,97 L	4,91 L	69,65 %
VEMS	3,42 L	3,32 L	2,97 L	4,08 L	83,82 %
DEP	7,96 L/s	7,88 L/s	6,13 L/s	9,48 L/s	83,97 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,77 %	123,81 %
Durée d'expiration	0,90 s	0,87 s	1,13 s	-	
DEMM	6,15 L/s	6,03 L/s	5,25 L/s	4,59 L/s	133,99 %
DEMM/ CVF	1,80 s-1	1,82 s-1	1,77 s-1	0,93 s-1	193,55 %
DE75	7,85 L/s	7,54 L/s	5,80 L/s	8,15 L/s	96,32 %
DE50	7,22 L/s	6,59 L/s	5,89 L/s	5,25 L/s	137,52 %
DE25	3,69 L/s	3,56 L/s	3,20 L/s	2,34 L/s	157,69 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: